

Poskytnutí dodatečných informací č. V

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní, a.s.

dotaz a odpověď č. :

21) V bodě 4. Technické požadavky část 1: 1 ks Ultrazvuk pro interní oddělení – interní oddělení Masarykovy nemocnice uvádíte tento požadavek u parametrů sond:

Kardiosonda, elektronická, sektorová, s možností vícenásobné fokusace pro echo zobrazení, s frekvenčním rozsahem cca. 2,5-5 MHz.

Na trhu existují špičkové ultrazvukové diagnostické přístroje, které nepoužívají technologii vícenásobné fokusace, a přesto díky jiným technologiím dosahují špičkové kvality zobrazení.

Dotaz č. 1: Bude zadavatel akceptovat řešení, které nebude postaveno na vícenásobné fokusace u požadované kardiosondy?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

22) V bodě 4. Technické požadavky část 3: 1 ks Ultrazvukový digitální přístroj – radiodiagnostické oddělení Nemocnice Děčín uvádíte tento požadavek na „Parametry přístroje“:

-s požadovaným frekvenčním rozsahem přístroje do minim 18 MHz.

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat ultrazvukový diagnostický přístroj, jehož frekvenční rozsah je do minim. 17 MHz?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj, jehož frekvenční rozsah je do minim. 17 MHz.

23) V bodě 4. Technické požadavky část 3: 1 ks Ultrazvukový digitální přístroj – radiodiagnostické oddělení Nemocnice Děčín uvádíte tento požadavek na „Požadovaná zobrazení“:

- *Anatomický M-mód.*

Požadován je přístroj pro radiodiagnostické oddělení. Zobrazení pomocí anatomického M-módu nebývá využíváno a v případě, že je využíváno, tak pouze na kardiologických odděleních.

Dotaz č. 3: Bude zadavatel akceptovat přístroj bez anatomického M-módu?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj bez anatomického M-módu.

24) V bodě 4. Technické požadavky část 4: 1 ks UZ gynekologie – gynekologické oddělení nemocnice Most uvádíte tento požadavek na „Požadovaná zobrazení“:

- *Anat. M mód, barevný M mód*

Požadován je přístroj pro gynekologické oddělení. Zobrazení pomocí anatomického M-módu nebývá využíváno a v případě, že je využíváno, tak pouze na kardiologických odděleních.

Dotaz č. 4: Bude zadavatel akceptovat přístroj bez anatomického M-módu?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na uvedené specifikaci.

25) V bodě 4. Technické požadavky část. 5: 1 ks UZ přístroj – neurologické oddělení Masarykovy nemocnice uvádíte tento požadavek u parametrů sond:

Sonda pro transkraniální doppler s možností vícenásobné fokusace s frekvenčním rozsahem cca 1-5 MHz (B mód).

Na trhu existují špičkové ultrazvukové diagnostické přístroje, které nepoužívají technologii vícenásobné fokusace, a přesto díky jiným technologiím dosahují špičkové kvality zobrazení.

Dotaz č. 5: Bude zadavatel akceptovat řešení, které nebude postaveno na vícenásobné fokusace u požadované sondy pro transkraniální doppler?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

26) V bodě 4. Technické požadavky část 9: 1 ks UZ pro dětskou kardiologii – dětská klinika Masarykovy nemocnice uvádíte tento požadavek u „Požadavku na sondy“:

Multifrekvenční sonda nejvyšší kvality pro dospělou a pediatrickou echokardiografii s frekvenčním rozsahem cca. 2-4 MHz, s možností vícenásobné aktivní fokusace, s možností zobrazení na různých harmonických kmitočtech.

Na trhu existují špičkové ultrazvukové diagnostické přístroje, které nepoužívají technologii vícenásobné fokusace, a přesto díky jiným technologiím dosahují špičkové kvality zobrazení.

Dotaz č. 6: Bude zadavatel akceptovat řešení, které nebude postaveno na vícenásobné fokusace u požadované sondy?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

27) V bodě 4. Technické požadavky část 9: 1 ks UZ pro dětskou kardiologii – dětská klinika Masarykovy nemocnice uvádíte tento požadavek u „Požadavku na sondy“:

Multifrekvenční sonda nejvyšší kvality pro neonatální echokardiografii s frekvenčním rozsahem cca. 4-8 MHz, s možností vícenásobné aktivní fokusace, s možností zobrazení na různých harmonických kmitočtech.

Na trhu existují špičkové ultrazvukové diagnostické přístroje, které nepoužívají technologii vícenásobné fokusace, a přesto díky jiným technologiím dosahují špičkové kvality zobrazení.


Dotaz č. 7: Bude zadavatel akceptovat řešení, které nebude postaveno na vícenásobné fokusace u požadované sondy?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Na základě výše uvedených dodatečných informací zadavatel rozhodl prodloužení lhůty pro podání nabídek na 02.12.2013 v 10:00. Otevírání obálek proběhne dne 02.12.2013 v 12:00.

V Ústí nad Labem dne: 9.10.2013

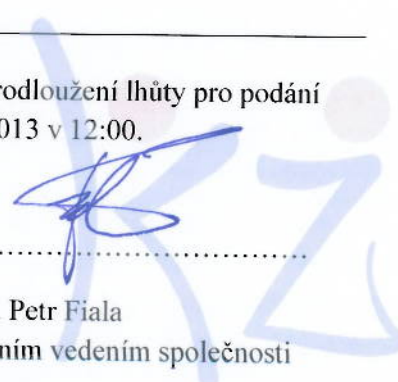

.....
Ing. Petr Fiala
pověřen obchodním vedením společnosti

