

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi:

**LaparoTech Instruments s. r. o.**

se sídlem: Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 256 22 846

DIČ: CZ25622846

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55647

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „prodávající“)

a

**Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní údaje: [REDAKCE]

Kontakt ve věcech soutěže: [REDAKCE]

Kontakt ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**, - část č. 3 Instrumentarium pro abdominální operativu vč. kontejnerů

### I.

#### Předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0002831, který je podpořen z 5. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabytí vlastnické právo k němu a to k:
  - Instrumentarium pro abdominální operativu vč. kontejnerů (dále jen přístroj nebo zboží) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
2. Předmětem smlouvy je i:
  - montáž zboží,
  - instalace zboží,
  - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
  - provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
  - ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
  - instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži,
  - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy a dále záruční servis dle níže uvedených podmínek,
  - likvidace obalového materiálu.
3. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace zboží) této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

## II.

### Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 1 598 200,- Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdánitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a je cenou konečnou a je v ní obsaženo veškeré plnění dle této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a musí splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak:
  - IČO,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na smlouvu,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
  - soupis příloh,
  - název projektu: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**,
  - registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0002831,
  - přílohou faktury musí být protokol o předání zboží.
5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
7. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno níže v čl. III odst. 2 smlouvy.

8. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení faktury prodávajícímu k přepracování. Lhůta splatnosti nové faktury začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury kupujícím.

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 56 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED] Pověřeným zástupcem kupujícího jsou:
  1. [REDACTED]  
[REDACTED] nebo pověřený pracovník OOKC kupujícího.
2. Za předání zboží se považuje:
  - a. jeho dodání na adresu:  
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – klinika gynekologicko-porodnická
  - b. montáž zboží,
  - c. instalace zboží,
  - d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
  - e. provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
  - f. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži,
  - g. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícím záření (atomový zákon), zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění, a současně
  - h. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
  - i. likvidace obalového materiálu
3. Zvláštní požadavky:
  - a. Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále

prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),

- b. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
- c. Protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem odboru obslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

#### IV.

##### Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží. V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1,2 této smlouvy).

#### V.

##### Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je **24** měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v kupní ceně dle článku II. této smlouvy.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDACTED]
7. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením dle výše uvedených kontaktních údajů.
8. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do lhůty uvedené v článku V. odst. 7 smlouvy, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
9. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být kupujícím opakovaně písemně poskytnuta přiměřená lhůta pro odstranění vady. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další

- přiměřené lhůty, stejně tak o délce další přiměřené lhůty, rozhoduje kupující. Poskytnutí další přiměřené lhůty nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 8 tohoto článku.
10. Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba zboží se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady dle tohoto článku V. smlouvy.
  11. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
    - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
    - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle §65 zákona č. 268/2014 Sb.
    - revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.
    - v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
    - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně
  12. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny odborné údržby (periodických bezpečnostně technických kontrol) dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.
  13. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je technik zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností.

## VI.

### Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde v termínu dle čl. III. odst. 1 smlouvy k předání zboží, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 8 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) zboží.
4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## VII.

### Předčasné ukončení smlouvy

Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## VIII.

### Zvláštní ustanovení

1. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

### IX.

#### Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že smlouva s výši hodnoty jejího předmětu přesahující 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, pokud se na ní nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv, se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu, tj. včetně všech osobních údajů.
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv Krajská zdravotní, a. s. bez zbytečného odkladu.

### X.

#### Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.

### XI.

#### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Prodávající na sebe přebírá dle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména veškeré změny kurzu cizích měn.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
8. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Příloha:

- 1) Technická specifikace zboží

V e Staré Boleslavi


dne

21. 8. 2018


V Ústí nad Labem

dne ... 07. 09. 2018 ...

LaparoTech Instruments s. r. o.

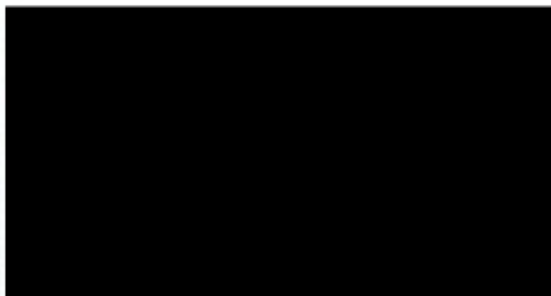

Krajská zdravotní, a.s.



**INSTRUMENTÁRIUM PRO ABDOMINÁLNÍ OPERATIVU VČETNĚ KONTEJNERŮ**

<i>kód výrobku</i>	<i>popis</i>	<i>ks</i>
016-310-005	FRITSCH, břišní hák 65x85 mm, délka 26,5cm	10
016-310-004	FRITSCH, břišní hák 55x75 mm, délka 25,5cm	5
016-262-003	MIDDELDORPF hák, 26x31 mm, délka 24,0cm	10
016-262-001	MIDDELDORPF hák, 14x17 mm, délka 22,0cm	10
027-162-200	BABCOCK ATRAUMA ureterální kleště 20,0cm	10
015-861-250	FOERSTER kleště na uzliny, 25 cm	10
013-982-190	Pinzeta typu TC DEBAKEY, délka 20 cm, šíře branží 2,0 mm	10
013-982-240	Pinzeta typu TC DEBAKEY, délka 24 cm, šíře branží 2,0 mm	5
013-176-175	Anatomická pinzeta Cushing 17,5 cm	15
013-200-200	Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby 20,0 cm	15
013-200-250	Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby 25,0 cm	15
013-210-200	Chirurgická pinzeta standardní 2x3 zuby 20,0 cm	5
013-250-140	Chirurgická pinzeta typu USA MODEL 1x2 zuby 14,5 cm	15
013-100-200	Anatomická pinzeta typ standard, 20,0 cm, distální konec 3,0 mm	5
019-810-210	DESCHAMPS, pravý, tupý, 21 cm	5
019-810-280	DESCHAMPS, pravý, tupý, 27 cm	5
016-352-004	BRUNNER, 140x25mm, délka 25,5cm	5
016-352-006	BRUNNER, 180x30mm, délka 25,5cm	5
030-281-320	SIMS děložní sonda, semiflexibilní, délka 33 cm	10
030-382-170	DOYEN vývrtka na myomy, 17 cm	5
016-492-280	HABERER lopatka 280 x 25/30	10
016-486-280	REVERDIN, lopatka žaludeční 280 mm	5
010-210-004	SCALPEL Handle No. 4, 12,5 cm	5
017-580-010	REDON Needle slightly curved 10 Charr. Lanceolate, threaded end	5
017-580-014	REDON Needle slightly curved 14 Charr. Lanceolate, threaded end	5
017-580-016	REDON Needle slightly curved 16 Charr. Lanceolate, threaded end	5
030-362-200	DOYEN ovariální kleště 20,0 cm	5
085-300-045	MEDICINE CUP graduated inside 45 ccm, rozměry 12 x 6,5 cm	10
030-326-250	SCHROEDER děložní tenaculum kleště, neprohnuté, 2x2 zuby 24 cm	15
015-521-200	GEMINI cévní disektor 200 mm	8
015-521-280	GEMINI cévní disektor 280 mm	10
015-671-240	WERTHEIM kleště 250 mm	5
015-280-200	KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby 20,0 cm	5
015-280-240	KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby 24,0cm	25
015-693-003	ROGERS kleště, 20,5 cm, zahnutí 45°	5
015-695-001	ROGERS hysterektomické kleště, 25,5cm, rovné	6
015-261-240	ROCHESTER PEAN, zahnutý 24 cm	2
015-261-200	ROCHESTER PEAN, zahnutý 20 cm	2
015-495-007	OVERHOLT-GEISSENDOERFER, mírně zahnuté 21 cm	5
015-491-210	OVERHOLT prohnuté, cca 50°, 21 cm	10
015-260-240	ROCHESTER PEAN, rovný 24 cm	15
015-260-200	ROCHESTER PEAN, rovný 20 cm	15
015-260-180	ROCHESTER PEAN, rovný 18 cm	5
015-695-004	ROGERS hysterektomické kleště, 24cm, zahnutí 75°	10
015-695-003	ROGERS hysterektomické kleště, 24,5cm, zahnutí 50°	5
015-695-001	ROGERS hysterektomické kleště, 25,5cm, rovné	10
019-630-260	TC SAROT kleště rovné, 26 cm	5
030-310-250	SCHROEDER Tenaculum kleště, 1x1 zub, 25,5 cm	20
013-406-230	SINGLEY TUTTLE, 23 cm	2
015-800-265	GROSS-MAIER kleště, rovné, 26,5 cm	70
019-640-260	TC-BOZEMANN jehelec 26,0 cm	20
019-640-200	TC-BOZEMANN jehelec 20,0 cm	15
019-550-200	TC-MAYO-HEGAR jehelec, 20,0 cm	8
015-280-140	KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby 14,0cm	50
012-731-230	TC-METZENBAUM-NELSON Scissor curved 23,0 cm	20
012-714-170	TC-MAYO-STILLE Scissor straight 17,0 cm	15
015-250-140	PEAN Forceps delicate straight 14,0 cm	50
027-122-160	ALLIS ATRAUMA kleště, 160 mm	20



012-854-170	SC-MAYO nůžky 17,0 cm	20
012-143-225	MAYO-HARRINGTON, ZAHNUTÉ 23,0 cm	20
012-731-200	TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté 20 cm	20
012-771-230	TC SIMS zahnuté 23,0 cm	8
012-221-160	NŮŽKY PREP. LEXER, zahnuté 160 mm	10
012-731-180	TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté 18 cm	10
336-542	Hysterektomické kleště MARINA, branže typu cévní svorky, hluboký vzorek, bez kochrové špičky, 25 cm	10
025-403-190	DeBakey ATRAUMA kleště, prohnuté, 19 cm	10
016-780-000	O'Sullivan- O'Connor rozvěrač typ US-100	5
019-640-240	TC-BOZEMANN jehelec 24,0 cm	15
015-545-190	KELLY Ligatur Forceps strong cvd. 19,0 cm	5
015-697-250	BURKE kleště, rovné krátké branže, délka 21cm	10
015-733-130	TOHOKU Towel forceps 13,0 cm	20
<b>Komplexní multisegmentový retrakční systém typu rámu s úchytem na eurolištu s flexibilním horizontálním ramenem a sedmi kusy retraktoru, s vertikálním prodlužovacím ramenem - 1ks</b>		
31-5121-01	Úchyt na eurolištu 2,6 cm	1
31-5121-02	Vertikální stolová tyč 46 cm	1
31-5121-04	Prodlužovací tyč 30,5 cm	1
31-5121-06	Horizontální flexibilní tyč	1
31-5120-07	Segmentovaný rám 49x27 cm	1
31-5122-03	Kelly retraktor 5x10 cm	2
31-5122-04	Kelly retraktor 5x12,5 cm	2
31-5122-06	Kelly retraktor 5x15 cm	2
31-5125-02	Balfour retraktor 8,5x7cm	2
31-5122-04	Simpson - St Mark retraktor 12,5 cm	2
31-5121-10	Úchyt retraktorů (ratchet) flexibilní k extenzi a retrakci v horizontální i vertikální rovině, umožňuje rotaci retraktorů 30 stupňů vlevo/vpravo	8
<b>Retraktor horního břicha (pro operace ovariálního karcinomu) kabelový navijákový retrakční systém. K resekci nádoru bránice, jater, omentektomie, splenektomie. Tah může být aplikován i z extrémních laterálních pozic, systém elektricky izolovaný - 2ks retrakčního systému obsahují:</b>		
UL7807-11	Uchycení na eurolištu operačního stolu	4
UL7805-62	Laterální vertikální tyč 550 mm	4
UL7804-63	Rám standard 630 mm	2
UL7804-80	Rám extra šíře 800 mm	2
UL7801-09	Kabelový navijákový systém, s kabelem délky 88 cm, s variabilní adjustací	6
UL7810-39	Lopatka 65 x 50 x 39	4
UL7811-42	Lopatka 75 x 60 x 42	4
UL7812-55	Lopatka 100 x 80 x 55	4
091-113-260	Ventilový kontejner s bezpečnostním víkem 580 x 280 x 260 mm	10
095-220-070	Sterilizační síto 540 x 255 x 70	25
030-200-001, 030-200-400	SCHERBAK rukojeť + závaží	5
030-200-030	SCHERBAK zrcadlo 80x30 mm	5
030-200-035	SCHERBAK zrcadlo 85x35 mm	5
030-200-040	SCHERBAK zrcadlo 90x40 mm	5
030-200-060	SCHERBAK zrcadlo 55x40/60 mm	5
030-200-070	SCHERBAK zrcadlo 70x45/70 mm	5
90191-24N	Bipolární pinzeta, rovná, délka 24 cm, povrch branží potažený nepřilnavou vrstvou = "non stick" povrch, šířka branží na distálním konci 2 mm	4
90193-22N	Bipolární pinzeta, zahnutá pod úhlem 45°, délka 22 cm, povrch branží potažený nepřilnavou vrstvou = "non stick" povrch, šířka branží na distálním konci 2 mm	4
90193-24N	Bipolární pinzeta, zahnutá pod úhlem 45°, délka 24 cm, šířka branží na distálním konci 2 mm	2
707-303, 90302-30	Kabel k bipolární pinzetě, 3m, kompatibilní s generátory typu Olympus	10
90030-01	Rukojeť monopolární elektrody pro průměr 4mm, s 3m kabelem, pro 3-pinové zakončení, ovládání řezu a koagulace z rukojeti bez nutnosti připojení pedálu	4
90032-01	Monopolární elektroda typu nožiku pro řez, průměr 4mm, pracovní plocha 2,5 x 20 mm, délka nástavce 30 mm	4
90034-02	Monopolární elektroda typu kuličky pro koagulaci, průměr 4mm, pracovní průměr kuličky 6 mm, délka nástavce 30 mm	4
90800-00	Bipolární kleště k zastavení krvácení velkých cév, délka 22 cm	2
90800-10, 90302-30	Bipolární kabel pro kleště, délka 5m, pro generátory typu Olympus	2

**TECHNICKÉ LISTY: "Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., část 3., Instrumentárium pro abdominální operativu včetně kontejnerů "**

Katalogové číslo: 016-310-005



Fritsch, břišní hák 65x85 mm, délka 26,5 cm

Katalogové číslo: 016-310-004



Fritsch, břišní hák 55x75 mm, délka 25,5 cm

**Katalogové číslo: 016-262-003**




MIDDELDORPF hák, 26x31 mm, délka 24,0 cm

**Katalogové číslo: 016-262-001**




MIDDELDORPF hák, 14x17 mm, délka 22,0 cm

**Katalogové číslo: 027-162-200**

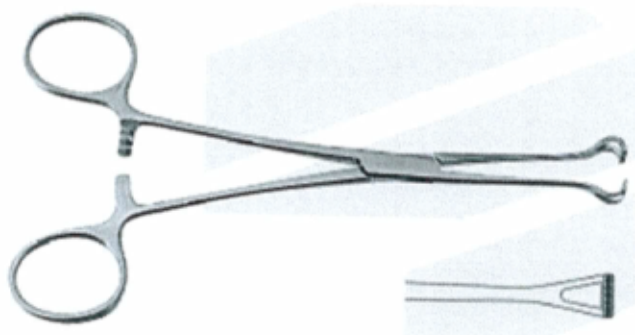

BABCOCK ATRAUMA ureterální kleště 20,0 cm

**Katalogové číslo: 015-861-250**

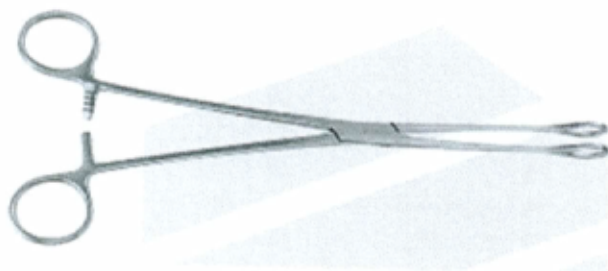

FOERSTER kleště na uzliny, 25 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 013-982-190**



Pinzeta typu TC DEBAKEY, délka 20 cm, šíře branží 2,0 mm

**Katalogové číslo: 013-982-240**



Pinzeta typu TC DEBAKEY, délka 24 cm, šíře branží 2,0 mm

**Katalogové číslo: 013-176-175**



Anatomická pinzeta Cushing 17,5 cm

**Katalogové číslo: 013-200-200**



Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby, 20,0 cm

**Katalogové číslo: 013-200-250**



Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby, 25,0 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 013-210-200**



2x3

Chirurgická pinzeta standardní 2x3 zuby, 20,0 cm

**Katalogové číslo: 013-250-140**



1x2

Chirurgická pinzeta typu USA MODEL 1x2 zuby, 14,5 cm

**Katalogové číslo: 013-100-200**




Anatomická pinzeta typ standard, 20,0 cm, distální konec 3,0 mm

**Katalogové číslo: 019-810-210**



DESCHAMPS, pravý, tupý, 21 cm



**Katalogové číslo: 019-810-280**

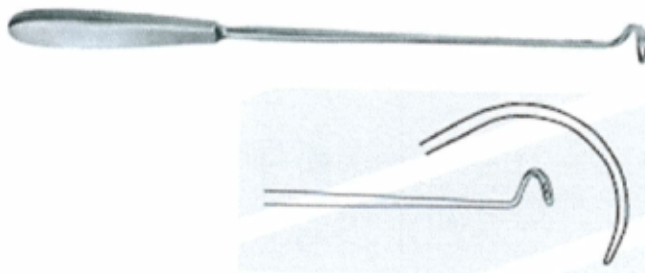

DESCHAMPS, pravý, tupý, 27 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 016-352-004**

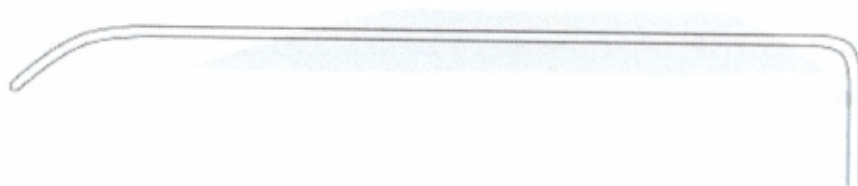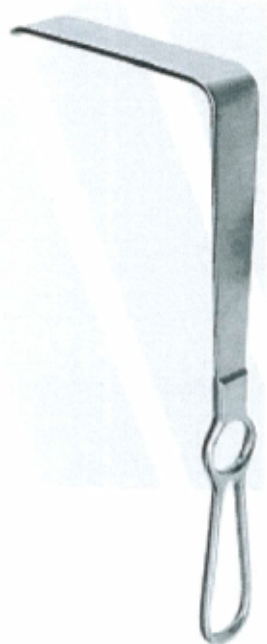

BRUNNER, 140x25 mm, délka 25,5 cm

**Katalogové číslo: 016-352-006**



BRUNNER, 180x30 mm, délka 25,5 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 030-281-320**



SIMS děložní sonda, semiflexibilní, délka 33 cm

**Katalogové číslo: 030-382-170**



DOYEN vývrtka na myomy, 17 cm

**Katalogové číslo: 016-492-280**



HABERER lopatka 280x25/30 mm

**Katalogové číslo: 016-486-280**



REVERDIN, lopatka žaludeční 280 mm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 010-210-004**



SCALPEL Handle No. 4, 12,5 cm

**Katalogové číslo: 017-580-010**



REDON Needle slightly curved 10 Charr. Lanceolate, threaded end

**Katalogové číslo: 017-580-014**



REDON Needle slightly curved 14 Charr. Lanceolate, threaded end

**Katalogové číslo: 017-580-016**



REDON Needle slightly curved 16 Charr. Lanceolate, threaded end



Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 030-362-200**




DOYEN ovariální kleště 20,0 cm

**Katalogové číslo: 085-300-045**



MEDICINE CUP graduated inside 45 ccm, rozměry 12x6,5 cm


**Katalogové číslo: 030-326-250**

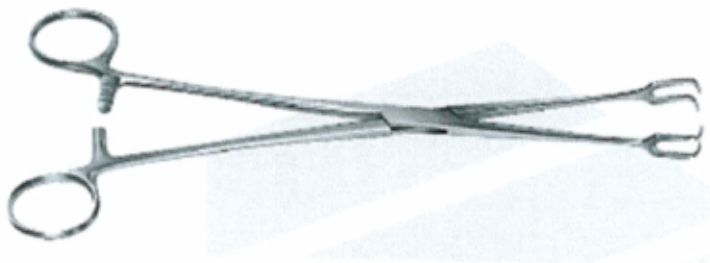

SCHROEDER děložní tenaculum kleště, neprohnuté, 2x2 zuby 24 cm



Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 015-521-200**

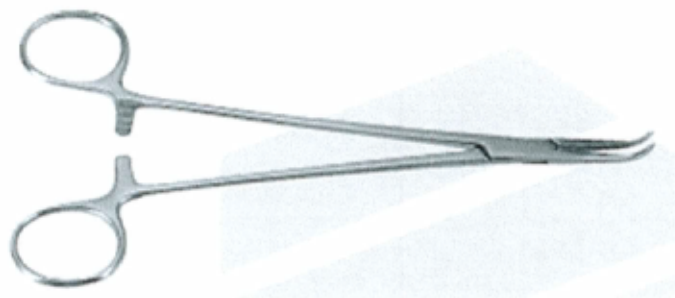

GEMINI cévní disektor 200 mm

**Katalogové číslo: 015-521-280**

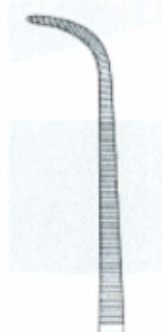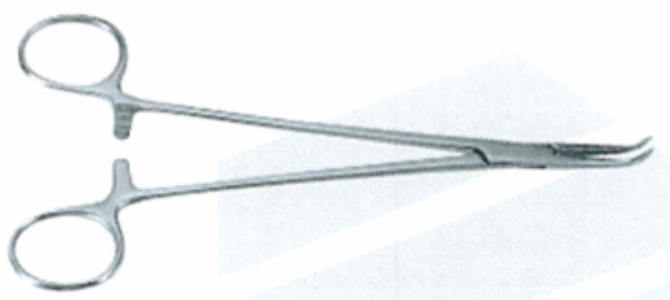


GEMINI cévní disektor 280 mm

**Katalogové číslo: 015-671-240**




WERTHEIM kleště 250 mm

**Katalogové číslo: 015-280-200**

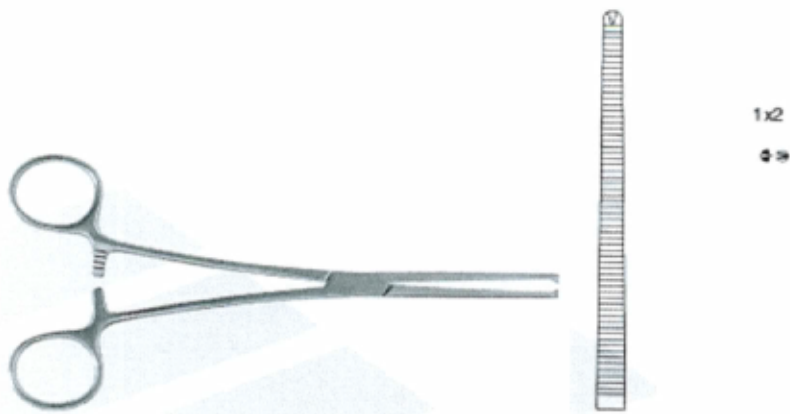

KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby, 20,0 cm

**Katalogové číslo: 015-280-240**

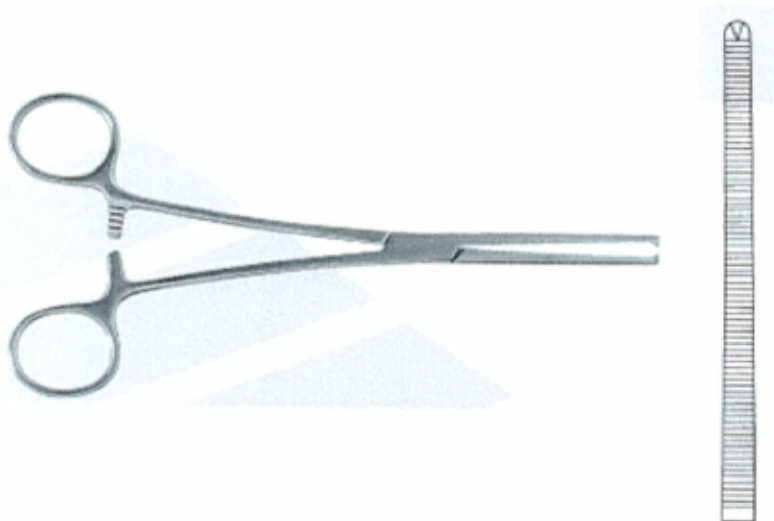


KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby, 24,0 cm

**Katalogové číslo: 015-693-003**



ROGERS kleště, 20,5 cm, zahnutí 45°

**Katalogové číslo: 015-695-001**

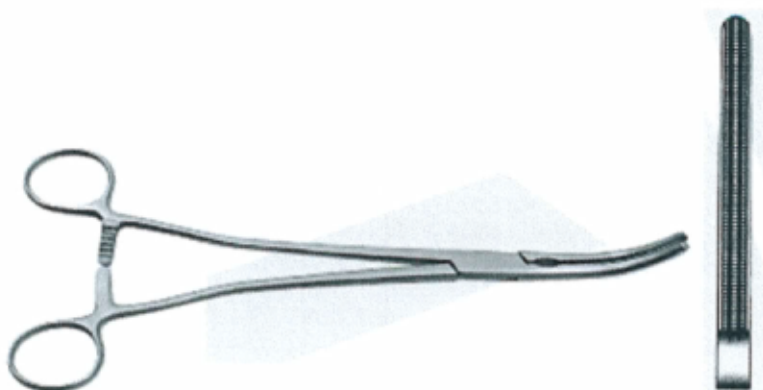


ROGERS hysterektomické kleště, 25,5 cm, rovné

**Katalogové číslo: 015-261-240**



ROCHESTER PEAN, zahnutý 24 cm

**Katalogové číslo: 015-261-200**

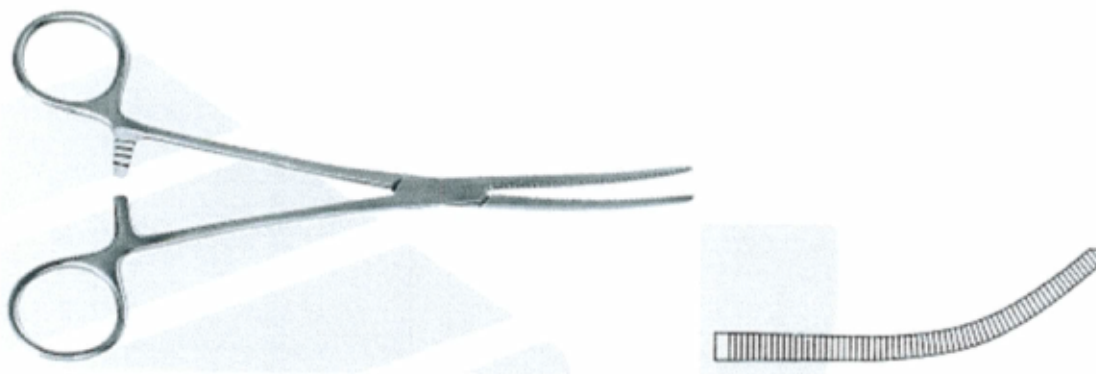

ROCHESTER PEAN, zahnutý 20 cm

**Katalogové číslo: 015-495-007**




OBERHOLT-GEISSENDOERFER, mírně zahnuté 21 cm

**Katalogové číslo: 015-491-210**




OVERHOLT prohnuté, cca 50°, 21 cm

**Katalogové číslo: 015-260-240**

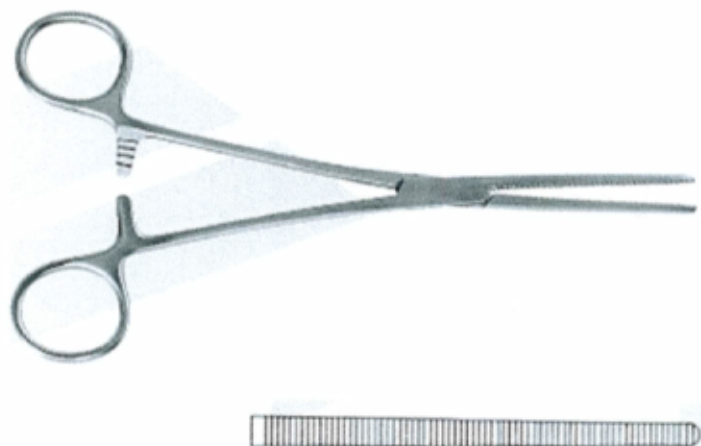


ROCHESTER PEAN, rovný 24 cm

**Katalogové číslo: 015-260-200**

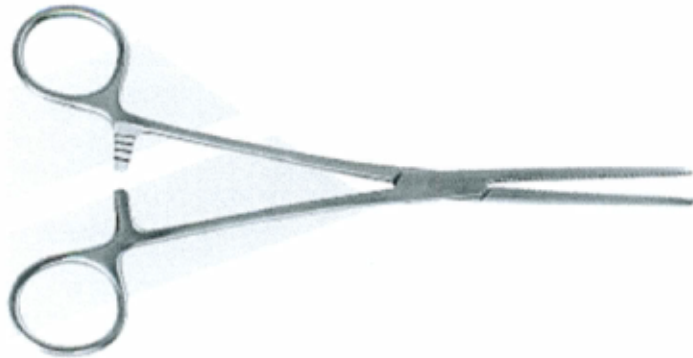


ROCHESTER PEAN, rovný 20 cm

**Katalogové číslo: 015-260-180**

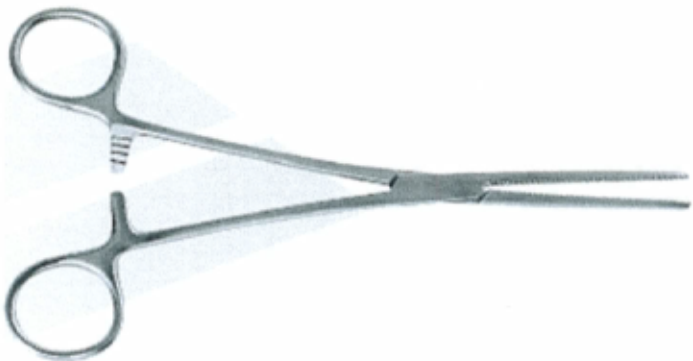


ROCHESTER PEAN, rovný 18 cm

**Katalogové číslo: 015-695-004**

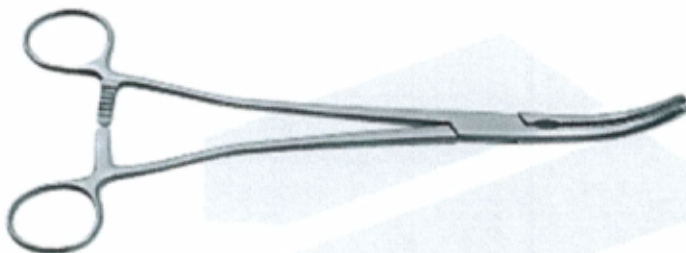


ROGERS hysterektomické kleště, 24 cm, zahnutí 75°

**Katalogové číslo: 015-695-003**

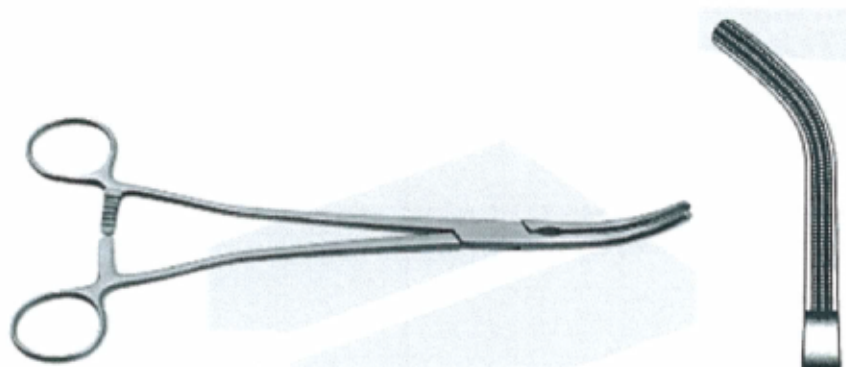


ROGERS hysterektomické kleště, 24,5 cm, zahnutí 50°

**Katalogové číslo: 015-695-001**

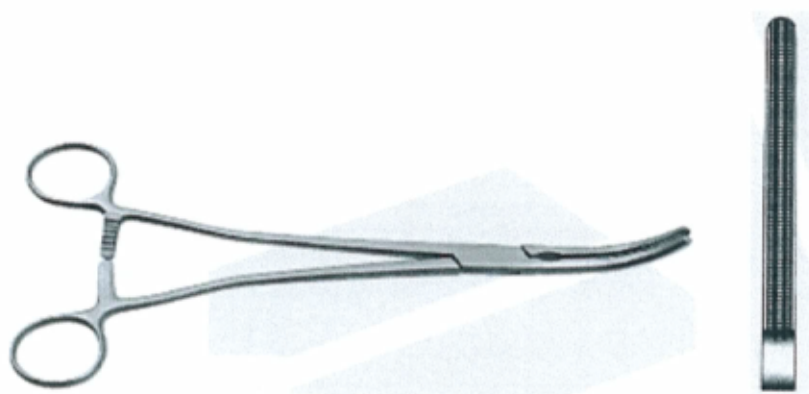

ROGERS hysterektomické kleště, 25,5 cm, rovné


**Katalogové číslo: 019-630-260**

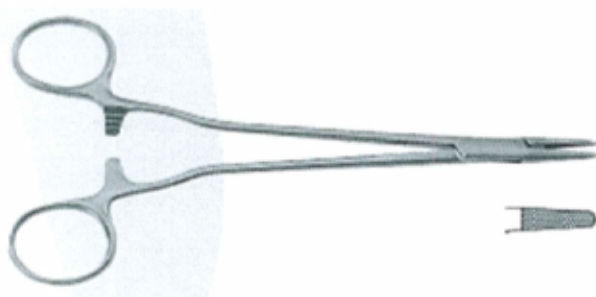

TC SAROT kleště rovné, 26 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 030-310-250**

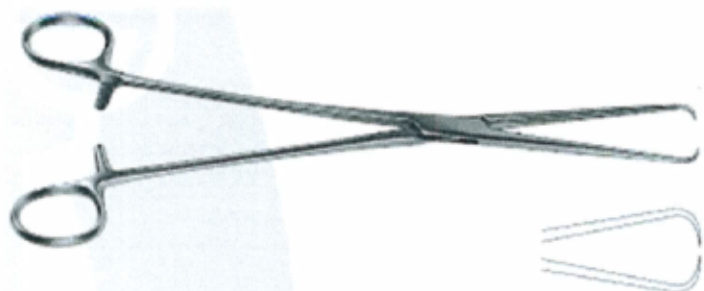


SCHROEDER Tenaculum kleště, 1x1 zub, 25,5 cm

**Katalogové číslo: 013-406-230**




SINGLEY TUTTLE, 23 cm

**Katalogové číslo: 015-800-265**

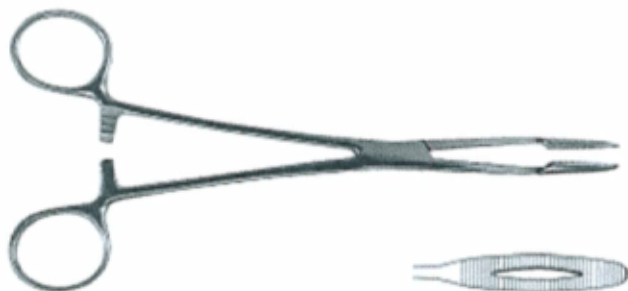

GROSS-MAIER kleště, rovné 26,5 cm


**Katalogové číslo: 019-640-260**

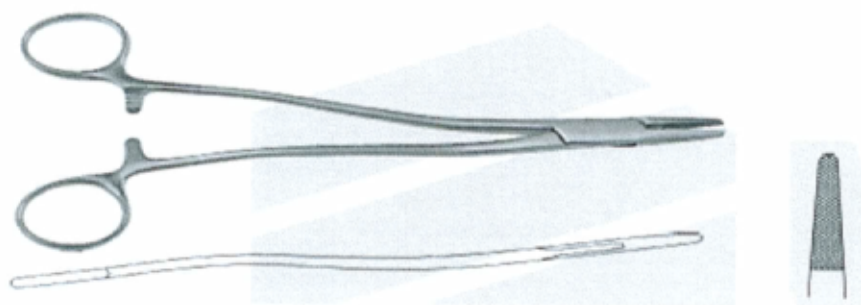

TC-BOZEMANN jehelec 26,0 cm




**Katalogové číslo: 019-640-200**

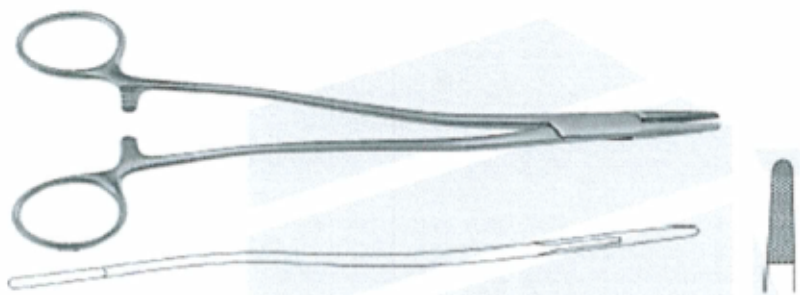


TC-BOZEMANN jehelec 20,0 cm

**Katalogové číslo: 019-550-200**

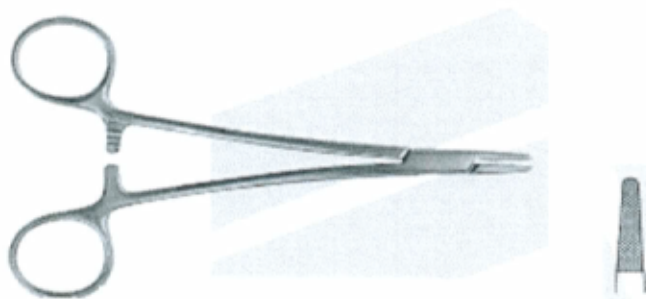

TC-MAYO-HEGAR jehelec, 20,0 cm


**Katalogové číslo: 015-280-140**

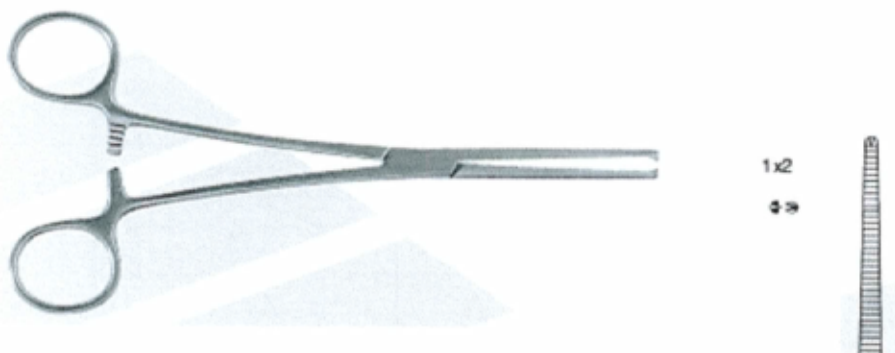

KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby, 14,0 cm


Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 012-731-230**

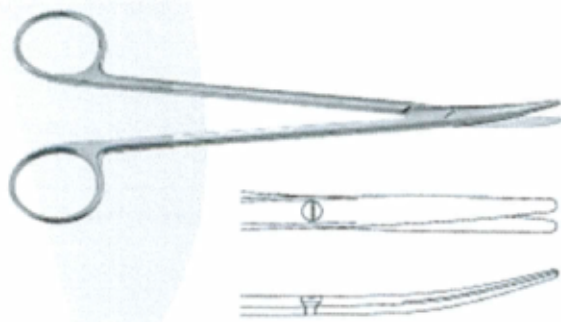

TC-METZENBAUM-NELSON Scissor curved 23,0 cm

**Katalogové číslo: 012-714-170**

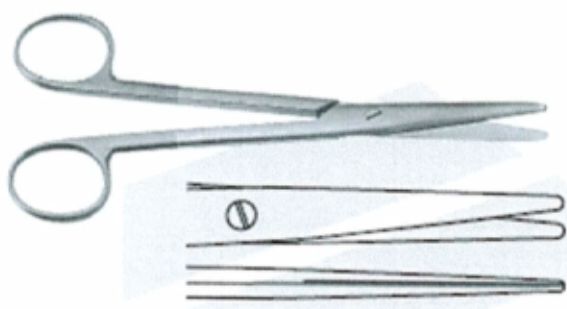


TC-MAYO-STILLE Scissor straight 17,0 cm

**Katalogové číslo: 015-250-140**




PEAN Forceps delicate straight 14,0 cm

**Katalogové číslo: 027-122-160**

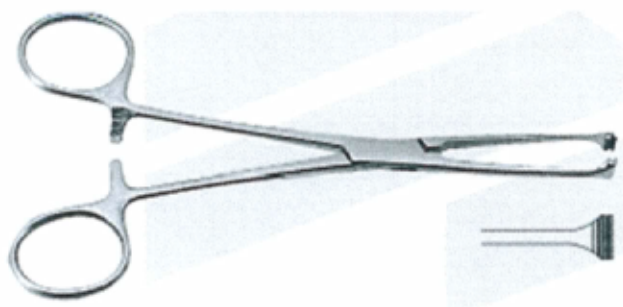


ALLIS ATRAUMA kleště, 160 mm

**Katalogové číslo: 012-854-170**

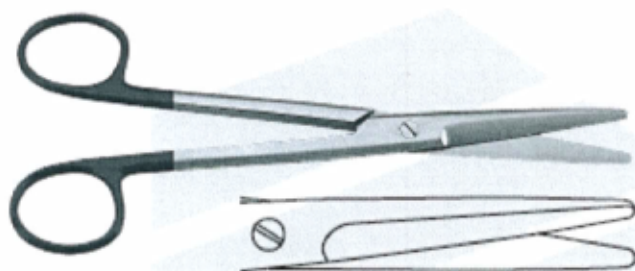


SC-MAYO nůžky 17,0 cm

**Katalogové číslo: 012-143-225**

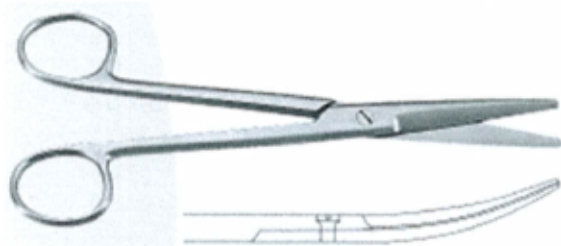


MAYO-HARRINGTON nůžky, zahnuté 23,0 cm

**Katalogové číslo: 012-731-200**

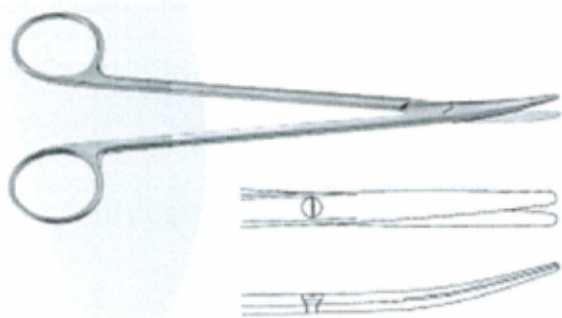


TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté, 20 cm

**Katalogové číslo: 012-771-230**

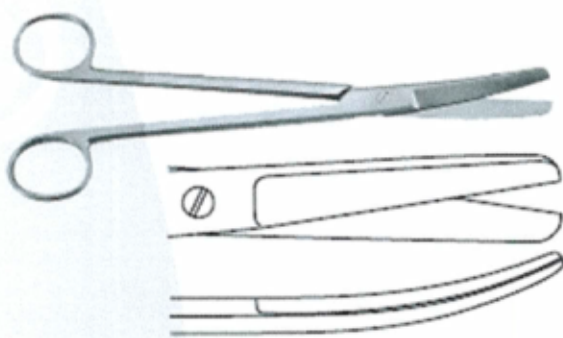


TC SIMS nůžky zahnuté 23,0 cm

**Katalogové číslo: 012-221-160**

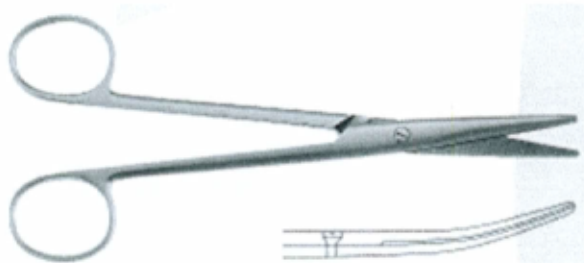


Nůžky prep. LEXER, zahnuté 160 mm

**Katalogové číslo: 012-731-180**

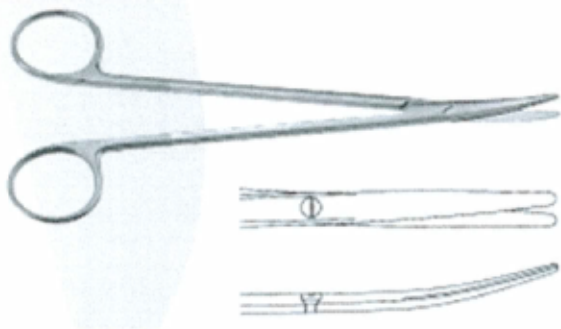

TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté 18 cm

**Katalogové číslo: 336-542**

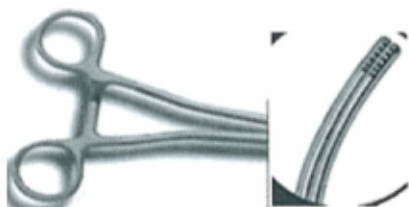

Hysterektomické kleště MARINA, branže typu cévní svorky, hluboký vzorek, bez kochrové špičky, 25 cm

**Katalogové číslo: 025-403-190**




DeBakey ATRAUMA kleště, prohnuté, 19 cm

**Katalogové číslo: 016-780-000**



O'SULLIVAN-O'CONNOR rozvěrač, typ US-100


**Katalogové číslo: 019-640-240**

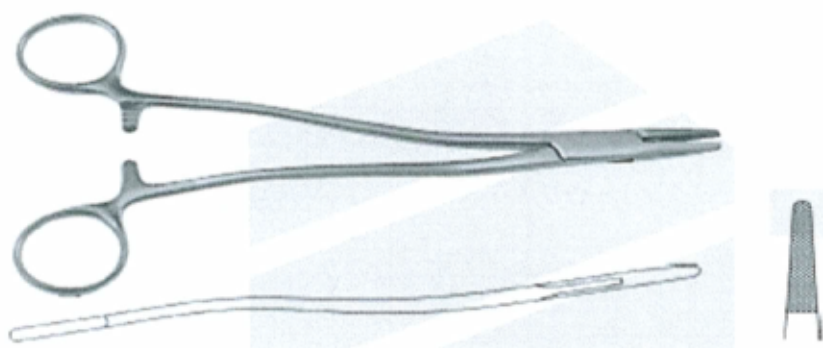

TC-BOZEMANN jehelec 24,0 cm


Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 015-545-190**

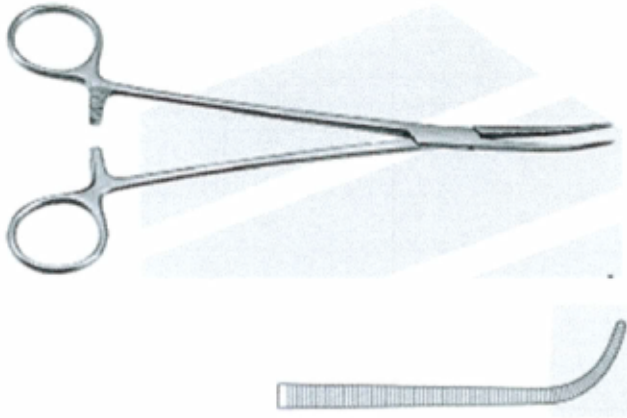

KELLY Ligatur Forceps strong cvd. 19,0 cm

**Katalogové číslo: 015-697-250**

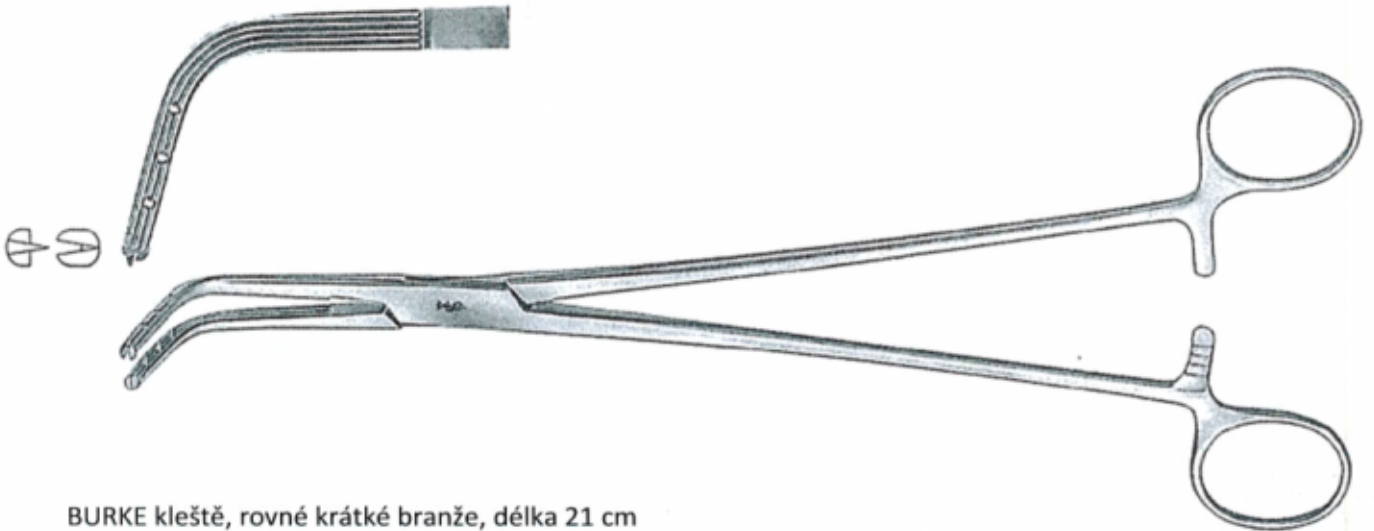

BURKE kleště, rovné krátké branže, délka 21 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 015-733-130**



TOHOKU Towel forceps 13,0 cm

**Komplexní multisegmentový retrakční systém typu rámu s úchytem na eurolištu s flexibilním horizontálním ramenem a sedmi kusy retraktoru, s vertikálním prodlužovacím ramenem – 1 ks**





**Katalogové číslo: 31-5121-01**



Úchyt na eurolištu 2,6 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 31-5121-02**



Vertikální stolová tyč 46 cm

**Katalogové číslo: 31-5121-04**



Prodlužovací tyč 30,5 cm

**Katalogové číslo: 31-5121-06**



Horizontální flexibilní tyč

**Katalogové číslo: 31-5120-07**



Segmentovaný rám 49x27 cm

**Katalogové číslo: 31-5122-03**



Kelly retraktor 5x10 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 31-5122-04**



Kelly retraktor 5x12,5 cm

**Katalogové číslo: 31-5122-06**



Kelly retraktor 5x15 cm

**Katalogové číslo: 31-5125-02**



Balfour retraktor 8,5x7 cm

**Katalogové číslo: 31-5122-04**



Simpson – St Mark retraktor 12,5 cm


Příloha č. 1 kupní smlouvy

Katalogové číslo: 31-5121-10




Úchyt retraktorů (ratchet) flexibilní k extenzi a retrakci v horizontální i vertikální rovině, umožňuje rotaci retraktorů 30 stupňů vlevo/vpravo

Retraktor horního břicha (pro operace ovariálního karcionomu) kabelový navijákový retrakční systém. K resekci nádoru bránice, jater, omentektomie, splenektomie. Tah může být aplikován i z extrémních laterálních pozic, systém elektricky izolovaný

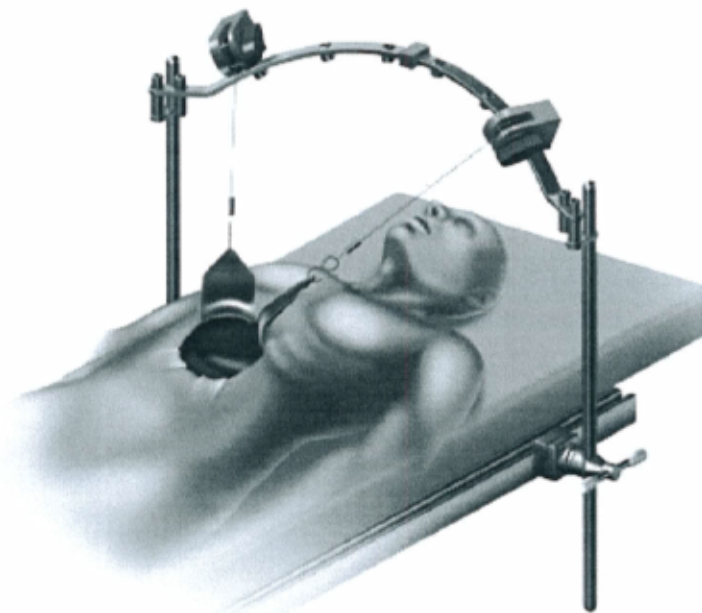

Katalogové číslo: UL7807-11

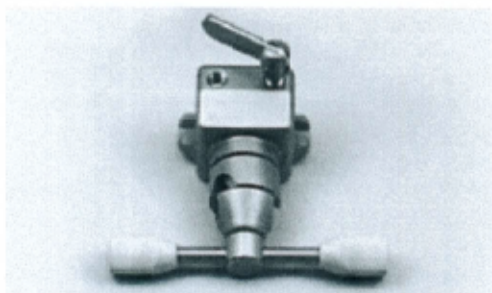

Uchycení na eurolištu operačního stolu

**Katalogové číslo: UL7805-62**



Laterální vertikální tyč 550 mm

**Katalogové číslo: UL7804-63**



Rám standard 630 mm

**Katalogové číslo: UL7804-80**




Rám extra šíře 800 mm

**Katalogové číslo: UL7801-09**



Kabelový navijákový systém, s kabelem délky 88 cm, s variabilní adjustací


**Katalogové číslo: UL7810-39**



Lopatka 65 x 50 x 39


Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: UL7811-42**

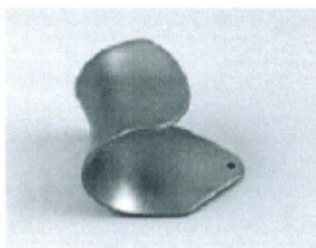

Lopatka 75 x 60 x 42


**Katalogové číslo: UL7812-55**

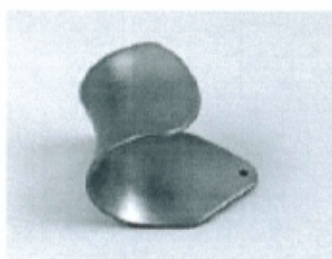

Lopatka 100 x 80 x 55


Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 091-113-260**

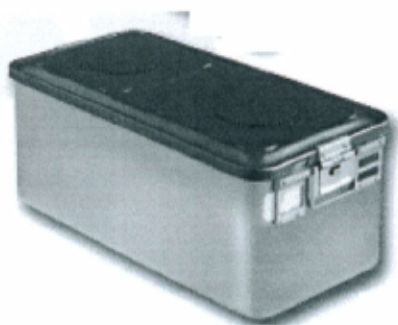


Ventilový kontejner s bezpečnostním víkem 580 x 280 x 260 mm

**Katalogové číslo: 095-220-070**

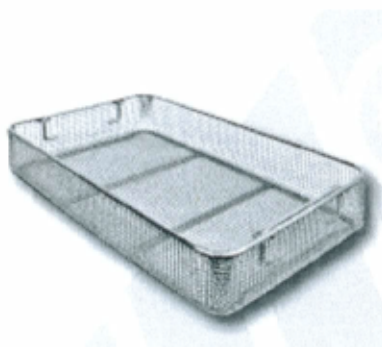

Sterilizační síto 540 x 255 x 70

**Katalogové číslo: 030-200-001, 030-200-400**

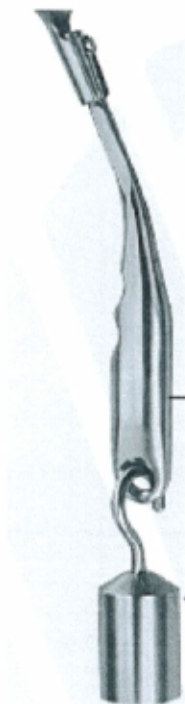

SCHERBAK rukojeť + závaží

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 030-200-030**



SCHERBAK zrcadlo 80x30 mm

**Katalogové číslo: 030-200-035**



SCHERBAK zrcadlo 85x35 mm

**Katalogové číslo: 030-200-040**




SCHERBAK zrcadlo 90x40 mm

**Katalogové číslo: 030-200-060**



SCHERBAK zrcadlo 55x40/60 mm

**Katalogové číslo: 030-200-070**



SCHERBAK zrcadlo 70x45/70 mm



**Katalogové číslo: 90191-24N**



Bipolární pinzeta, rovná, délka 24 cm, povrch branží potažený nepřilnavou vrstvou = "non stick" povrch, šířka branží na distálním konci 2 mm

**Katalogové číslo: 90193-22N**



Bipolární pinzeta, zahnutá pod úhlem 45°, délka 22 cm, povrch branží potažený nepřilnavou vrstvou = "non stick" povrch, šířka branží na distálním konci 2 mm

**Katalogové číslo: 90193-24N**



Bipolární pinzeta, zahnutá pod úhlem 45°, délka 24 cm, šířka branží na distálním konci 2 mm

**Katalogové číslo: 707-303, 90302-30**



Kabel k bipolární pinzetě, 3m, kompatibilní s generátory typu Olympus

**Katalogové číslo: 90030-01**



Rukojeť monopolární elektrody pro průměr 4mm, s 3m kabelem, pro 3-pinové zakončení, ovládání řezu a koagulace z rukojeti bez nutnosti připojení pedálu

**Katalogové číslo: 90032-01**



Monopolární elektroda typu nožíku pro řez, průměr 4mm, pracovní plocha 2,5 x 20 mm, délka nástavce 30 mm

**Katalogové číslo: 90034-02**



Monopolární elektroda typu kuličky pro koagulaci, průměr 4mm, pracovní průměr kuličky 6 mm, délka nástavce 30 mm

**Katalogové číslo: 90800-00**



Bipolární kleště k zastavení krvácení velkých cév, délka 22 cm

Příloha č. 1 kupní smlouvy

**Katalogové číslo: 90800-10, 90302-30**



Bipolární kabel pro kleště, délka 5m, pro generátory typu Olympus