



Název veřejné zakázky: **Skioskopicko-skiagrafický komplet vč. pozáručního servisu a příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1486/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

V příloze č. 2 „Technická specifikace – Multifunkční skioskopicko-skiagrafický komplet s C-ramenem“ jsou v bodě č. 4) Ovládání, zobrazení a interface požadovány mimo jiné i následující parametry zařízení:

- 2 ks medicínský vysoce kontrastní barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 19“ a rozlišením min. 1,2 MPix pro „EKG a ENDO“ obraz ve vyšetřovně

- videopocesory:

Olympus CV 180 - HD-SDI a případně component, s-video, composite

Olympus CV 190 - Full HD výstup HD-SDI 1080i, DVI 1080p, s-video, composite

- UZ videopocesory:

Olympus EU-ME1 - S-video (SDTV), component (SDTV i HDTV)

Olympus EU-ME2 - DVI, HD/SD SDI, composite, component (HDTV)

Předpokládáme, že jeden z těchto monitorů bude použit pro zobrazení EKG křivek a druhý pro zobrazení obrazu ze zařízení Olympus. Postačuje, aby druhý monitor byl vybaven takovými vstupy videosignálu, které by umožňovaly zobrazení alespoň jednoho z výše uvedených videovýstupů u každého ze čtyř uvedených zařízení od firmy Olympus, tzn. např. přes S-video nebo DVI?

- 1 ks multimodalitní lékařská diagnostická stanice HW: diagnostický barevný monitor s úhlopříčkou min. 24“ pro rtg obraz, disková kapacita 500 GB, vnitřní paměť 12 GB DRAM s DICOM připojením (prohlížení RTG obrazů z multifunkční stěny a PACSu)

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadavku, aby minimálně jeden z uvedených monitorů umožňoval zobrazení údajů z EKG monitoru. Oba uvedené monitory musí ale umožňovat zobrazení ze zařízení výrobce Olympus – bude využíváno současné zobrazení jak z uvedených videopocesorů pro endoskopii tak z UZ jednotek pro endosonografii. Zadavatel preferuje využití výstupů HD-SDI u videopocesorů, výstupu HD-SDI u UZ jednotky EU-ME2 a komponentního výstupu u UZ jednotky EU-ME1.


**Dotaz č. 2**

Zadavatel požaduje dodání hardware multimodalitní lékařské diagnostické stanice s DICOM připojením, požaduje také dodání softwarového vybavení pro prohlížení DICOM obrazů?

Odpověď č. 2

Zadavatel požaduje dodání multimodalitní lékařské diagnostické stanice s DICOM připojením pro prohlížení RTG obrazů z vlastní multifunkční stěny a PACS zadavatele – tzn. dodání hardware i software pro prohlížení.

V Ústí nad Labem dne: **26 -02- 2019**

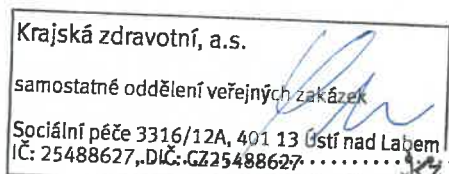

Krajská zdravotní, a.s.
samostatné oddělení veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627

Ing. Václav Štývar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek

