
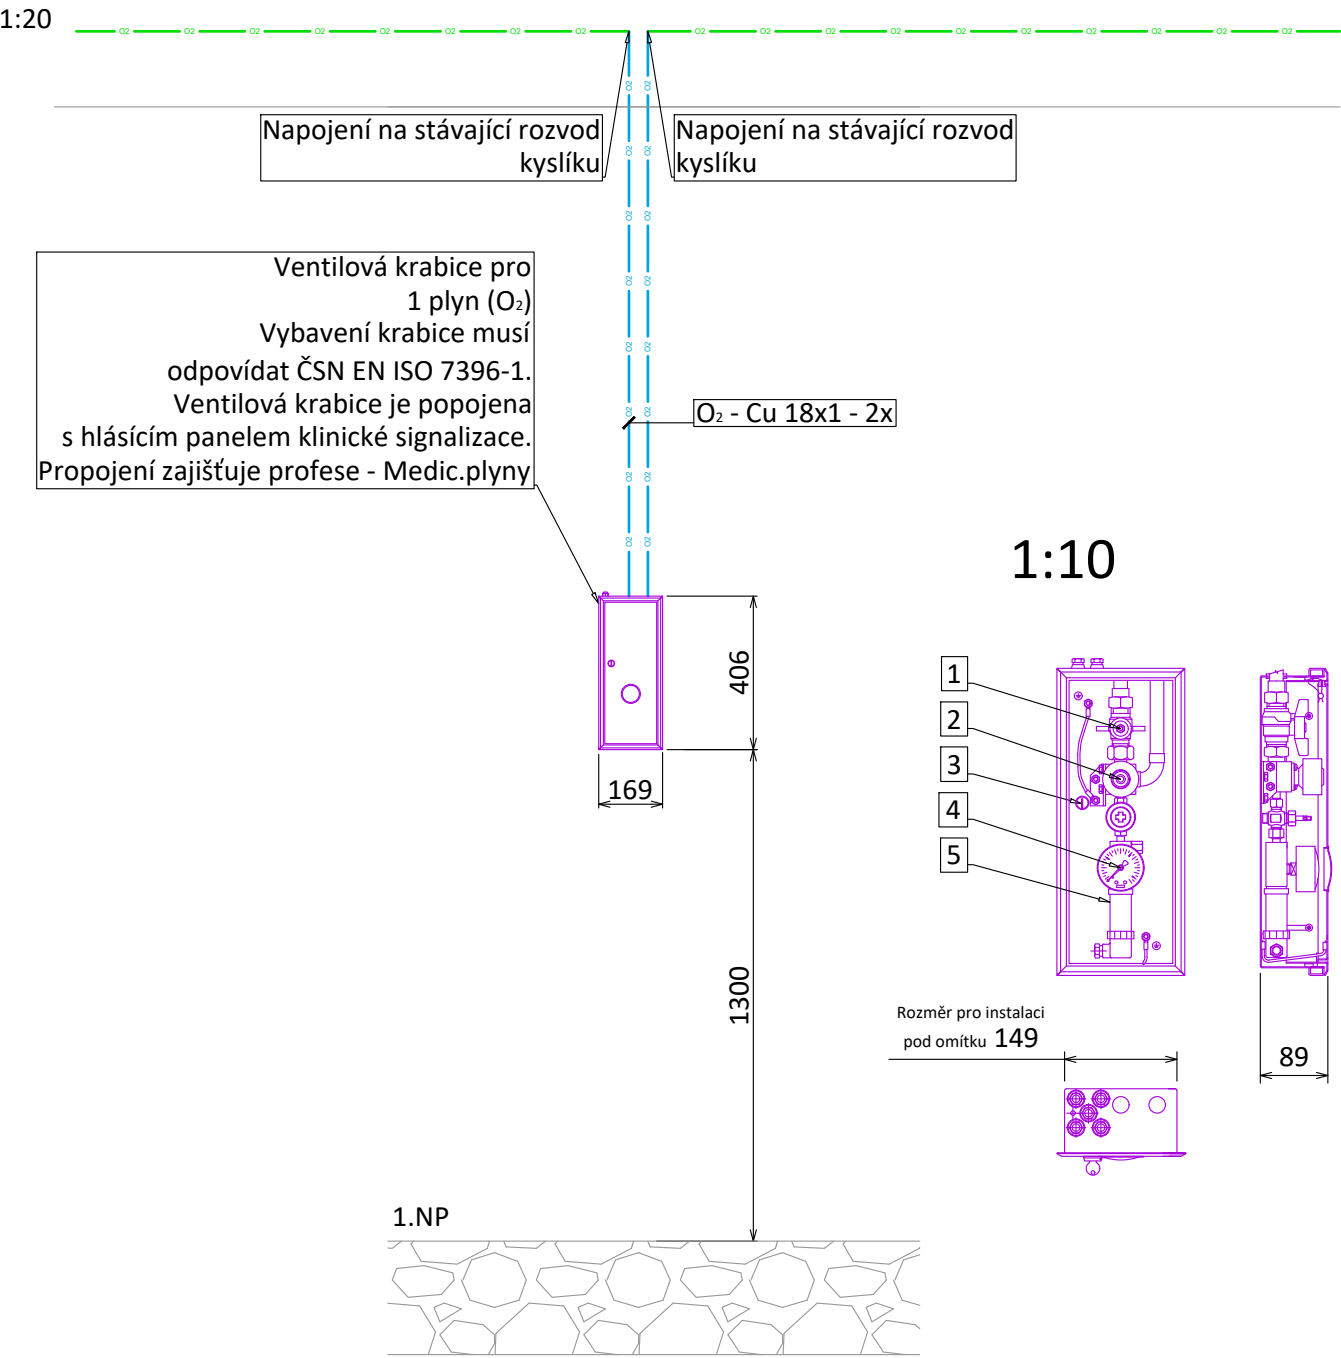


ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L.
IČO 254 17 649 **TEL. 475 622 413**

AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	KRESLIL: JIŘÍ ŠTAJER	 ARCHATELIÉR 2000, a.s.	
PROJEKTANT: JIŘÍ ŠTAJER	KONTOLOVAL: ING. Z. KVAPIL		
OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ		
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L			
ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ N/L		DATUM	12/2018
		STUPEŇ	PD pro PROVÁDĚNÍ
			STAVBY
		MĚŘÍTKO	NENÍ
DETAILY KLINICKÉ SIGNALIZACE MP			ČÍS.VÝKRESU
			D1.4A-04

Výkres č.D1.4A-04

Detail 01




LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar - stávající
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napojení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu



Výkres č.D1.4A-04

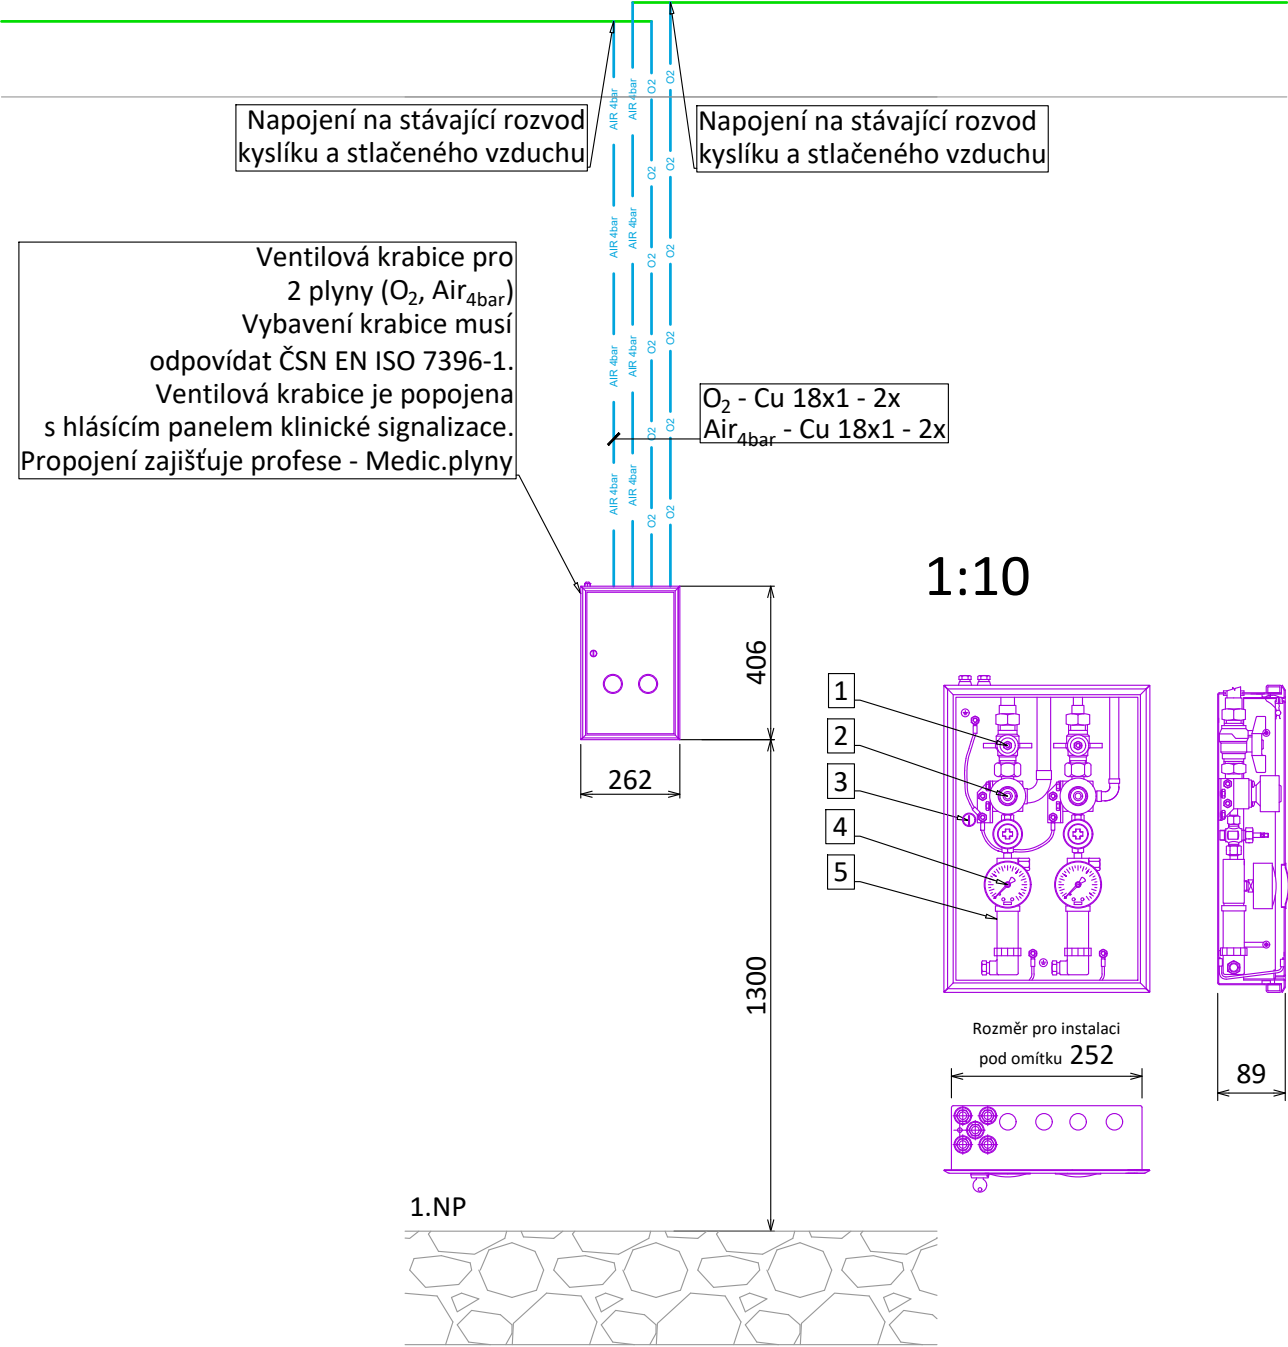

Detail 02

1:20




LEGENDA

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napojení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu

	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
1	Uzavírací ventil
2	Rychlospojka pro napoení na náhradní zdroj - dle druhu plynu
3	Zámek ventilové krabice
4	Kontrolní manometr nebo vakuometr
5	Čidlo klinického alarmu

Detail 04

Podhled



<p>Signalizační hlásič klinického alarmu. Propojeno s ventilovou krabicí. Propojení s ventilovou krabicí zajišťuje profese - Medicinální plyny. Přívod silnoprůdu zajišťuje profese - Silnoprůd</p>
--

139

192

203

145

1500

1.NP

LEGENDA



Signalizační panel klinického alarmu dle ČSN EN ISO 7396-1