



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2216/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 část 4

Dobrý den,
níže posílám dotazy:

1/ Z přiloženého návrhu smlouvy není patrné, jaký spotřební materiál v požadovaném 8-letém pozáručním servisu má být zahrnut do nabídky. Předpokládáme, že se jedná o materiál použitý pro provádění BTK (prohlídek přístroje) a ne o všechny spotřební materiál a materiál podléhající opotřebení. Toto by totiž pro 8-letý provoz přístroje nebylo dost dobře možné vyčíslit a navíc by to nabídkovou cenu násobně prodražilo. Má být tedy součástí cenové nabídky spotřební materiál spotřebovaný při provádění BTK?

Odpověď č. 1 část 4

Ano, v rámci pozáručního servisu je požadován spotřební materiál pro provádění BTK.

Dotaz č. 2 část 4

Z prohlídky místa plnění vyplynulo, že všechny potřebné média a rozvody (upravenou vodu, elektro) zajistí KZ a.s. na základě instalačního plánu vybraného dodavatele. Prosim o potvrzení tohoto postupu.

Odpověď č. 2 část 4

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že KZ, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (vody, medicinálních plynů a elektrické energie) dle instalačního plánu vybraného dodavatele. Zadavatel zde blíže nespecifikoval kvalitu dostupné vody. Z prohlídky místa plnění vyplynulo, že zadavatel je schopen na pracoviště přivést pouze neupravenou (kohoutkovou) vodu nikoliv upravenou – součástí nabídky tedy musí být úpravna vody pro požadovanou kvalitu vody a spotřebu sterilizátoru tak, aby byl systém plně funkční.

Dotaz č. 3 část 3



Dobrý den,

níže posílám dotazy:

1/ Z příloženého návrhu smlouvy není patrné, jaký spotřební materiál v požadovaném 8-letém pozáručním servisu má být zahrnut do nabídky. Předpokládáme, že se jedná o materiál použitý pro provádění BTK (prohlídek přístroje) a ne o všechny spotřební materiál a materiál podléhající opotřebení. Toto by totiž pro 8-letý provoz přístroje nebylo dost dobře možné vyčíslit a navíc by to nabídkovou cenu násobně prodražilo. Má být tedy součástí cenové nabídky spotřební materiál spotřebovaný při provádění BTK?

Odpověď č. 3 část 3

Ano, v rámci pozáručního servisu je požadován spotřební materiál pro provádění BTK.

Dotaz č. 4 část 3

2/ Z prohlídky místa plnění vyplynulo řešení stavební připravenosti a sice, že dodavatel budoucích sterilizátorů bude na svoje náklady provádět na centrální sterilizaci úpravu otvorů a jejich následné zalištování ve stavební přičce a dále osazení povrchových vypínačů k jednotlivým sterilizátorům a propojení kabelem v lištách. Všechny potřebné média a rozvody (tlakový vzduch, upravenou vodu, elektro, ethernet) zajistí KZ a.s. na základě instalačních plánů vybraného dodavatele. Prosím o potvrzení tohoto postupu.

Odpověď č. 4 část 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že KZ, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (vody, medicínálních plynů a elektrické energie) dle instalačního plánu vybraného dodavatele. Zadavatel zde blíže nespecifikoval kvalitu dostupné vody. Z prohlídky místa plnění vyplynulo, že zadavatel je schopen na pracoviště přivést pouze neupravenou (kohoutkovou) vodu nikoliv upravenou – součástí nabídky tedy musí být úprava vody pro požadovanou kvalitu vody a spotřebu sterilizátoru tak, aby byl systém plně funkční.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejných zakázek Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory část 4: Parní sterilizátor – centrální operační sály Nemocnice Most, o. z. a Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory část 3: Parní sterilizátory – centrální operační sály a centrální sterilizace Nemocnice Chomutov, o. z. o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: - 7 -08- 2020

Krajská zdravotní, a.s.


samostatné oddělení veřejných zakázek

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Václav Štyvar

Vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek

Příloha: plánek místa plnění

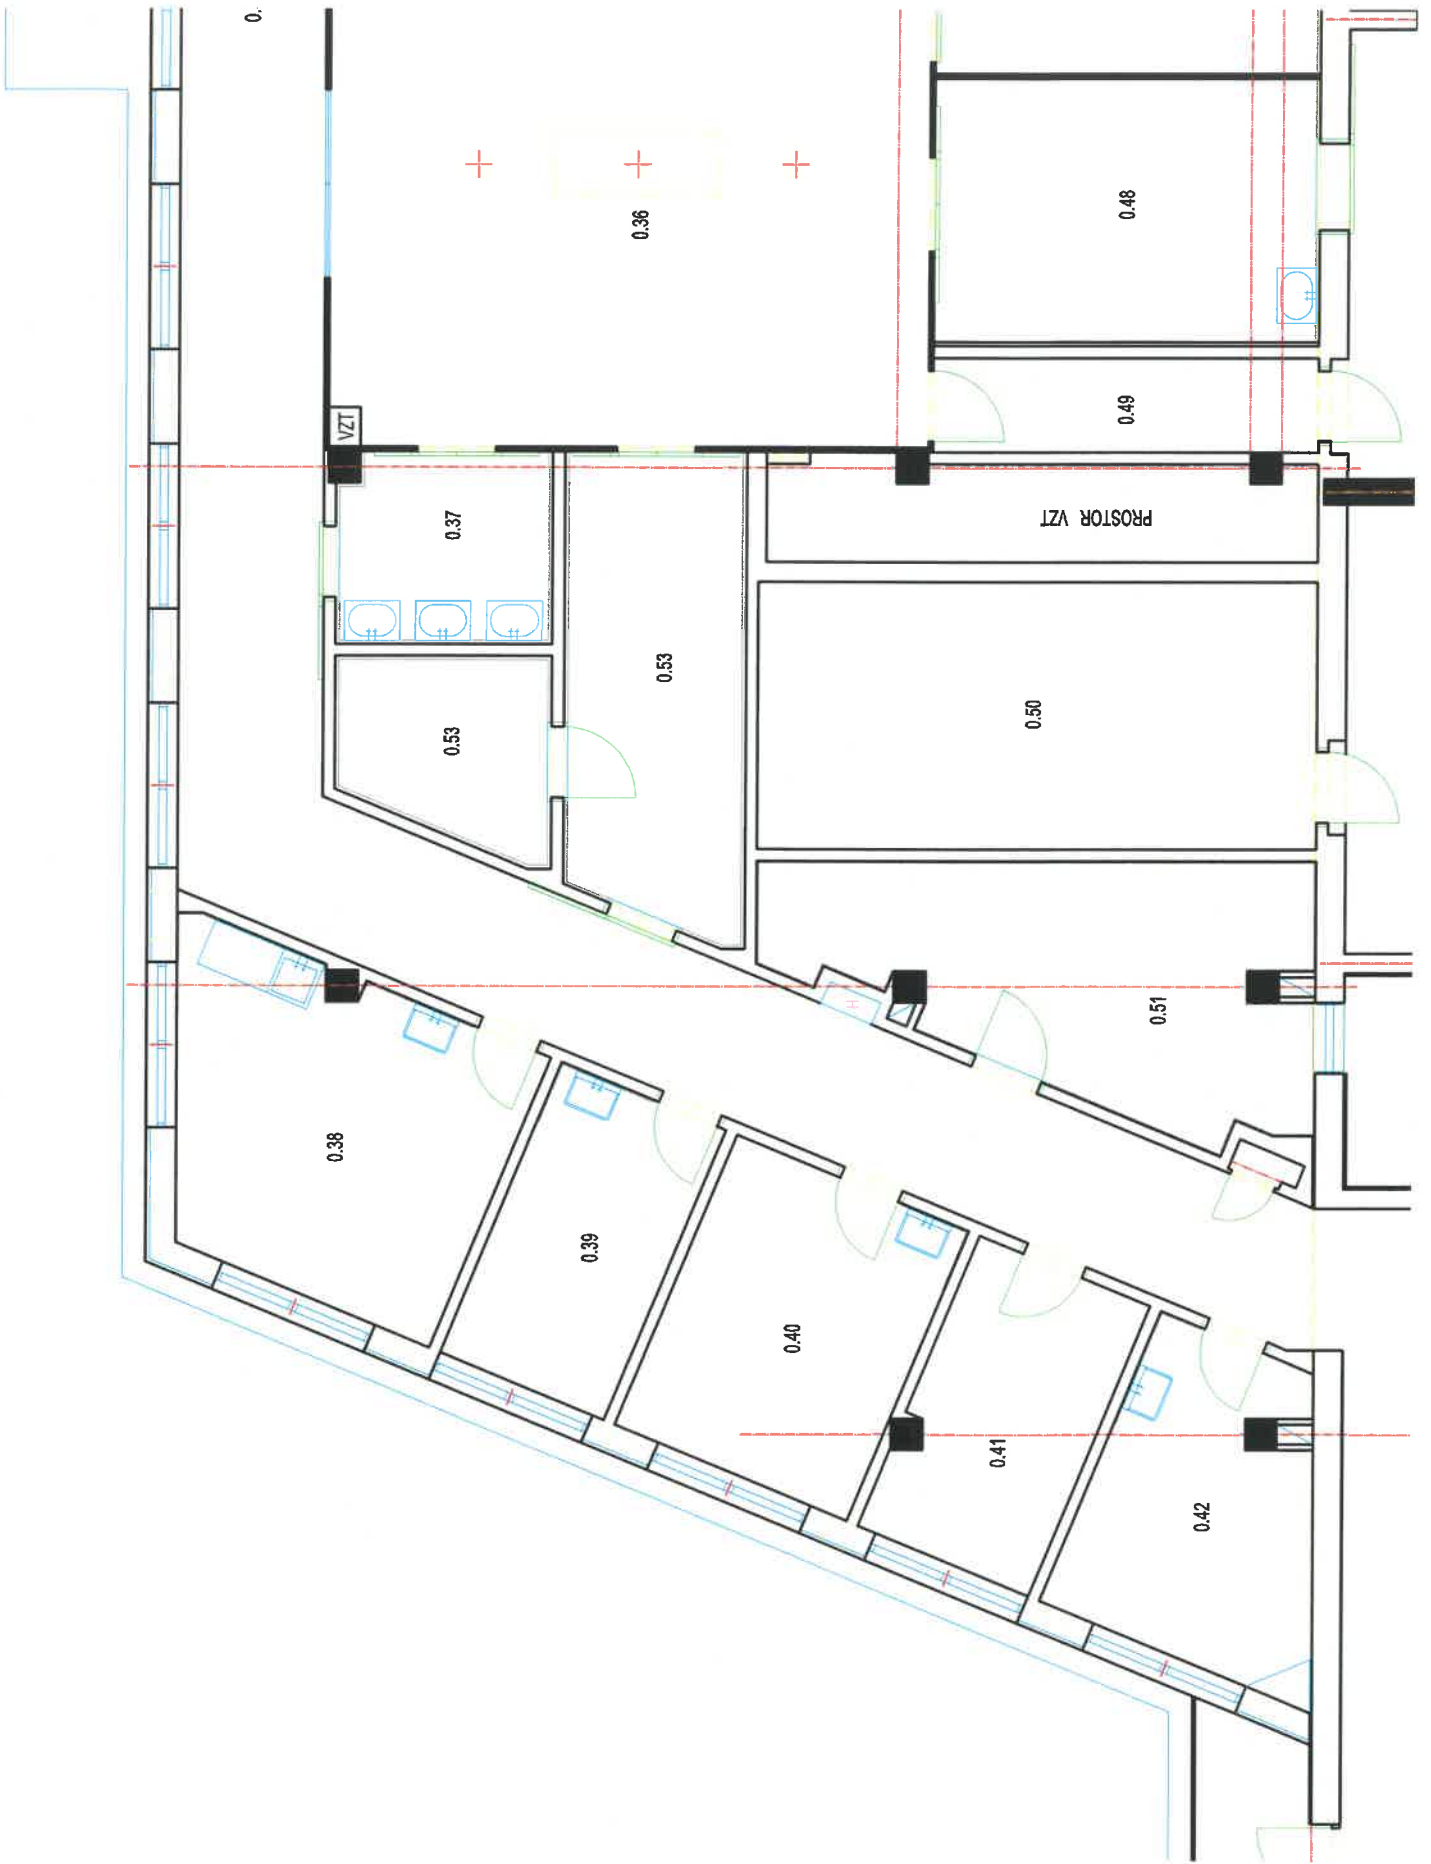

0.

0.36

0.37

0.53

0.53

0.50

PROSTOR VZT

0.49

0.48

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.51

VZT

VZT