

Kupní smlouva

Dnešního dne uzavřely

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

se sídlem: Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč – Praha 6

IČO: 250 990 19

DIČ: CZ250 990 19

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4492

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní údaje: [REDACTED]

Kontakt ve věcech soutěže: [REDACTED]

[REDACTED]

Kontakt ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jako „**kupující**“)

tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem
„**Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I.**“
Část 7 Ultrazvukový přístroj pro Dětské odd. (nemocnice Děčín o.z.)

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu: **Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559**, který je podpořen z 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: Ultrazvukový přístroj ARIETTA 65, (dále i jako "přístroj" nebo "zboží").
2. Předmětem této smlouvy je nákup zboží a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v rámci záruky.
3. Předmětem smlouvy je dále i:
 - doprava zboží do místa plnění,
 - montáž zboží,
 - instalace zboží,
 - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži,
 - vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“),
 - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,
 - záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
 - likvidace obalového materiálu.
4. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 – Nabídka č. 6_07 ze dne 7.8.2020 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 1 237 681,- Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou konečnou a zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuté i veškeré náklady na plnění podle článku I. bod 3.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy je prodávající povinen toto bezodkladně (maximálně do tří dnů) oznámit kupujícímu (e-mailem nebo jiným písemným způsobem), v opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,
- soupis příloh,
- název projektu: Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.
- registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III odst. 2 smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. V případě, že prodávající uvede ve svém daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího.
9. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
10. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu povinné smluvní strany na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 56 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je:

_____ Pověřeným zástupcem kupujícího jsou:
pro Nemocnici Děčín, o.z.

- 1) _____
 - 2) _____
- nebo jiný pověřený pracovník OOKC kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:
 - a. dodání zboží na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. - U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II a
 - b. montáž zboží a
 - c. instalace zboží a
 - d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a

- e. provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a
 - f. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži a
 - g. vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.,
 - h. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb.; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení radionuklidového zdroje, a současně
 - i. likvidace obalového materiálu a
 - j. podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
3. Zvláštní požadavky:
- a. prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře) případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
 - b. kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,
 - c. protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem odboru obslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týmž následkem má, nepřevzme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně její příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvyklé na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).

2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: dvacetčtyři) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a bezpečnostně technické kontroly, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti s dodáním a výměnou opotřebovaných dílů zboží.
7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje pro tento účel určené prodávajícím. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDACTED]
[REDACTED]
8. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisní technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu dle předchozího odstavce.
9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího.
10. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do lhůty uvedené v článku V. odst. 9 smlouvy, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
11. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10 tohoto článku.
12. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,
 - revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.,
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.

13. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.
14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je technik zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností kupujícího. Ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností kupujícího.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9 smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 10 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) zboží.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

VIII.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), musí být tato smlouva uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504, občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.
5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškeré právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 Občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývajících část kupní ceny poníženou o daň prodávajícímu.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
8. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispoziitivními ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
10. Tato smlouva byla uzavřena bez existence tísně či násilí, a je výsledkem svobodné vůle smluvních stran.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
12. Přílohou č. 1 této smlouvy je Nabídka č.6_07, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
13. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty,

výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 - Nabídka č. 6_07

V Praze , dne 27.1.2020

V Ústí nad Labem, dne _____

Za kupujícího

Specifikace nabízeného zboží dle požadavků zadavatele:

Název veřejné zakázky:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I

Část 7 – Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Předmětem nabídky je ultrazvukový přístroj výrobce HITACHI, Ltd. Model Arietta 65 v konfiguraci:

ARIETTA 65	Jednotka prémiového ultrazvukového přístroje ARIETTA 65
	<i>Diagnostický ultrazvukový přístroj navržený pro co nejefektivnější provoz.</i> <i>Funkce prémiových technologií a klinických aplikací migrované z prémiových modelů.</i> <i>Včetně monitoru s úhlopříčkou 21,5" a kloubové rameno monitoru s rotací až o 360 °</i> <i>ARIETTA 65 nabízí následující výhody:</i> <i>„Smooth Workflow“: Ergonomický design a automatizované procesní funkce, Protokol Assistant a automatická optimalizace pro větší univerzálnost a reprodukovatelnost.</i> <i>„Superb Imaging“: HI REZ, Compound Imaging (zlepšené rozlišení kontrastu a potlačení šumu spekli), HdTHI (zlepšené prostorové rozlišení a penetrace) a unikátní technologie zpracování obrazu: Acoustic Noise-Reducing (ANR / NNR) pro jasné a přesné zobrazení.</i> <i>„Snadno použitelné aplikace“: nástroje pro různé klinické použití a přesné hodnocení,</i> <i>4 sondové konektory</i> <i>Protocol Assistant, Auto Optimizer, Cardiac Functions</i> <i>High definition dynamic Tissue Harmonic Imaging (HdTHI)</i> <i>High Resolution Imaging (HI REZ), Compound Imaging</i>
SOP-ARIETTA65-10	DICOM Network software
MP-FX-ALB-6	Keyboard tray
SCLP/W5	Keyboard
EU-9198	CW Servo Unit
EU-9199	Battery Unit
EU-6063	AC adopter for Jelly warmer
MP-FX-AVA-2B-R	Jelly Warmer right side mounting kit
JW -3000U	Jelly warmer
SOP-ARIETTA65-1-LC	Panoramic View software
SOP-ARIETTA65-43LC	RTE software
SOP-ARIETTA65-5-LC	FAM software
SOP-ARIETTA65-7	Flow Profile software
UP-X898MD	Digital SONY B/W Printer – monochromatická termotiskárna
Ultrazvukové sondy:	
L441	Superficial (Peripheral Vessel) probe, 12-2 MHz, 38mm LINEAR
S211	Cardiovascular probe, 5-1 MHz, 90° SECTOR
S31	Cardiac probe (pediatric), 9-2 MHz, 90° PHASED ARRAY SECTOR

Prodejní cena bez DPH	
DPH 21%	
Prodejní cena vč. DPH 21%	

Nabízený přístroj splňuje a překračuje všechny požadavky zadavatele dle technické specifikace předmětu zakázky.

Přístroj: ARIETTA 65

- ARIETTA 65 je ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy
- ARIETTA 65 je koncepčně zcela nový přístroj, který bude do budoucna umožňovat snadný upgrade nových metod
- ARIETTA 65 má vysokou rozlišovací schopnost a kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách
- ARIETTA 65 má přehledný dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, 10,1" s nastavením jasu displeje.
- ARIETTA 65 má 21,5 " monitor s vysokou rozlišovací schopností WXGA++, s možností otáčení a sklánění
- ARIETTA 65 má výškově a stranově nastavitelný pult obsluhy a snadné ovládání z pozice vyšetřujícího
- ARIETTA 65 má 4 aktivní sondové konektory
- ARIETTA 65 má rychlé přepínání aplikačních programů pro snadnou obsluhu
- ARIETTA 65 má podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje.
- ARIETTA 65 má dynamický rozsah systému 272 dB
- ARIETTA 65 má frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1-18 MHz
- maximálně dosažitelná obrazová frekvence přístroje ARIETTA 65 je až 661 fr/s
- váha hlavní jednotky přístroje ARIETTA 65 je 85 kg
- dosažitelná hloubka zobrazení přístroje ARIETTA 65 je prokazatelně až 40 cm
- příkon celého systému včetně monitoru a záznamových zařízení je max. 750 VA
- šířka přístroje ARIETTA 65 je 53,3 cm
- ARIETTA 65 má virtuální klávesnici na dotykovém panelu + plnohodnotnou výsuvnou klávesnici
- ARIETTA 65 má jednotlačítkovou optimalizaci nastavení akvizčních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení). – Auto-Optimizer
- ARIETTA 65 umožňuje bateriový provoz přístroje až 70 min - EU-9199 Battery Unit.
- ARIETTA 65 má grafický STC Gain na dotykovém displeji.
- velikost HDD přístroje ARIETTA 65 je 500 GB a přístroj umožňuje osazení diskem velikosti 1TB
- přístroj ARIETTA 65 je vybaven DVI-D výstupem
- součástí nabízeného přístroje ARIETTA 65 je ohřívač sono gelu JW -3000U Jelly warmer

Pracovní režimy:

- ARIETTA 65 umožňuje černobílý 2D obraz
- ARIETTA 65 umožňuje rotaci B obrazu po 90° na monitoru
- ARIETTA 65 umožňuje barevné dopplerovské mapování, energetický doppler – Power Doppler mode (Directional Power Doppler)
- ARIETTA 65 umožňuje uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji
- ARIETTA 65 umožňuje spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF umožňující snímat rychlosti až -8,02 - +8,02 m/s
- ARIETTA 65 umožňuje kontinuální CW doppler umožňující snímat rychlosti až -16,0 - +16,0 m/s
- ARIETTA 65 umožňuje kontinuální doppler aktivní na všech nabízených sondách.
- ARIETTA 65 umožňuje steerování výseče barevného dopplera u lineární sondy v rozsahu min. až +/-30 stupňů
- ARIETTA 65 umožňuje další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky (mikrocirkulace) - eFlow
- ARIETTA 65 umožňuje Anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – 3 roviny řezu
- ARIETTA 65 umožňuje současné zobrazení černobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase
- ARIETTA 65 umožňuje rychlý a kvalitní triplexní režim (současně B-obraz, Color-Flow, PW Doppler)

- ARIETTA 65 umožňuje simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW, a pokud bude přístroj vybaven softwarem pro tkáňový Doppler, tak také v režimech (TDI/TDI a PW/TDI)
- ARIETTA 65 umožňuje zoom na živém i na zmraženém obraze s možností jeho plynulého posouvání na monitoru
- ARIETTA 65 umožňuje trapezoideální zobrazení na lineární sondě ANO
- ARIETTA 65 umožňuje panoramatické zobrazení na konvexní a lineární sondě, bude plně funkční nejen pro B mod, ale i při použití dopplerovského modu: SOP-ARIETTA65-1-LC Panoramic View software
- ARIETTA 65 umožňuje nastavení až 100 separátních programů (presetů) pro speciální klinické či uživatelské aplikace včetně možnosti nastavení až 4 subpresetů v každém presetu, možnost aktuální registrace nových subpresetů přímo v průběhu vyšetřování
- ARIETTA 65 umožňuje paměťovou smyčku pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, nastavitelná délka smyčky až 63500frm, nebo 900s

Měření, software a vyhodnocování:

- ARIETTA 65 obsahuje základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí atd.
- ARIETTA 65 obsahuje software pro kardiologické a vaskulární měření
- ARIETTA 65 umožňuje doplnění software pro tkáňový Doppler – TDI – možnost dokoupení
- ARIETTA 65 umožňuje pro lepší přehlednost na LCD displeji zobrazení počtu již provedených měření pro každý měřený parametr
- Součástí nabízeného přístroje ARIETTA 65 je kompresní RTE elastografie v reálném čase na konvexní a lineární sondě SOP-ARIETTA65-43LC RTE software
- přístroj Arietta 65 umožňuje měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow): SOP-ARIETTA65-7 Flow Profile software
- ARIETTA 65 obsahuje software pro redukci speclí (šumů) Adaptive Imaging: HI REZ function
- ARIETTA 65 obsahuje software pro compoundní zobrazení: Spatial Compound Imaging

Sondové vybavení:

- lineární vysokofrekvenční elektronická sonda 2-12 MHz
- L441 Superficial (Peripheral Vessel) probe, 12-2 MHz, 38mm LINEAR



L441

Small parts
12 - 2 MHz
38 mm

- fázová elektronická kardiologická sonda 5-1 MHz
- S211 Cardiovascular probe, 5-1 MHz, 90° SECTOR



S211

Cardiology
5 - 1 MHz
90 deg.

- fázová elektronická pediatrická transthorakální kardiologická sonda frekvence 2-9 MHz
- S31 Cardiac probe (pediatric), 9-2 MHz, 90° PHASED ARRAY SECTOR



S31

Cardiology
9 - 2 MHz
90 deg.

- výše uvedené sondy mají nové typy zmenšených (tzv. smart) konektorů, pro snadnou manipulaci a nižší hladinu šumu

Kompatibilita:

- nabízený přístroj Arietta 65 je kompatibilní s níže uvedenými sondami ze stávajícího vybavení dětského oddělení:
 - Konvexní sonda 1-5 MHz 70°, možnost CW Dopplera - C251
 - Mikrokonvexní sonda 4-8MHz 80°, možnost CW Dopplera - C42
 - Lineární sonda 5-18 MHz, možnost CW Dopplera - L64

Archivační zařízení a další vybavení:

- ARIETTA 65 obsahuje interní harddisk,
- černobílý videoprinter je součástí nabízeného přístroje
- ARIETTA 65 obsahuje 3 USB porty na hlavní jednotce sloužícími k připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod., dále 2 USB porty na hlavním operačním panelu
- ARIETTA 65 má možnost přímého tisku obrázků a reportů na PC tiskárně

Další požadavky

- ARIETTA 65 umožňuje doplnění ECG křivka - modul fyziologického signálu (možnost dokoupení)

Specifikace předmětu nabídky:

Vysoce kvalitní ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy

HITACHI ARIETTA 65:

Předmětem nabídky je vysoce kvalitní mobilní ultrazvukový skener vyšší střední třídy, barevný, plně digitální, z produkce výrobce Hitachi model Arietta 65. Nabízený ultrazvukový přístroj obsahuje špičkové technologie Hitachi–Aloka a je vhodný pro běžná i specializovaná vyšetření.


Jedná se o špičkový ultrazvukový diagnostický přístroj vyšší střední třídy ve kterém jsou integrovány nejnovější technologie od vytváření signálu, přes vysílání a příjem až po zpracování a zobrazení.

Tento přístroj vyniká optimalizací produktivity, redukováním časem potřebným pro skenování a zvýšenou propustností při zvýšeném komfortu pro obsluhu i pro pacienta


Doplňková baterie umožní až hodinový provoz nezávislý na elektrické síti (volitelné option)

Pro přístroj je dostupná široká škála ultrazvukových sond. Nová generace sond, které obsahují technologii Single Crystal, Multi-Layer Single Crystal Technology pro vyšší citlivost a vyšší rozlišení a Smart Connector nový zmenšený konektor, který přináší mimo jiné jednodušší manipulaci a nižší hladinu šumu. Ultrazvukový paprsek je snadno a plně kontrolován a zaostřován, digitální zpracování signálů je rychlé a přesné a umožňuje funkce celé řady aplikací pro zpracování obrazu.




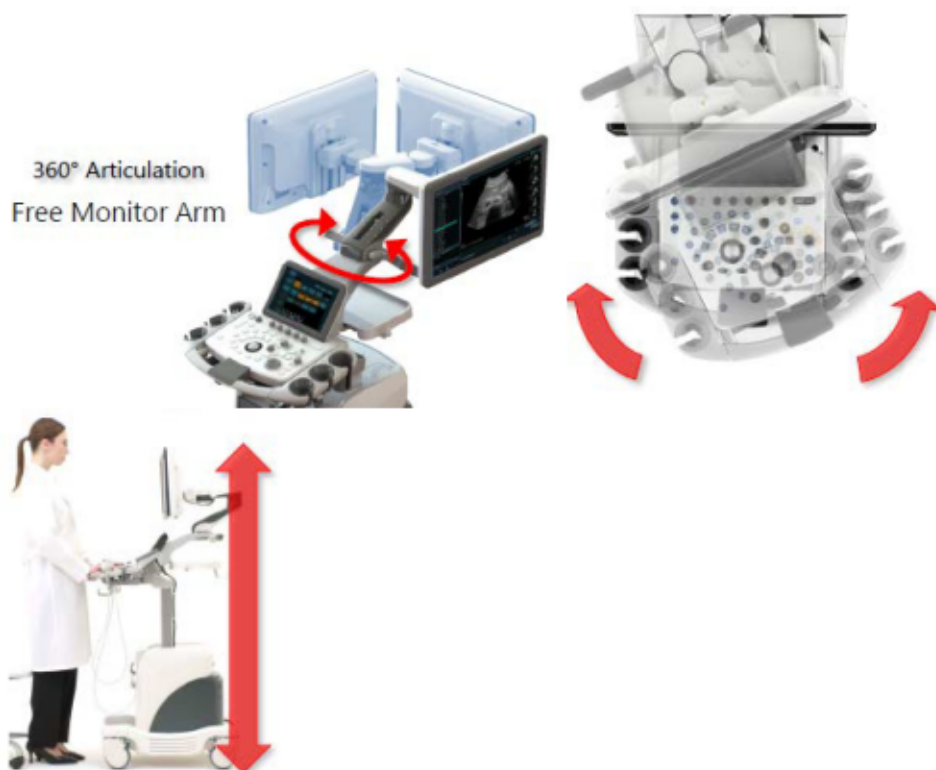

Špičkové řešení ergonomie přístroje, nová úroveň designu s „člověkem v centru“: LCD monitor o velikosti 21,5" s čistým a jasným zobrazením a širokými pozorovacími úhly. Monitor je upevněn na vysoce flexibilním rameni umožňujícím snadné nastavení obsluhou. Široce nastavitelná poloha operačního panelu. Operační konzole s jednoduchým, přehledným a intuitivním použitím, nastavení TGC prostřednictvím dotykového panelu.

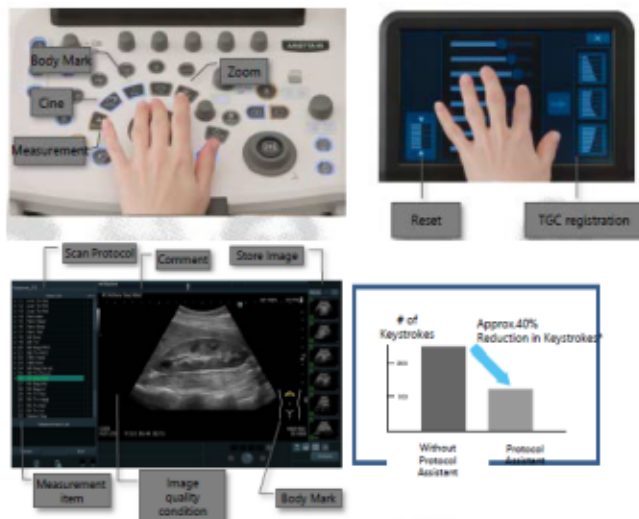

„Intelligent Automatic functions“ - jako Protocol assistant, Auto optimizer, Cardiac function apod. Cardiac function (volitelné option) – výbava z vyšších verzí UZ systémů s mnoha automatickými funkcemi pro rychlé a snadné kardiovaskulární vyšetření.

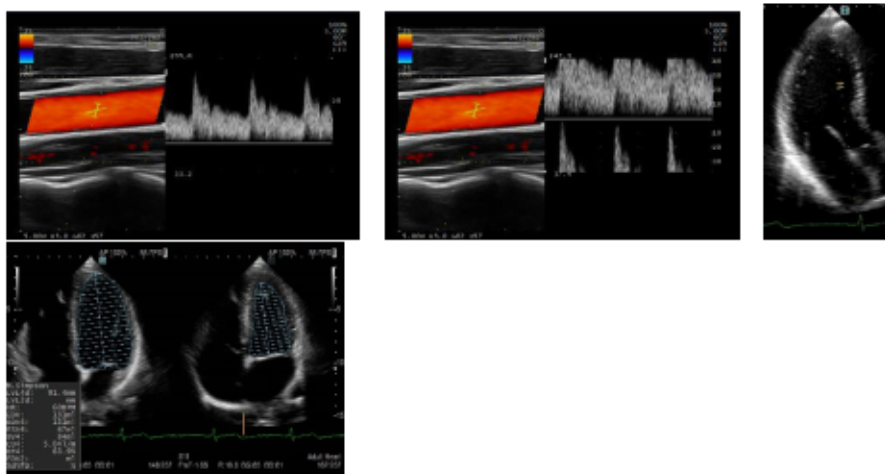

High definition dynamic Tissue Harmonic Imaging (HdTHI) – špičkové prostorové rozlišení a penetrace

High Resolution Imaging (HI REZ) - Zvýraznění tkáňových struktur a zvýšení kontrastu pro získání zobrazení s vyšším rozlišením.

Compound Imaging – přesná vizualizace ohraničení tkáňových struktur, redukce speklí a jasnější zobrazení.

Systém může obsahovat celou řadu doplňkových funkcí jako: Real-Time Tissue Elastography (RTE), kardiovaskulární aplikace, Dual Gate Doppler, Contrast Harmonic Imaging (CHI), Panoramic View, Needle Emphasis, Marking Assist, Auto IMT, Dual Gate Doppler, 2D Tissue Tracking (2DTT) apod.

Ultrazvukový diagnostický přístroj vyšší střední třídy pro běžná i specializovaná vyšetření:

- Plně digitální přístroj nejnovější generace
- 4 aktivní sondové konektory
- Zcela nová generace sond
- Integrovaný Data Management Systém
- 100 programovatelných předvoleb pro speciální klinické (uživatelské) aplikace
- Zobrazovací LCD 21,5" s nastavitelnou výškou, stranově i sklopení
- Výškově nastavitelný ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí, podsvětleté ovládací prvky
- Doplňkový barevný dotykový panel pro ovládání a doplňkové funkce
- USB výstupy
- Vysoce ergonomický design s rozsáhlými možnostmi nastavení
- Snadno mobilní jednotka

Skenovací metody:

Elektronická konvexní

Elektronická lineární

Elektronická fázová, sektorová

Pracovní módy:

- B-mode
- BiPlane mode
- M-mode
- D: Spectral Doppler mode (PW, CW (option), HPRF-PW)
- Dual Gate Doppler mode
- Color Flow mode
- Power Doppler mode (Directional Power Doppler)
- eFLOW mode (Directional eFLOW)

Zobrazovací módy: B: gray-scale imaging, Dual B, Quad B, M, B and M, D: Spectral Doppler (PW, HPRF PW, and CW), B and D, B(Color Flow), B(Power Doppler), B(eFLOW), Dual B(Color Flow), Quad B(Color Flow), Dual B(Power Doppler), Quad B(Power Doppler), Dual B(eFLOW), Quad

B(eFLOW), M(Color Flow), M(Power Doppler), M(eFLOW), B(Color Flow) and M (Color Flow), B(Power Doppler) and M(Power Doppler), B(eFLOW) and M (eFLOW), B(Color Flow) and D, B(Color Flow) and Dual, B(Power Doppler) and D, B(Power Doppler) and Dual, B(eFLOW) and D, B(eFLOW) and Dual, B(Color Flow) and D simultaneous real-time display (Triplex mode), B(Power Doppler) and D simultaneous real-time display (Triplex mode), B(eFLOW) and D simultaneous real-time display (Triplex mode), B and B(Color Flow) simultaneous real-time display (Dual Flow), B and B(Power Doppler) simultaneous real-time display (Dual CF), B and B(eFLOW) simultaneous real-time display (Dual Flow), Dynamic Slow-motion Display (volitelné option), (Real-time image/Slow-motion image, side by side display), Panoramic View (volitelné option), TDI (Tissue Doppler Imaging), Intermittent trigger mode (volitelné option), Monitor Mode*(Fundamental/CHI volitelné option), Real-time Tissue Elastography (volitelné option), Real Time Biplane(Using biplane probe, display a real time 2 section image. Probe dependent.)

Beam former:

Vysílací strana CPWG (Compound Pulse Wave Generator), programovatelný vlnový generátor

Přijímací strana 12-bitový A/D konvertor

Frekvenční rozsah: 1 – 18 MHz

Tissue Adaptive Technology: automatické nastavení rychlosti zvuku v tkáních

Focusing: vysoce přesné vícenásobné zaostřování ultrazvukového paprsku, PixelFocus

Dynamický rozsah systému 272 dB

System Processing Channels: 547 976 Channels

B-Mode

Zoom – Hi Zoom, Pan Zoom,

Rozsah nastavení hloubky 0,75 – 40 cm

M-Mode

Spectral Doppler

Color Doppler Mode

TDI (Tissue Doppler Imaging)

Cine Memory: B mode 63 500 frames, M a D mode: 900 sec.

Data Management – pokročilý inteligentní systém správy a ukládání patientských dat.

Měření a analýzy: základní měření a analýzy i specializovaná měření a aplikace např. pro gynekologii a porodnictví, urologii, malé části, abdominální aplikace, vaskulární, IMT, reporty a další

Jednotka zobrazení fyziologických parametrů (option)

Dual Gate Doppler – zobrazení Doppler spektra ze dvou různých bodů současně, podporuje kombinaci andSupported combinations are PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI

Option (výběr): CW, tiskárna, automatické měření IMT, Elastografie (Real Time Tissue Elastography)

Panoramic View (panoramatické zobrazení), CHI-Contrast Harmonic Imaging (kontrastní echo),

Analýza kontrastního Echa, Analýza TDI, baterie a další...

Pro přístroj je dostupná celá řada ultrazvukových sond pro různé účely použití přesně podle požadavků uživatele (více než 30), bioptické vodiče, adaptéry a další option.....

Napájení: standardní 200-240V 50 Hz, příkon max. 750VA

Rozměry: šířka 53,3 cm, hloubka 72,4 cm, výška 126,5 – 136,5 cm

IEC IEC 60601-1 Ed.3.1: 2012 Class I, Type BF