

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

IMEDEX s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1200/4a, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27510204

DIČ: CZ27510204

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23219

bankovní spojení: ČSOB Factoring, a.s., č.ú. 117057983/0300

jednající / zastoupená: Mgr. Jaroslavem Dufkou

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Dufka

(dále jen „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Helena Luzumová, tel: 477 117 956, e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu

Kontakt ve věcech technických: Ing. Radek Brož, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail: radek.broz@kzcr.eu

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku vyhlášenou dne 9. 1. 2015 na dodávku vybavení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a. s.“ - 2, zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy souvisí s realizací projektů:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL“, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01//08.07649,
„Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně“, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01//08.07650,
„Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově“, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01//08.07653,
„Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.2.01//08.07654,
které jsou podpořeny z Integrovaného operačního programu v rámci 8. Výzvy oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit nabytí vlastnické právo k němu a to k - 1 ks **Transkraniální ultrazvuk Typ B** a 3 ks **Transkraniální ultrazvuk Typ C** (dále jen přístroj nebo zboží) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
2. Dále je předmětem smlouvy montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, , instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností (dále jen OOKC), včetně opakovaných proškolení tohoto personálu v průběhu životnosti zboží a dále záruční servis dle níže uvedených podmínek.
3. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží.) a příloze č. 2 (rozpis cenové nabídky) této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží, nové, nerepasované a nepoužité.
5. Předmětem smlouvy je dále předání zboží ve znění dle článku III. odst. 2 této kupní smlouvy, likvidace obalového materiálu, , a poskytnutí záručního servisu.

II.**Kupní cena zboží**

1. Celková kupní cena zboží je 3 696 000,00 Kč bez 21 % DPH, tj. 4 472 160 Kč včetně 21 % DPH.
2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
3. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím, zvlášť za jednotlivé místo plnění . Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak:

-IČ

-den splatnosti,

-označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

-odvolávka na smlouvu,

-razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,

-soupis příloh,

-název projektu:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL“,

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně“,

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově“,

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“,

-registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01//08.07650, CZ.1.06/3.2.01//08.07649,
CZ.1.06/3.2.01//08.07653, CZ.1.06/3.2.01//08.07654,

-text: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro Váš rozvoj.

4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
5. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
6. Proávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu a provedení veškerých úkonů uvedených v článku III. odst. 2. této kupní smlouvy.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení faktury prodávajícímu k přepracování. Lhůta splatnosti nové faktury začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury kupujícím.
8. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
9. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
10. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího odevzdáním/dodáním zboží.

III.

Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 6 týdnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. O termínu dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Mgr. Jan Vodňanský tel.: 495 260 286 email: imedex@imedex.cz Pověřeným zástupcem kupujícího je pracovník oddělení obslužných klinických činností:
 - 1) Ing. Martin Peterka, tel.: 733594620, email: martin.peterka@kzcr.eu
 - 2) Bc. Pavel Keller, tel.: 731132755, email: pavel.keller@kzcr.eunebo v zastoupení pracovník oddělení obslužných klinických činností o.z.
2. Za předání zboží se považuje:
 - a. jeho dodání na adresu:
 - 1 ks Typ B - Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
 - 1 ks Typ C - Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov,
 - 1 ks Typ C - Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín 2,
 - 1 ks Typ C - Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice,

- b. montáž, instalace, uvedení do provozu, včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (ZDS, výchozí elektrevize, atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů
 - c. instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o proškolení,
 - d. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží,
 - e. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění.
 - f. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
3. Zvláštní požadavky:
- a. Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky
 - b. Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:
 - i. Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.
 - ii. Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.
 - iii. Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.
 - iv. Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:
 - 1. ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)
 - 2. ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET
 - 3. ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25
 - 4. ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

5. ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15
- v. LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.
- vi. Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo keřovací server.
- vii. Prodávající si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:
 1. Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteční síť, požadovanou rychlost portu)
 2. Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)
 3. Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS
- viii. Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s. a dodání přístupového routeru prodávajícím
4. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
5. Protokol o převzetí zboží a o zprovoznění přístroje musí být podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.
6. Nepředá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

IV.

Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (viz čl. III. odst. 1,2 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství a spotřební materiál, které jsou nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisní technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: Mgr. Jan Vodňanský tel.: 495 260 286e-mail: imedex@imedex.cz
7. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 2 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, e-mailem, příp. poštou) vad prodávajícímu.
8. Proávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do 2 kalendářních dnů od nahlášení závady kupujícím, poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do 24 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovož a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
9. V případě, že prodávající neopraví zboží na místě ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 a náhradní zboží nebude poskytnuto do 24 hodin po uplynutí lhůty uvedené v čl. V. odst. 8, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu za každý kalendářní den neprovedení opravy zboží nebo nedodání náhradního zboží. ve výši 0,2 % z ceny reklamovaného zboží
10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit či nebude možné dodržet lhůtu pro poskytnutí náhradního zboží, může být kupujícím písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. Rozhodnutí, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty přináležejí kupujícímu.
11. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním vady.
12. Proávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
 - periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. kontrol el. bezpečnosti dle platné ČSN,
 - v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č.18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.
13. Proávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 264/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi oddělení OOKC kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.
14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik OOKC, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OOKC.
15. Proávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu.

VI.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VII.

Zvláštní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.
2. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
3. Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
4. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.
5. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 (deset) let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 (tří) let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, přičemž se tato lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba týkajícího se projektu.
6. Prodávající se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem Integrovaného operačního programu a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky.
7. Prodávající je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
8. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu a poskytovateli dotace veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem uzavřené smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem uzavřené smlouvy, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem uzavřené smlouvy, účastnit se na výzvu kupujícího a poskytovatele dotace případných jednání a řízení.

VIII.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.
2. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro poštu doporučena písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti příslušnou provozovnou provozovatele poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zámýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
4. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícím.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
8. Příloha č. 1 až č. 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Přílohy:


- 1) Technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží
- 2) Rozpis cenové nabídky
- 3) Předávací protokol zdravotnického prostředku

Ústí nad Labem

V Hradci Králové

dne 18. 5. 2015


IMEDEX s.r.o.


IMEDEX ③
IMEDEX s.r.o., Průmyslová 1200
500 02 Hradec Králové
DIČ: CZ27510204, Tel.: 495 260 286
Mgr. Jaroslav Duška
jednatel společnosti

V

dne 27-05-2015

Krajská zdravotní, a.s.

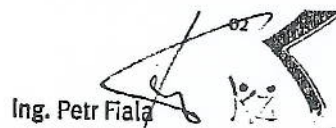
Ing. Petr Fiala
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ27510204

**Vyjádření k technické specifikaci uvedené v dokumentu: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a. s.**



Část 1 Transkraniální ultrazvuky typ B

<u>Minimální technické parametry</u>	vyjádření k požadovaným parametrům - přístroj M- Turbo
Transkraniální ultrazvuk typ B	
<u>Medicínský a terapeutický účel:</u>	
Identifikace cervikálního plexu před operacemi na krčních tepnách, ročně více než 120 operací v cervikálním bloku. Kontrola stavu rány, otok, krvácení. Bedside kontrola průtoku extrakraniálním řečištěm 300 vyšetření/ rok. Sledování průchodnosti mozkových cév transkraniálním dopplerovským vyšetřením, peroperační monitorování stavů po subarachnoidálním krvácení. Cca 30 -40 pacientů ročně.	
<u>Rozměry přístroje</u>	
malý, lehký (cca 3,5 kg),	ano
obrazovka min. 10"	ano
přenosný	ano
přídavný LCD display s úhlopříčkou cca 15"	ano
stojan s připojením a přepínáním do 3 sond zároveň	ano
Snadná obsluha	ano
jednoduché nastavení parametrů příslušnými tlačítky bez nutnosti využívání menu (přímo tlačítko pro auto gain)	ano
<u>Odolnost přístroje</u>	
odolnost přístroje i sondy proti ztrátě funkčnosti při pádu z výšky 1 m na zem (s výhodou tzv. Drop- test)	ano
<u>Parametry</u>	
2D, M-Mode, CW, barevný Doppler (CPD), PWD, TH1, optimalizace obrazu	ano
<u>Zobrazení obrazu</u>	
Optimalizace zobrazení tkáně. Multipaprsková technologie zobrazení, TCD,	ano
<u>Duální zobrazení</u>	
Duplexní zobrazení, Funkce 2x zoom, dynamický rozsah a zisk <u>Rychlý start</u>	ano
nejlépe do 30 vteřin Přednastavení: cévní, TCD, nervové, žilní, možno doobjednat: IMT.	ano
<u>Sonda</u>	
1ks Sonda (Fázové pole) pro TCD a kardiologická (cca. 1-5MHz) 1 ks lineární sondy (cca. 6-13MHz),	ano
Možnost budoucího rozšíření o: další sondy pro všechny věkové kategorie (např i TEE), možnost připojení čtečky čárových kódů	ano
Snadno a rychle realizovatelná měření, jednoduchý report výsledků. Velkokapacitní paměť, touch-pad.	ano
Možnost snadného exportu dat i přes Flash paměť - do PC např. i přes USB port ve formátu (MPEG4, JPEG, BMP, HTML), DICOM 3,	ano
- nastavení délky smyčky (vpřed i vzad) do 60 vteřin	ano
- připojitelnost k digitální síti.	ano
<u>Zdroj energie</u>	
Připojení k el. síti, provoz na baterie alespoň 2 hodiny deklarovaného provozu Přístroje musí umožňovat aplikaci 3sv EKG, Omyvatelnost klávesnice.	ano

M-Turbo® - Produktový list

Základní Technické Informace

Váha v kg: 3,04kg (vč. baterie)
Rozměry (d/š/v) v cm: 30,2 x 27,4 x 7,9
Display: LCD displej s úhlopříčkou 26,4 cm
Dynamický rozsah: až 165 dB
Doba startu přístroje: méně než 20s
Soulad s HIPAA: úplná sada nástrojů

Zobrazovací režimy a funkce optimalizace obrazu

Širokopásmové multifrekvenční zobrazení:
2D / Harmonické zobrazení tkání / M-režim
Rychlostní barevný Doppler / Barevný výkonový Doppler
PW, PW Tkáňový Doppler a CW Doppler, Úprava po zmrazení obrazu
Zpracování obrazu:
SonoADAPT™ Optimalizace zobrazení tkání
SonoHD™ Technologie zobrazení
Pokročilé zobrazení jehly (SonoMBe™ Zobrazení)
Duální a duplexní zobrazení, 2x zoom a panoramatický obraz,
Dynamický rozsah a zesílení

Možnosti měření a výpočtů

Gynekologie/Porodnictví/Plodnost:

Měření průměr/elipsa, objem, deset měření folikulů, odhadovaná váha plodu, zjištěné datum porodu, gestační věk, poslední menses, růstové tabulky, uživatelem definované tabulky, volba tabulek autorů, poměry, index plodové vody, zpráva pacienta, měření humeru a tíle

Cévní:

Měření průměr/elipsa/stopa, objem, objemový tok, průměrové a povrchové redukce v procentech, L/RI CCA, ICA, ECA, ICA/CCA poměr, střední průměrná hodnota času (TAM), vrcholová stopa, korekce úhlu, zpráva pacienta

CIMT (Carotid Intima Media - Tloušťka):

Vestavěný software SonoCalc® IMT (volitelný) - automatická detekce rozhraní s výpočtem střední a maximální tloušťky.

Srdeční:

Balíček automaticky měřeného srdečního výdeje a zpráva pacienta včetně: ventrikulárních, aortických a atriálních měření; ejekční frakce, měření objemu, Simpsonova pravidla, rovnice kontinuity, tlakového poločasů a srdečního výkonu; PA AT, TV E, A, PHT, TVI, MV čas, plicní věny

Transkraniální dopplerovská sonografie (TCD):

Úplný balíček TCD včetně maxima časového průměru (TAP)

Sondy

Širokopásmové a multifrekvenční:

Lineární pole, zakřivené pole, fázové pole, Multiplane TEE, Micro-Konvexní

Monofrekvenční:

Srdeční statická tužka

Uživatelské rozhraní a definovatelné klávesy

Grafická tlačítka pro ovládání pokročilých funkcí

Uživatelsky programovatelné klávesy A a B pro snadnější ovládání

Alfanumerická klávesnice QWERTY

Touch Pad s tlačítky usnadňující obsluhu a navigaci

Ovládací prvky pro Doppler: úhel, směřování, stupnice, časová základna, zisk a objem

Klávesy pro sejmутí obrazu: zobrazení, zpráva, Clip Store, DVD a uložení

Speciální funkce AutoGain a vyšelfovací klávesy umožňují rychlou, snadnou a přehlednou obsluhu

Napájení

Přístroj je napájen ze zásuvky nebo akumulátorem

Výdrž baterie je cca 2 hodiny v závislosti na použití přístroje

Střídavé napětí: univerzální síťový adaptér na 100 - 240 V, 50/60 Hz
výstup 15 V stejnosměrných

Volitelné položky

Vozík s možností připojení 3 sond (v nabídce také nožní přepínač sond)

Externí monitor, tiskárna, čtečka čárového kódu

Úložiště dat na DVD

EKG modul: 3-svodičové EKG pracuje se standardními vodiči a elektrodami EKG

Správa dat


Uložná kapacita 8 GB interní paměti Flash

Možnost uložení 30 000 obrazů nebo 960 2-sekundových klipů

Maximální úložná kapacita v režimu srdečních tepů podle EKG je 10 tepů

Maximální úložná kapacita v režimu času je 60 sekund

Postupné prohlížení až 255 obrázků

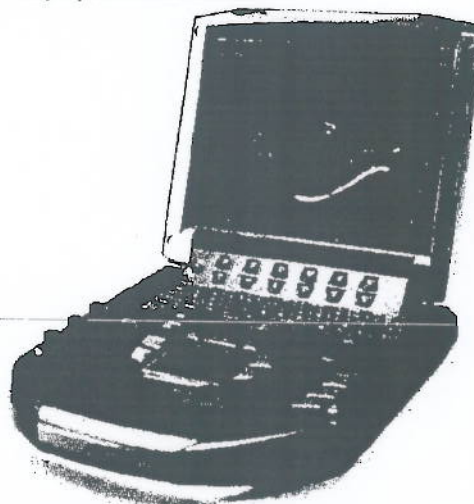

Datový management a komunikace

DICOM® Image Management (TCP/IP):

Tisk a ukládání, Modality Work List - dotazníkový protokol

Funkce Storage Commit

Manažer obrazových dat - PC Workstation Image Management

(TCP/IP nebo USB):

SiteLink™ Image Manager - umožňuje zobrazování, přenos, archivaci, a tisk obrazů nebo klipů ve vysokém rozlišení a kompresi do JPEG na PC.

Funkce přímého zápisu na přenosné velkokapacitní médium USB 2.0 (kompatibilní s PC a MAC).

Podporované formáty pro export: MPEG4 (H.264), JPEG, BMP a HTML.

Bezdrátové připojení:

Bezdrátový adaptér SonoRoam™ Technology s 802.11 b/g USB.

SonoRemote™ Control - Bluetooth® dálkové ovládání bezdrátovou technologií

Měřicí nástroje, piktogramy a anotace

2D: kurzory pro měření vzdáleností, elipsa a ruční měření

Dopplerův jev: Měření rychlosti, tlakový poločas, výpočty průtoku, automatické a ruční měření

M-režim: Měření času a vzdálenosti, výpočet tepové frekvence

Uživatelsky volitelný text a piktogramy

Uživatelsky definované popisy podle specifických aplikací

Pokyny pro biopsii

Externí video a audio (volitelně)

S-video (in/out) k připojení videorekordéru nebo DVD pro záznam a přehrávání

RGB výstup nebo DVI na externí monitor LCD

Videovýstup (NTSC / PAL) do videorekordéru nebo DVD, videotiskárny nebo externího monitoru LCD

Integrované reproduktory

Výstup pro externí reproduktory

Technický popis předmětů a technologického řešení

Část 1 Transkraniální ultrazvuk typ C

Nabízený přístroj: Transkraniální ultrazvuk – transkraniální dopplerovský přístroj	
Obchodní název a typové označení přístroje	DigiLite™+IP™
Výrobce přístroje	RIMED – Izrael

Minimální technické požadavky:


Medicínský a terapeutický účel	
Diagnostika a léčba cévní mozkové příhody – TIA, mozkový infarkt, SAK. Dále za účelem ověření stupně stenóz mozkových tepen. Bude použit i k léčbě trombotických stavů způsobujících mozkový infarkt. Ultrazvukový přístroj vybavený TCD sondou s možností mechanické UZ tripse trombu kontinuálním dopplerovským monitoringem. Počet pacientů cca 350-550 pacientů ročně.	
Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný s polohovacím monitorem	ANO
Monitor s úhlopříčkou alespoň 15" typu LCD/TFT s vysokou rozlišovací schopností , s možností výškového nastavení, otočení, sklopení	ANO
Vysoká obrazová frekvence, min.500/obr. za sekundu	ANO
Pulzní generátor umožňující aktuálně měnit modulaci signálu	ANO
Možnost čistého harmonického zobrazení	ANO
Možnost připojení min. dvou sond současně	ANO
Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních pre-setů včetně jejich ukládání	ANO
HDD musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě min. 120GB	ANO
Možnost archivace na USB, CD, DVD a PACS	ANO
Možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI, event. M-JPEG	ANO
Komunikační nástroje DICOM - Storelist, Printlist, Worklist	ANO
Požadovaná zobrazení Duplex, triplex dle typu sond	ANO
A Mode, B Mode	ANO
D Mode pro transkraniální doppler s funkcí barevného mapování	ANO
B Mode na základních frekvencích	ANO
B Mode na harmonických frekvencích	ANO
CW kontinuální doppler	ANO
PW pulsní doppler	ANO
Možnost duálních dynamických zobrazení	ANO
Rychlostní a barevný doppler	ANO
Požadovaný post procesing	ANO
Možnost měření a zoom v reálném čase a hold image	ANO
Funkce Cine-Lope min. 30s	ANO
SW pro včasnou detekci a hodnocení míry poškození cévních	ANO

IMEDEX

struktur na základě analýzy elasticity cévní stěny, rychlosti šíření a intenzity pulzní vlny	
Parametry sond	
Jedna sonda pro cévní vyšetření karotických a vertebrálních tepen (extrakraniálních tepen) – Lineární 5 až 10 MHz	ANO
Jedna sonda pro vyšetření intrakraniálních tepen (TCD, TCSS)	ANO
HW, SW vybavení a příslušenství pro akutní léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou sonotrombotipsi.	ANO
Požadovaný post-procesing	ANO
Možnost měření a zoom v reálném čase a hold image	ANO
Funkce Cine-Lope min. 30s	ANO
SW pro včasnou detekci a hodnocení míry poškození cévních struktur na základě analýzy elasticity cévní stěny, rychlosti šíření a intenzity pulzní vlny	ANO

V Hradci Králové dne 18. 5. 2015


Za uchazeče:

 **IMEDEX** 
IMEDEX s.r.o., Průmyslová 1200
500 02 Hradec Králové
DIČ: CZ27510204, Tel.: 495 260 285

Mgr. Jaroslav Dufka,
jednatel

RIMED 
For your peace of mind

Digi-Lite™ IP™

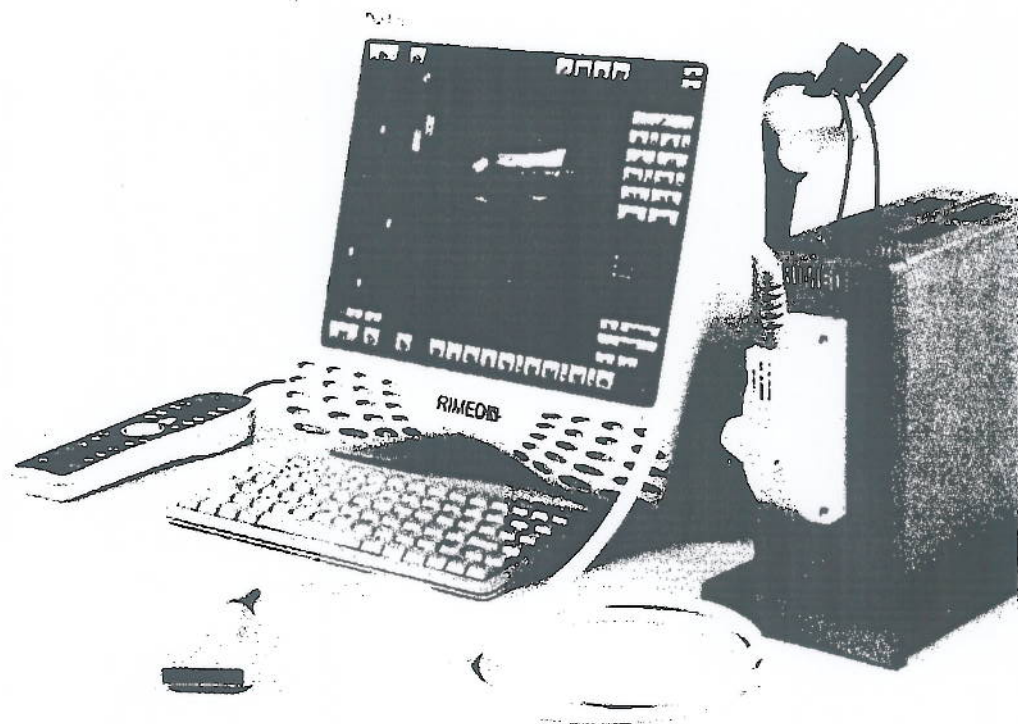

Je komplexní digitální neurosonologickou jednotkou umožňující provádět diagnostické a terapeutické výkony dle současných neurologických standardů. Sestává se z přenosného TCD přístroje a modulu pro zobrazení extrakraniálních tepen IP.

Zobrazení – lineární mód

B- mode , B/M mode

Barevný doppler mode, Power doppler a Directional Power Doppler mode

B+CFM/PDI/DPDI+PWD (Triplex)

Tissue Harmonic Imaging (THI)

Barevná škála: 256 barev

Plné zobrazení dynamického i statického UZ obrazu.

Až 600 fps (dle zvolení hloubky, úhlu a HLD – High Line Density nastavení)

Smyčka záznam/play

Zoom: od 60% do 600% ve všech modech (Scan, Freeze, B, B+B, 4B, Doppler modes, M-zoom, re-play smyčka 60 s.

Barevný Doppler

PRF volitelné: 0.5-10 kHz

Real-time prostorový filter: 4 hodnoty nastavení

B/Color kontrola priority

Transparent Color Mapping (TCM): 10 hodnot nastavení

Pulsní Wave Doppler

PRFM volitelné 1-10 kHz

Automatické nastavení: baseline, invert, PRF

Sondy

Multifrekvenční sonda lineární sonda 5 MHz až 10 MHz

Zobrazení – TCD mód

320 Gatový M-Mode

Až 8 simultánně snímaných hloubek je využito pro skenování celé délky sledované arterie

256 barev spektra

Možnost připojení sond v rozsahu 1- 16 MHz

2x2 PW MHz sondy pro bilaterální dlouhodobý monitoring

Automatické rozpoznání sondy

Další vybavení a vlastnosti

Fixační helma pro dlouhodobý monitoring LMY3

Transportní vozík

Externí 22" monitor na výškově i směrově rameni

Plně dotykové ovládání z interního i externího monitoru

Dálkové ovládání

Bezdrátová klávesnice s touchpadem


Možnost připojení TCCS sondy

Datové formáty:


Ukládá video a obraz ve formátech:

AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DCM (DICOM), DCM (DICOM-JPEG)






Automatické kalkulace naměřených parametrů pulsatility a rezistence

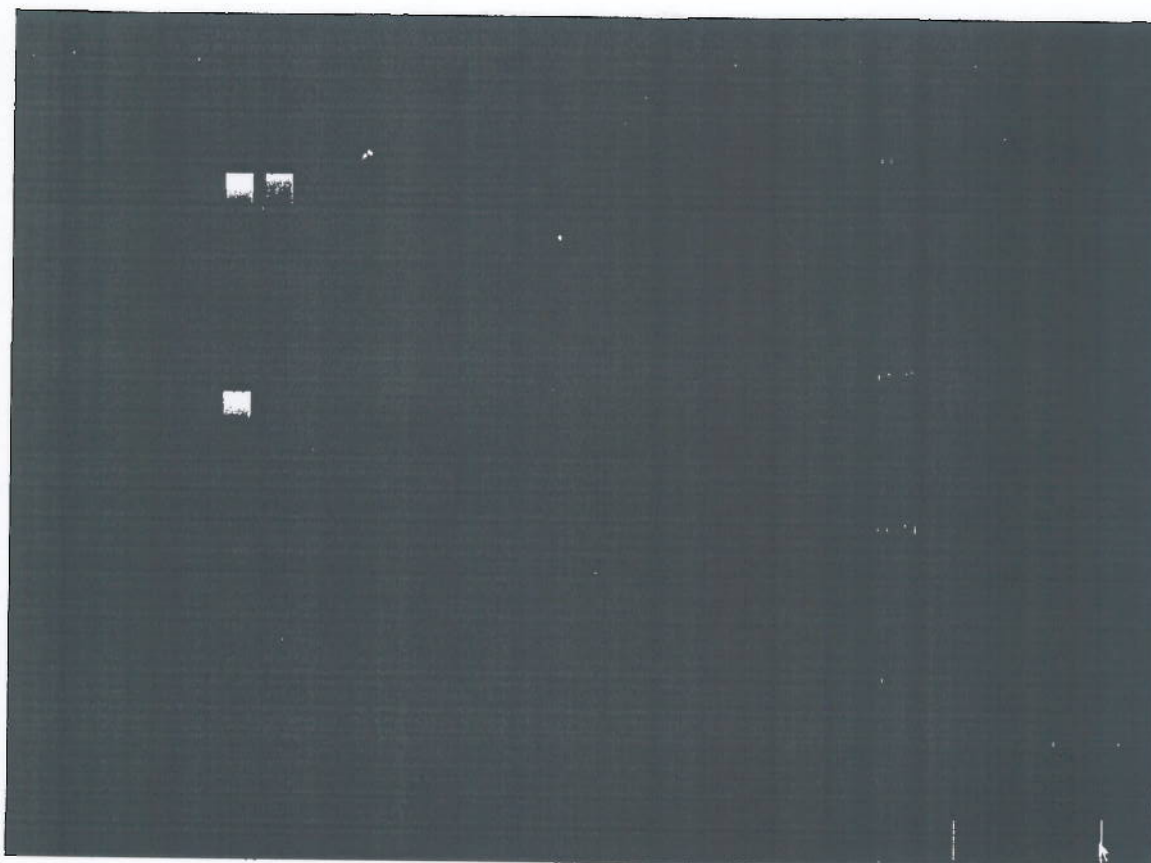






Příklad zobrazení lineární sondou

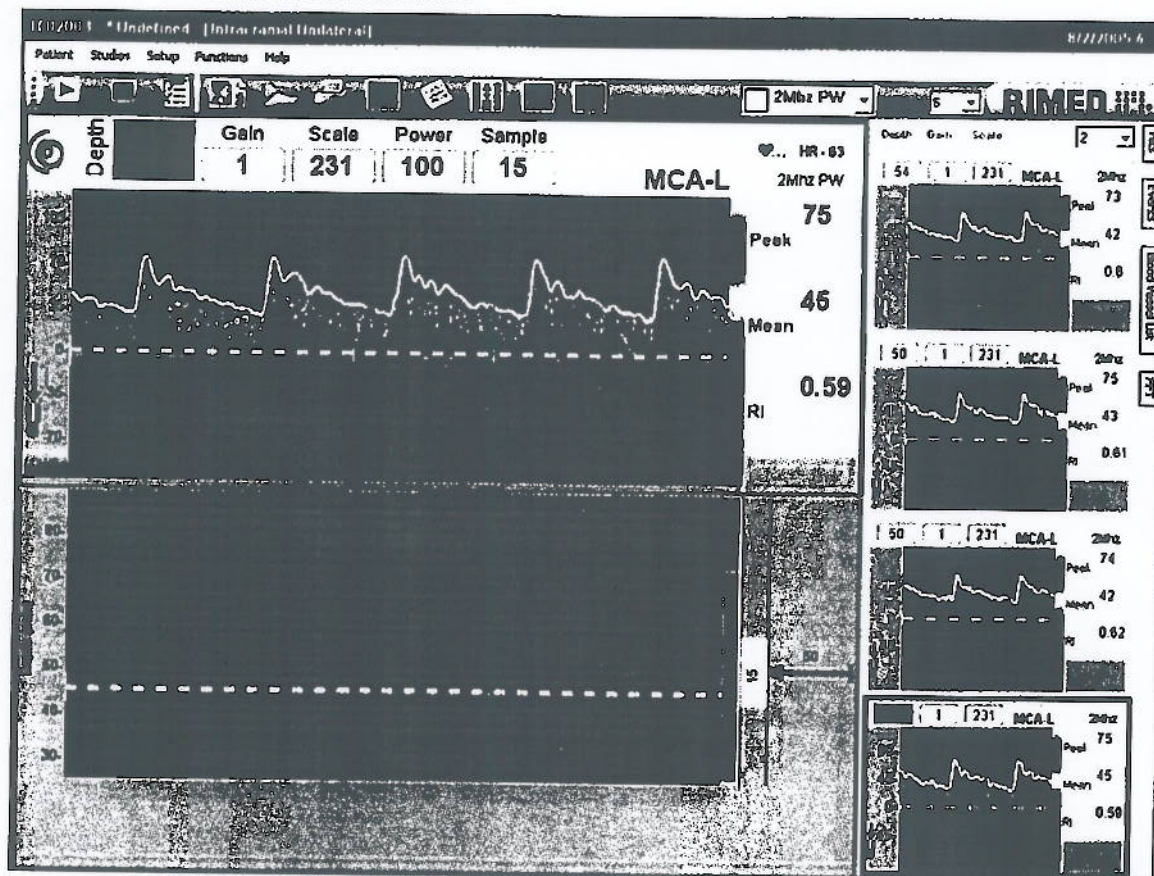


Příklad zobrazení TCD

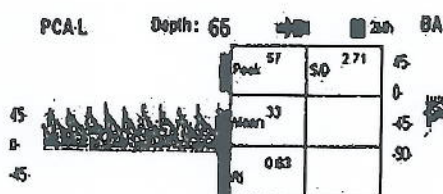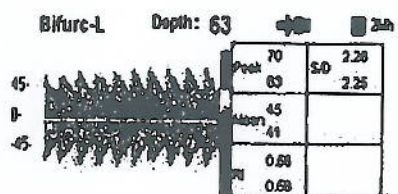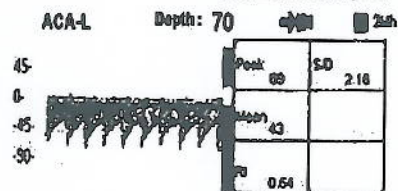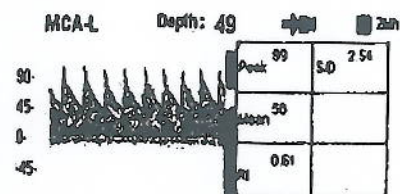

Intracranial Evaluation

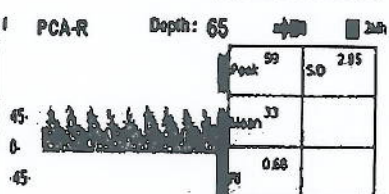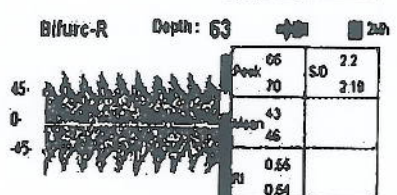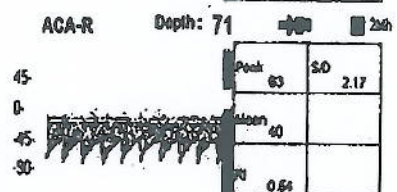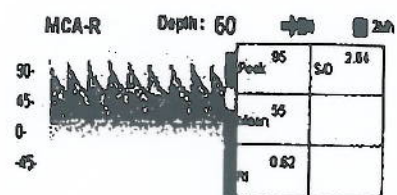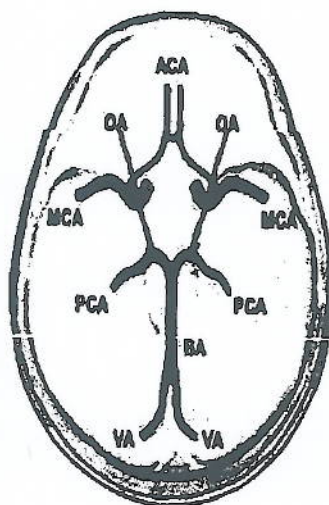

Sumární report TCD vyšetření

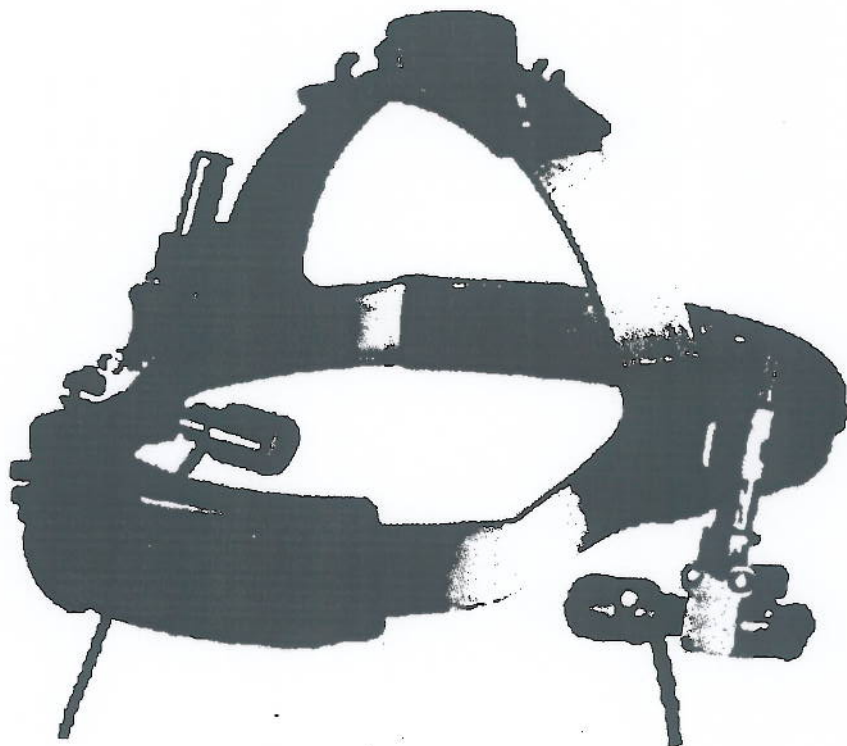

Fixační helma pro bilaterální monitoring

IMEDEX s.r.o.
Průmyslová 1200
50002 Hradec Králové
Česká republika

IČ: 27510204
DIČ: CZ27510204

OR KS Hradec Králové odd C, v. 232191ČP 1000582794

mobit: 724940406
www: www.imedex.cz
e-mail: imedex@imedex.cz

tel.: 495260286
fax: 495260285



Vystavená nabídka

NV14169

IMEDEX

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 25.03.2015
platnost do: 31.12.2015

Vystavil(a): Zálišová

Odběratel

Krajská zdravotní a.s.

Sociální péče 3316/12A
40113 Ústí n.Labem
Česká republika

Konečný příjemce

Krajská zdravotní a.s.

Sociální péče 3316/12A
40113 Ústí n.Labem
Česká republika

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SonoSite M-Turbo vč. příslušenství <i>Transkraniální ultrazvuk</i>		1,00 ks	1 240 250,00	21 %	1 240 250,00	260 452,50	1 500 702,50
Digi-Lite™ IP vč. příslušenství <i>Transkraniální ultrazvuk</i>		3,00 ks	818 583,33	21 %	2 455 750,00	515 707,50	2 971 457,50

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	3 696 000,00	776 160,00	4 472 160,00
CELKEM	3 696 000,00	776 160,00	4 472 160,00

Sleva v %: 0,00
Celkem s DPH: 4 472 160,00 Kč

IMEDEX ③
IMEDEX s.r.o., Průmyslová 1200
500 02 Hradec Králové
DIČ: CZ27510204. Tel.: 495 260 286
Razítko a podpis

Příloha č. 3 návrhu smlouvy:

Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel: IMEDEX s.r.o. IČ: 275 10 204 DIČ: CZ275 10 204 Adresa: Průmyslová 1200/4a, 500 02 Hradec Králové tel: 495 260 286 email: imedex@imedex.cz	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Kochova 1185 430 12 Chomutov

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
Transkraniální ultrazvuk typ C	Digi-Lite™ IP, vč. příslušenství	Digi-Lite™ IP, výrobce Rimed

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet
Sonda	2x2MHz		Rimed	1
Sonda	Sonda lineární 5-10 MHz		Rimed	1
Fixační držák	Fixační držák LMY-3		Rimed	1
Modul IP	Modul IP		Rimed	1
Dálkové ovládání	Dálkové ovládání		Rimed	1
Transportní vozík	Transportní vozík		iTD	1

Klasifikační třída ZP (třída rizika): IIa

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 36 měsíců.

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 120 měsíců, firmou IMEDEX s.r.o.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

Příloha č. 3 návrhu smlouvy:
Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel: IMEDEX s.r.o. IČ: 275 10 204 DIČ: CZ275 10 204 Adresa: Průmyslová 1200/4a, 500 02 Hradec Králové tel: 495 260 286 email: imedex@imedex.cz	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. U Nemocnice 1 405 99 Děčín 2

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
Transkraniální ultrazvuk typ C	Digi-Lite™ IP, vč. příslušenství	Digi-Lite™ IP, výrobce Rimed

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet
Sonda	2x2MHz		Rimed	1
Sonda	Sonda lineární 5-10 MHz		Rimed	1
Fixační držák	Fixační držák LMY-3		Rimed	1
Modul IP	Modul IP		Rimed	1
Dálkové ovládání	Dálkové ovládání		Rimed	1
Transportní vozík	Transportní vozík		iTD	1

Klasifikační třída ZP (třída rizika): IIa

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 36 měsíců.

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 120 měsíců, firmou IMEDEX s.r.o.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

Příloha č. 3 návrhu smlouvy:
Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel: IMEDEX s.r.o. IČ: 275 10 204 DIČ: CZ275 10 204 Adresa: Průmyslová 1200/4a, 500 02 Hradec Králové tel: 495 260 286 email: imedex@imedex.cz	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Duchcovská 53 415 29 Teplice

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
Transkraniální ultrazvuk typ C	Digi-Lite™ IP, vč. příslušenství	Digi-Lite™ IP, výrobce Rimed

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet
Sonda	2x2MHz		Rimed	1
Sonda	Sonda lineární 5-10 MHz		Rimed	1
Fixační držák	Fixační držák LMY-3		Rimed	1
Modul IP	Modul IP		Rimed	1
Dálkové ovládání	Dálkové ovládání		Rimed	1
Transportní vozík	Transportní vozík		iTD	1

Klasifikační třída ZP (třída rizika): IIa

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 36 měsíců.

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu 120 měsíců, firmou IMEDEX s.r.o.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

Příloha č. 3 návrhu smlouvy:
Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel: IMEDEX s.r.o. IČ: 275 10 204 DIČ: CZ275 10 204 Adresa: Průmyslová 1200/4a, 500 02 Hradec Králové tel: 495 260 286 email: imedex@imedex.cz	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
Transkraniální ultrazvuk typ B	SonoSite M-Turbo, vč. příslušenství	SonoSite M-Turbo, výrobce SonoSite

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet
Sonda	P21x/5-1MHz sonda		SonoSite	1
Sonda	HL38x/13-6Mhz sonda		SonoSite	1

Klasifikační třída ZP (třída rizika): IIa

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu **60 měsíců** na přístroj SonoSite

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu **120 měsíců**, firmou A.M.I. – Analytical Medical Instruments s.r.o.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: