

Poskytnutí dodatečných informací č. 6

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.-2“

V příloze 02 ZD – Technické specifikace, bod č. 1, Extrakorporální litotryptor – 2 ks zadavatel požaduje:

Generátor rázů:

- Fokusovaný zdroj rázových pulzů s min. dvěma ohnisky
- Fokusační hloubka min. 160 mm

Dotaz č. 1:

Akceptuje zadavatel nabídku extrakorporálního litotryptoru světového výrobce, plně splňující medicínský účel, vynikajících vlastností a s kvalitními výsledky terapie s jedním velkým ohniskem, což je výhodné např. při terapii malých kamenů, které se při respiraci pohybují a v případě malého ohniska se mohou pohnout mimo fokus s vysokou pravděpodobností vedlejších účinků?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na splnění požadavku uvedeného v technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

Akceptuje zadavatel nabídku extrakorporálního litotryptoru s penetrační hloubkou od výstupu čočky do centra ohniska 140 mm, ale s výhodou se vzdáleností ke konci fokusu až 215 mm (axiální velikost fokusu je tedy min. 145 mm)?

Odpověď č 2:

Zadavatel trvá na splnění požadavku uvedeného v technické specifikaci.

Ovládací konzole:

- Ovládací konzole pro vládání od stolu
- 1x LCD monitor pro zobrazení snímků z RTG či UZ přístroje
- Systém (např. 1x LCD dotykový monitor) pro nastavení všech parametrů litotryptoru a polohování pacienta
- Mobilní ovládací konzole pro nastavení parametrů litotryptoru a polohování pacienta

Dotaz č. 3:

Akceptuje zadavatel nabídku extrakorporálního litotryptoru světového výrobce, plně splňující zamýšlený medicínský účel s jinou filozofií ovládání přístroje a to 2x RTG monitor na monitorovém vozíku C ramene, UZ monitor a přenosný centrální ruční ovladač s LCD displejem pro ovládání systému terapeutické jednotky rázových vln, patientského stolu, motorizované anulace mobilního RTG přístroje s C ramenem, včetně ovládání spouštění skiaskopie?


Odpověď č 3:

Zadavatel akceptuje uchazečem nabízené jiné technické řešení ovládání kompletu.

V Ústí nad Labem dne:

12-06-2013

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

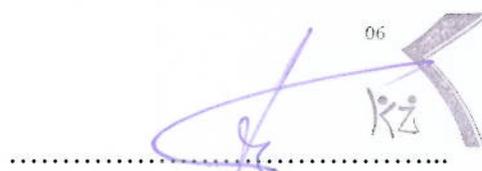

Ing. Petr Fiala
generální ředitel