



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Laser pro urologické výkony - Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2820/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz

Zadavatel požaduje výkon laseru 150 W a pulzní energii 6 J. Účastník nabízí přístroj o maximálním výkonu 120 W a pulzní energii 6 J. Výkon 150 W dodává pouze jeden dodavatel na trhu. Z běžné praxe vyplývá, že pro metody HOLEP a dezintegraci konkrementů se používají výkony do 100 W a vyšší výkony mohou ohrozit pacienta nadměrným zahříváním operačního pole.

Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat laserový přístroj o maximálním výkonu 120 W a pulzní energii 6 J?

Odpověď na dotaz

Zadavatel disponuje informacemi, že urologický holmium laser s výkonem 150 W má ve svém portfoliu a nabízí více než jeden dodavatel.

Tvrzení, že použití výkonu vyššího než 100 W může ohrozit pacienta nadměrným zahříváním operačního pole je zavádějící. Termální poškození lze způsobit při nesprávné aplikaci laseru i daleko menším výkonem (např. 30 W). Při správné indikaci lze pro léčbu pacienta bezpečně použít vyšší výkon.

Zadavatel má k dispozici studie dokládající bezpečné použití výkonu 140 W pro metodiku HoLEP.

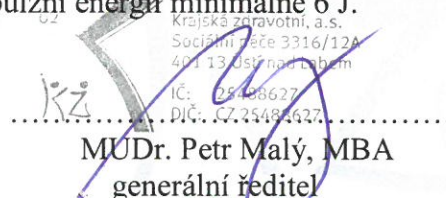
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8018810>

Watt matters: Safety and efficacy of using a 140 W high-powered holmium laser for enucleation of prostate (HoLEP).

Studie 540 pacientů operovaných s výkonem 140 W, nastavení 4 J, 35 KHz dokládající účinnější enukleační efekt oproti nižšímu výkonu při zachování stejné bezpečnosti.

Zadavatel **neakceptuje** přístroj o maximálním výkonu 120 W a pulzní energii 6 J. Zadavatel trvá na požadovaném parametru laser o výkonu minimálně 150 W a pulzní energii minimálně 6 J.

V Ústí nad Labem dne: 31-03-2022


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel