



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Mobilní skiagrafické RTG přístroje včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. a Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2850/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V ZD je uvedeno:

- *Vyvážené rameno s rtg zářičem*
- *Maximální výška ohniska nad zemí minimálně 200*
- *Možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu minimálně ± 90*

DOTAZ 1:

Neuvažuje zadavatel o upřesnění těchto parametrů z důvodu zajištění většího rozsahu manipulace na: RTG zářič na vyváženém výsuvném rameni v rozsahu 753-1318 mm na rotačním sloupu s rotací ± 270 a nastavitelnou výškou ohniska 680-2025mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel se rozhodl z důvodu zajištění většího rozsahu manipulace pro změnu parametrů na: RTG zářič na vyváženém výsuvném rameni v rozsahu 753-1318 mm na rotačním sloupu s rotací ± 270 a nastavitelnou výškou ohniska 680-2025 mm.

Dotaz č. 2

V ZD je uvedeno:

- *Váha přístroje maximálně 500 kg*

DOTAZ 2:

Neuvažuje zadavatel o změně údajů z důvodu lepší manipulace a nosnosti výtahů na max. 450 kg?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel se rozhodl z důvodu lepší manipulace a nosnosti výtahů pro změnu údajů na – *Váha přístroje max. 450 kg*

**Dotaz č. 3**

V ZD je uvedeno:

- kV nastavitelné v rozsahu od minimálně 50 do 125kV

DOTAZ 3:

Neuvažuje zadavatel o rozšíření expozičních parametrů od min. 40 do 130 kV, pro možnost provedení snímků měkkou technikou?

Odpověď na dotaz č. 3

Ano, zadavatel se rozhodl, z důvodu možnosti provedení snímků měkkou technikou rozšířit expoziční parametry na kV nastavitelné v rozsahu od min. 40 do 130 kV.

Dotaz č. 4

V ZD je uvedeno:

- mAs nastavitelné až do minimálně 320 mAs

DOTAZ 4: Neuvažuje zadavatel o úpravě expozičních parametrů v rozmezí min. od 0,32 do 320 mAs pro možnost snímkování objemnějších pacientů, zjm. pro snímky pánve a břicha?

Odpověď na dotaz č. 4

Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu expozičních parametrů na – mAs nastavitelné v rozmezí min. od 0,32 do 320 mAs pro možnost snímkování objemnějších pacientů, zejména pro snímky pánve a břicha.

Dotaz č. 5

V ZD je uvedeno:

- Nejkratší expoziční čas méně než 4 ms.

DOTAZ 5: Neuvažuje zadavatel o změně parametru na 0,001s pro možnost pořizování snímků s krátkou expozicí?

Odpověď na dotaz č. 5

Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu parametru na: Nejkratší expoziční čas méně než 0,001 s pro možnost pořizování snímků s krátkou expozicí.

Dotaz č. 6

V ZD je uvedeno:

- Tepelná kapacita anody minimálně 100 kWh.

DOTAZ 6: Neuvažuje zadavatel o změně parametrů na min. 300 kWh, pro možnost většího tepelného zatížení anody rentgenky při snímkování objemnějších struktur?

**Odpověď na dotaz č. 6**

Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu parametru na: tepelná kapacita anody minimálně 300 kWh, pro možnost většího tepelného zatížení anody rentgenky při snímkování objemnějších struktur.

Dotaz č. 7

V ZD je uvedeno:

- Rentgenka velikost malého ohniska menší nebo rovna 0,8 mm.

DOTAZ 7: Neuvažuje zadavatel o změně parametru na rentgenku se dvěma ohnisky o velikosti 0,7 a 1,3 mm, tak jak je běžným standardem?

Odpověď na dotaz č. 7

Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu parametru na: Rentgenka se dvěma ohnisky o velikosti 0,7 a 1,3 mm, tak jak je běžným standardem.

Dotaz č. 8

V ZD je uvedeno:

- Velikost pro dospělé pacienty, umožňující snímkování i v oblasti celého břicha či hrudníku, nejmenší předpokládaný rozměr čtvercového detektorového pole 41x41 cm, nejmenší předpokládaný rozměr obdélníkového detektorového pole 43x35 cm, velikost pixelu maximálně 200 um

DOTAZ 8: Neuvažuje zadavatel o změně parametru na velikost pixelu maximálně 150um pro zachování kvalitní rozlišovací schopnosti?

Odpověď na dotaz č. 8

Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu parametru na: Velikost pro dospělé pacienty, umožňující snímkování i v oblasti celého břicha či hrudníku, nejmenší předpokládaný rozměr čtvercového detektorového pole 41x41 cm, nejmenší předpokládaný rozměr obdélníkového detektorového pole 43x35 cm, velikost pixelu maximálně 150 um, pro zachování kvalitní rozlišovací schopnosti.

Dotaz č. 9

V ZD je uvedeno:

- Akviziční hloubka minimálně 12 bitů

DOTAZ 9: Neuvažuje zadavatel o změně parametru na Akviziční hloubku min 16 bitů pro zachování kvalitního zobrazení snímků?

Odpověď na dotaz č. 9



Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu parametru na: Akviziční hloubka minimálně 16 bitů, pro zachování kvalitního zobrazení snímků.

Dotaz č. 10

Neuvažuje zadavatel o změně parametru na vodotěsnost detektorů na IPX6 kvůli riziku zatečení tekutin a antibakteriální povrch detektorů vzhledem k předpokládanému použití na lůžkových odděleních?

Odpověď na dotaz č. 10

Ano, zadavatel se rozhodl pro požadavek parametru vodotěsnosti detektorů IPX6 z důvodu rizika tečení tekutin a antibakteriálního povrchu detektorů, vzhledem k předpokládanému použití na lůžkových odděleních.

Dotaz č. 11

V ZD je uvedeno:

- Náhled obrazu při WLAN za maximálně 6 s, plný obraz za maximálně 13 s.

DOTAZ 11: Neuvažuje zadavatel o změně parametrů na „Náhled obrazu při WLAN za maximálně 3 s, plný obraz za maximálně 12 s pro zrychlení workflow na pracovišti“?

Odpověď na dotaz č. 11

Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu parametru na: Náhled obrazu při WLAN za maximálně 3 s, plný obraz za maximálně 12 s, pro zrychlení workflow na pracovišti.

Dotaz č. 12

V ZD je uvedeno:

- Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti minimálně 15“.

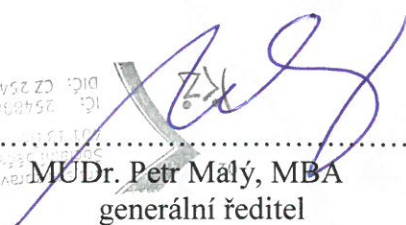
DOTAZ 12: Neuvažuje zadavatel o změně parametru na velikost dotykové obrazovky min. 19“ z důvodu většího náhledového snímku?

Odpověď na dotaz č. 12

Ano, zadavatel se rozhodl pro změnu parametru na: Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti minimálně 19“, z důvodu většího náhledového snímku.

V Ústí nad Labem dne:

19-05-2022


MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel