



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Dezinfektory podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2917/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v Technické specifikaci požaduje

- vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačních ramen a trysek

Rádi bychom nabídli výrobek s vysoce výkonným čerpadlem pro tlakové mytí pomocí rotačních a fixních trysek, zaručují nejvyšší kvalitu mytí vložených nádob. Výrobek splňuje všechny požadované normy pro tento typ výrobku.

Připustí Zadavatel takové technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel akceptuje i navržené technické řešení účastníka.

Dotaz č. 2

Zadavatel v Technické specifikaci požaduje

- dezinfektor je vybaven průtokoměrem pro sledování správného dávkování chemikálie používané během mycího cyklu, v případě problému se na displeji zobrazí chybová hláška. Rádi bychom nabídli výrobek vybavený mikroprocesorem, který automaticky dávkuje a kontroluje dávkování chemikálie, při každém mycím cyklu a navíc s možností úpravy nastavení tohoto dávkování. V případě problému se na displeji zobrazí chybová hláška.

Připustí Zadavatel takové technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel akceptuje i navržené technické řešení účastníka.

Dotaz č. 3

Zadavatel v Technické specifikaci požaduje

- labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění



Rádi bychom nabídli výrobek vybavený dveřní konstrukcí s těsněním pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí splňující všechny požadované normy pro tento typ výrobku. Je to osvědčené, spolehlivé a nejčastěji používané řešení většiny předních renomovaných výrobců dezinfektorů podložních mís.

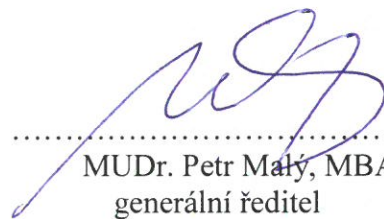
Připustí Zadavatel takové technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel si trvá na svém požadavku „*labyrintové dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění*“, neboť z vlastní zkušenosti ví, že při otevírání dveří dochází k vytržení těsnění podložními mísami a dveře pak nelze uzavřít. Dále dochází k opotřebení těsnění s mycími cykly a používanými chemikáliemi. Při nedostatečné těsnosti dveří dochází k úniku kontaminované vody z oplachu podložních mís skrze obvod dveří do vnějšího prostoru. Zadavatel si je jist, že tento parametr splňuje vícero dodavatelů a nepokládá ho za diskriminační.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **16 -06- 2022**


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel