



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 Sterilizátory**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2974/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

REACT-EU 98 Sterilizátory - prokládací parní sterilizátory včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Dotaz č. 1 ČÁST 1

Dobrý den,

v krycím listu pro všechny 3 části je požadováno kromě uvedení nabídkové ceny za přístroj a pozáruční servis také "Nabídková cena za vázaný spotřební materiál". Jinde v zadávací dokumentaci toto není zmíněno, co tím zadavatel myslí?

Odpověď č. 1 ČÁST 1

Zadavatel použil „univerzální dokument“.

* Nabídková cena za vázaný spotřební materiál

* *Dodavatel vyplní pouze položky, které jsou součástí jeho nabídky.*

Dotaz č. 2 ČÁST 1

Dobrý den,

rádi bychom touto cestou požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 předmětné veřejné zakázky:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „minimální rozměr sterilizační komory 700 x 650 x 1340 mm (v x š x h) – musí být umožněno vsázky 3D optiky v kleci bez obalu o délce 640 mm“

Námi nabízený parní sterilizátor má rozměr sterilizační komory 700 x 672 x 1300 mm.

Připustí zadavatel námi nabízený rozměr sterilizační komory o rozměrech 700 x 672 x 1300 mm (v x š x h), při zachování využitelné kapacity 8 STJ ?

**Odpověď č. 2 ČÁST 1**

Zadavatel připouští i účastníkem nabízený rozměr sterilizační komory 700 x 672 x 1300 mm (v x š x h) při zachování využitelné kapacity 8 STJ.

Dotaz č. 3 ČÁST 1

Dotaz č.2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje maximální vnější rozměr 1918 x 1300 x 1640 mm (v x š x h).

Námi nabízený parní sterilizátor má vnější rozměry 1980 x 1250 x 1650 mm (v x š x h), což nemá vliv na prostor instalace a nastěhování.

Připouští zadavatel námi nabízené vnější rozměry?

Odpověď č. 3 ČÁST 1

Zadavatel nepřipouští účastníkem nabízený vnější rozměr parního sterilizátoru 1980 x 1250 x 1650 mm (v x š x h) a to z důvodu zachování stávajících dispozic se zachováním stávající nerezové stěny a to nejen z ekonomických důvodů, ale také z důvodů provozních, kdy při zachování celého uzpůsobení prostor je možné vyměnit parní sterilizátory během cca 2 dní s minimálním omezením provozu centrální sterilizace, operačních sálů a zbylých oddělení nemocnice. Dále si zadavatel trvá na rozměrech parních sterilizátorů z důvodu rozměrů dveří a otvorů při transportní cestě.

Dotaz č. 4 ČÁST 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje motorické ovládání dveří s vertikálním posunem, pružinovým systémem bez protizávaží a bezpečnostní lištou.

Námi nabízený parní sterilizátor využívá motoricky ovládané dveře s vertikálním posunem s pneumatickým mechanismem bez pružinového systému.

Připouští zadavatel námi nabízený systém otevírání dveří, který je uživatelsky a technicky ekvivalentní?

Odpověď č. 4 ČÁST 1

Zadavatel připouští i účastníkem nabízený systém ovládání dveří vertikálního posunu s pneumatickým mechanismem bez pružinového systému.

Dotaz č. 5 ČÁST 1

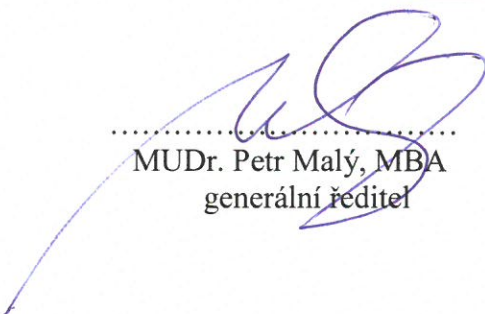
Zadavatel v technické specifikaci požaduje „automatické otevření dveří v případě výpadku elektrické energie“ Parní sterilizátor musí být vyroben dle ČSN EN 285 a zároveň v souladu s ČSN EN 13445 pro tlaková zařízení. Uvedený požadavek v tech.specifikaci je mj. v rozporu s odstavcem 4.3.1.4 (EN 285), kde je požadováno „ Nesmí být možné otevřít dveře během sterilizačního cyklu“. Tudíž je tento parametr nesplnitelný přístroji s platným CE prohlášením o shodě a proto by měl být tento technický parametr z požadavků odstraněn.

Odpověď č. 5 ČÁST 1

Zadavatel akceptuje účastníkův požadavek odstranění z technické specifikace parametr "automatické otevření dveří v případě výpadku elektrické energie".



V Ústí nad Labem dne: 12 -07- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

