



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Skiagrafický RTG přístroj včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2851/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1

Zadavatel v rámci své odpovědi na dotazy nově požaduje rychlost stropního závěsu s rentgenkou ve vertikálním směru min 0,3 m/s a rychlost v horizontálním směru podélně a příčně min. 0,5 m/s. Je zřejmé, že důvodem tohoto požadavku je urychlení vyšetření pacienta. Splněním tohoto požadavku může skutečně dojít k urychlení vyšetření, ale max. o několik málo vteřin. Avšak i tato úspora času je pouze relativní, protože obsluha musí vizuálně pohyb rentgenky a stropního závěsu dozorovat a v případě nebezpečí kolize pohyb přerušit. Většina výrobců preferuje nižší rychlost a to z důvodu max. bezpečnosti pacienta. (Zadavatel s tím má bohužel tragickou zkušenost.) Skutečně moderní přístroje jsou ale vybaveny sofistikovaným autonomním antikolizním systémem (podobně jako u moderních aut), při němž obsluha nemusí dozorovat pohyb stropního závěsu a může se plně věnovat pacientovi – jeho přesunu vyšetřovnou a polohováním. Tímto dochází také k úspoře času a obdobnému zkrácení vyšetření pacienta jako u velmi rychlého pojezdu.


Oproti tomu lze významně a přitom bezpečně zrychlit vyšetření pacienta až o desítky vteřin, jestliže je RTG systém vybaven moderním počítačovým systémem s vysokým výkonem. Na rozdíl od požadavku Zadavatele, který v zadávací dokumentaci akceptuje čas pro zobrazení snímku v plném rozlišení pro akvizici z libovolného detektoru 14 s, jsou moderní systémy schopny zobrazit rtg. snímek v plném rozlišení již do 5ti sekund! A o to dříve snímek zkontrolovat, anotovat a odeslat radiologovi k popisu. Jestliže průměrné vyšetření pacienta znamená provedení 2-3 snímků (často i více), tak lze dosáhnout skutečného zkrácení vyšetření pacienta o několik desítek vteřin! Při desítkách pacientů denně.

Bude Zadavatel akceptovat obdobné řešení na RTG systém nejvyšší třídy, renomovaného světového výrobce, jehož stropní závěs se standardně pohybuje rychlostí ve vertikálním směru 0,1 m/s (a v dalších směrech proměnnou – vyšší rychlostí), přičemž je vybaven plně autonomním antikolizním systémem a výkonnou akviziční stanicí s časem pro zobrazení snímku v plném rozlišení z libovolného detektoru do 5 s, která významně urychluje workflow na RDG pracovišti?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: 15 -07- 2022

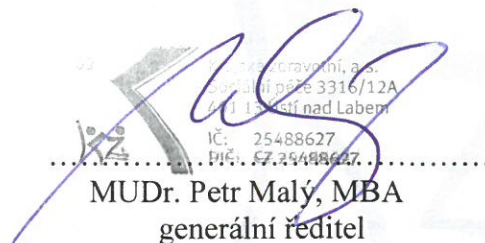

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel