



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2904/2022**


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

část 2 REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický přístroj s C-ramenem s FD pro Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.

Dotaz č. 1 ČÁST 2

- 1) Zadavatel v části 2 „REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický přístroj s C-ramenem s FD pro Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.“ vysvětlení zadávací dokumentace přijmul řešení systému s plochým detektorem z materiálu As-Csi, odpovídající první generaci plochých detektorů z roku 2006. Nabízíme řešení s 2,5kW generátorem, DQE 65 %, dvěma ohnisky, softwarově děleným dotykovým 27" FULL-HD monitorem umístěným na ramenu stroje, digitální paměť 100 000 obrazů, rotací +/- 205°, orbitální rotací 120°, SID 100 cm, volným prostorem mezi detektorem a rentgenkou 78 cm, novou technologií automatické volby nastavení stroje podle snímané oblasti a obrazovým zesilovačem 9", který je svou plochou větší než 20cm detektor a svými vlastnostmi – dávka a obrazová kvalita – je při primárním účelu stroje této kategorie 2,5kW generátoru – radiografické snímkování a fluoroskopie s proudem odpovídajícím 2,5kW generátoru – šetrnější s ohledem na dlouhodobou radiační zátěž jak pro lékaře tak pacienta a to současně při dosažení lepší obrazové kvality? As-Csi (a-Si) detektor dosahuje lepších výsledků – nižší dávka a vyšší obrazová kvalita - v porovnání s obrazovým zesilovačem až u vysoko výkonnostních systémů, např. u angio přístrojů s 100kW generátory. Bude zadavatel akceptovat výše popsané, technicky lepší řešení, splňující všechna důležitá uživatelská a klinická kritéria?

Delivers high image quality at lower doses

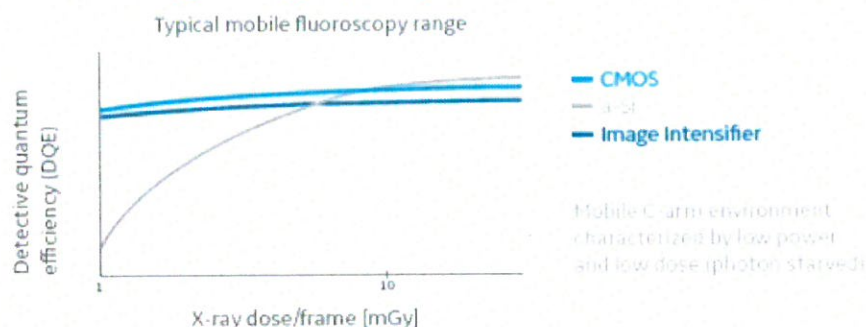

Odpověď č. 1 ČÁST 2

Zadavatel v souvislosti s předchozími odpověďmi, ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 v rámci veřejné zakázky připustil ponížení již prakticky všech parametrů dotazovaných v předmětné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Jediný parametr, který nebyl připuštěn již dříve je síla generátoru. Tato však pouze sama o sobě nedává jasný přehled o výkonnosti přístroje – lze akceptovat.

Zadavatel trvá na podmínce plochého detektoru.

V Ústí nad Labem dne:

16 -08- 2022

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
orig. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel