



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3000/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje monitorování pomocí dotykové ovládací obrazovky + otočným ovladačem.

Přístroje ZOLL nedisponují dotykovou obrazovkou, ale postranním panelem s ovládacími prvky k jednotlivým funkcím přístroje a jedním otočným ovladačem. Toto řešení zajišťuje přehlednost a eliminuje náhodnou chybovost při ovládání.

Dotaz: bude toto zadavatel akceptovat?

Odpověď č. 1

Zadavatel na uvedeném požadavku trvá, neboť minimalizace počtu fyzických ovládacích prvků resp. přesun jejich části na dotykovou ovládací obrazovku mj. usnadňuje provádění povrchové dezinfekce přístroje, která je jedním z předpokladů omezení šíření nozokomiálních infekcí. Ty představují potenciální významné ohrožení pacienta ve smyslu morbidit, mortality, doby hospitalizace i doby strávené na umělé plicní ventilaci. Uvedené komplikace též zásadním způsobem zvyšují náklady na poskytovanou zdravotní péči.

Dotaz č. 2

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje vestavěnou turbínu jako zdroj hnacího tlaku.

Přístroje ZOLL používají jako hnací sílu kompresor. Tato vlastnost umožňuje plnou nezávislost na připojení stlačeného kyslíku a v případě nutnosti použití stlačeného kyslíku prodlužuje dobu spotřeby

Dotaz: bude zadavatel akceptovat přístroj s integrovaným kompresorem?

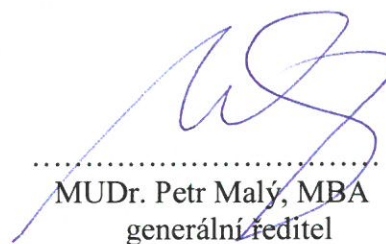


Odpověď č. 2

Zadavatel na uvedeném požadavku trvá, neboť má za vědecky prokázané, že vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku poskytuje citlivější spouštění dechového cyklu (trigger), stejně jako lepší náběh tlakově podporovaných dechů. Tyto parametry jsou mj. klíčové pro toleranci neinvazivní plicní ventilace pacientem, či efektivní využití tlakově řízených režimů.

V Ústí nad Labem dne:

10.9.2012


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel