



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a REACT-EU 100 - Laboratorní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. – MNÚL, o.z., Nemocnici Most, o.z., a MNÚL, o.z., pracoviště Rumburk II. - část 1: Laboratorní inkubátor a laboratorní termostat**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3212/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

U položky Laboratorní inkubátor (nem. Most) teplotní rozsah 20 - 45 °C. Bude zadavatel akceptovat nastavení teploty v rozmezí +5 °C od okolní teploty do +80 °C?

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje i nastavení teploty v rozmezí +5 °C od okolní teploty do +80 °C s přesností nastavení 0,1 °C.

Dotaz č. 2:

U položky Laboratorní inkubátor pro ARO (Rumburk) teplotní rozsah 20 - 45 °C. Bude zadavatel akceptovat nastavení teploty v rozmezí +5 °C od okolní teploty do +80 °C?

Odpověď č. 2:

V dotazu účastníka je nesprávně uveden teplotní rozsah 20 – **45 °C**. U položky Laboratorní inkubátor pro ARO (Rumburk) zadavatel požaduje Teplotní rozsah minimálně +20 °C až **+70 °C**. Zadavatel má za to, že se jedná pouze o administrativní pochybení. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným akceptuje i nastavení teploty v rozmezí +5 °C od okolní teploty do +80 °C.

Dotaz č. 3:

U položky Laboratorní termostat pro ARO (Rumburk) alarm otevřených dveří. Bude zadavatel akceptovat přístroj bez tohoto typu alarmu?

Odpověď č. 3:

Zadavatel neakceptuje přístroj bez tohoto typu alarmu. Zadavatel trvá na znění v technické specifikaci.

**Dotaz č. 4:**

Dále u všech položek požadujete osvědčení zdravotnického prostředku. Je toto podmínka nebo bude zadavatel akceptovat i přístroje laboratorní bez osvědčení ZP?

Odpověď č. 4:

Zadavatel akceptuje laboratorní přístroje i bez Osvědčení zdravotnického prostředku.

Dotaz č. 5:

Dále u všech položek požadujete osvědčení zdravotnického prostředku. Je toto podmínka nebo bude zadavatel akceptovat i přístroje laboratorní bez osvědčení ZP?

Odpověď č. 5:

Zadavatel akceptuje laboratorní přístroje i bez Osvědčení zdravotnického prostředku.

Dotaz č. 6:

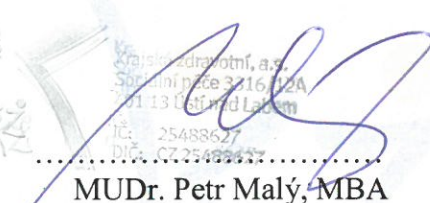
Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce v následujícím bodě: Ve veřejné zakázce Krajské zdravotní, a.s., část 1 – Laboratorní termostat a laboratorní inkubátory je požadavek na Osvědčení o zdravotnickém prostředku. Laboratorní inkubátor/termostat nemusí ze své podstaty být zdravotnickým prostředkem. Splnění požadovaných vlastností inkubátoru je zajištěno provedením instalační kvalifikace (validace). Dotaz: Je možné od požadavku na Osvědčení zdravotnického prostředku upustit?

Odpověď č. 6:

Zadavatel akceptuje laboratorní termostat a laboratorní inkubátor i bez Osvědčení zdravotnického prostředku.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **12 0 -12- 2022**


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti