



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2997/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 zd Technická specifikace v popisu multiparametrického modulu

Modul musí umožnit monitoraci:

- „EKG z 5 a 12 svodů s interpretací, detekce arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, respirační frekvence“

Počet kanálů, ze kterých se arytmie detekují a analyzují, zásadním způsobem ovlivňuje pravděpodobnost správné detekce a analýzy EKG křivky a též počet falešných alarmových hlášení. Standardem u předních výrobců je současná analýza minimálně ze 4 kanálů.

Zadavatel nijak nespecifikoval, z kolika kanálů se má detekce arytmií provádět. Uchazeč se domnívá, že zadavatel vyžaduje detekci arytmií minimálně ze 4 kanálů současně.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Předpoklad účastníka není správný, neboť zadavatel nespecifikuje počet kanálů pro detekci arytmie.

Dotaz č. 2:**Dotaz č. 2**

Zadavatel v bodě 4. zadávací dokumentaci **Způsob a kritéria hodnocení nabídek** popisuje kritérium s označením ET

ET - Funkční vlastnost – Možnost rozšíření o další monitorované parametry pouze softwarovým upgradem

Dále v Příloze č. 2 zd Technická specifikace zadavatel popisuje v bodech 1) až 5) jednotlivé požadované typy produktů, jejich technické a uživatelské parametry a vlastnosti.

Zadavatel neuvedl, na který poptávaný typ produktu se toto kritérium ET vztahuje, co je předmětem softwarového rozšíření.

Uchazeč se domnívá, že zadavatel měl na mysli funkční vlastnost multiparametrického modulu popsáno v bodě 1) Přílohy č. 2 zd Technická specifikace.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že toto hodnotící kritérium se může vztahovat i na jiné požadované typy produktů (např. vlastní monitory vitálních funkcí, centrální monitory), uvedené v technické specifikaci, pokud rozšíření monitorovaných parametrů upgradem SW toto vyžaduje. Zadavatel pro vyloučení pochybností, upřesňuje, že uvedené kritérium se nevztahuje na rozšíření funkcí monitorů realizované prostřednictvím zásuvných modulů umístěných do modulového boxu.

Dotaz č. 3:**Dotaz č. 3**

Zadavatel v bodě 4. zadávací dokumentaci **Způsob a kritéria hodnocení nabídek** popisuje kritérium s označením ET

ET - Funkční vlastnost – Možnost rozšíření o další monitorované parametry pouze softwarovým upgradem

Zadavatel neuvedl, co míní monitorovaným parametrem.

Uchazeč se domnívá, že zadavatel má na mysli situaci, kdy rozšíření o sledování dalších, momentálně nepožadovaných životních funkcí (jako je sledování druhého SpO2 atp.) bude realizováno pouze změnou SW multiparametrického modulu, popsáno v bodě 1) v příloze č. 2 zd Technická specifikace, bez nutnosti měnit jeho hardware.

Je tato naše domněnka správná?

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Ano, předpoklad účastníka je správný.

Dotaz č. 4:**Dotaz č. 4**

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 zd Technická specifikace v bodě 1)

Multiparametrický modul:

Modul fungující zároveň jako transportní monitor

Uchazeč vyvozuje, že zadavatel požaduje modul dostatečně odolný pro transport v různém prostředí, tedy přístroj s odpovídajícím krytím proti vlhkosti a mechanickému poškození. Zadavatel však tuto odolnost dále nespecifikuje.

Uchazeč předpokládá, že zadavatel požaduje krytí multiparametrického modulu minimálně IP44 a to ve všech směrech.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 4:

Předpoklad účastníka není správný, neboť zadavatel nespecifikuje krytí.

Dotaz č. 5:**Dotaz č. 5**

Zadavatel požaduje v příloze č.2 zd Technická specifikace v bodě 4) Rozšiřující moduly bod a)

Transpulmonární termodiluce (PiCCO)

Uchazeč předpokládá, že zadavatel požaduje monitorovat minimálně následující parametry?

- Continuous cardiac output (CCO)
- Transpulmonary cardiac output (CO)
- Stroke volume (SV)
- Cardiac index (CI)
- Continuous cardiac output index (CCI)
- Stroke volume index (SVI)
- Global end-diastolic volume (GEDV)
- Global end-diastolic volume index (GEDI)
- Intrathoracic blood volume (ITBV)
- Intrathoracic blood volume index (ITBI)
- Stroke volume variation (SVV)
- Pulse pressure variation (PPV)
- Global ejection fraction (GEF)
- Cardiac function index (CFI)
- Cardiac function index (CFI)

- Index of left ventricular contractility (dPmx)
- Systemic vascular resistance (SVR)
- Systemic vascular resistance index (SVRI)
- Extravascular lung water (EVLW)
- Extravascular lung water index (ELWI)
- Cardiac power output (CPO)
- Cardiac power index (CPI)
- Pulmonary vascular permeability index (PVPI)
- Invasive blood pressure (IBP)

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď na dotaz č. 5:

Předpoklad účastníka není správný, neboť zadavatel nespecifikuje, jaké parametry požaduje monitorovat.

Dotaz č. 6:

Dotaz č. 6

Zadavatel požaduje v příloze č.2 zd Technická specifikace v bodě 4) Rozšiřující moduly, bod 9)

Monitorace hloubky nervosvalové blokády (NMT)

Pro sledování NMT se běžně používají dvě metody – snímání EMG nebo snímání reakcí mechanosensorem. Každá tato metoda má specifické klinické výhody.

Pořizované monitory pokrývají dle ZD široké spektrum klinického nasazení. Ze zadávací dokumentace však není zjevné, jakou metodu měření NMT zadavatel požaduje,

Uchazeč předpokládá, že zadavatel požaduje možnost monitorovat tento parametr oběma běžnými metodami – pomocí EMG i mechanosenzorem.

Je tento předpoklad správný?

Odpověď na dotaz č. 6:

Předpoklad účastníka není správný, neboť zadavatel nespecifikuje, jakou metodu měření požaduje.

**Dotaz č. 7:**

V rámci veřejné zakázky „REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s.“ chce zadavatel pořídit monitorovací systémy, kdy vybraný dodavatel bude dodávat předmět plnění na základě rámcové dohody na 36 měsíců a dílčích objednávek do jednotlivých zdravotnických zařízení. Dle pravidel výzvy 98 a 99 musí být realizace projektů ukončena nejpozději do 31. 12. 2023. Z výše uvedeného se uchazeč domnívá, že ne všechny poptávané přístroje jsou pořizované z dotačních prostředků výzvy 98 a 99, jelikož jinak by museli být dodány všechny přístroje do konce příštího roku a pak by rámcová dohoda dodávek v průběhu 36 měsíců postrádala význam. Ve vztahu k výše uvedenému požadujeme informace o alokacích prostředků, dle jednotlivých projektů výzev 98 a 99 pro

- Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016365
- Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263
- Přístrojové vybavení nemocnice Most, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322
- Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016320
- Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323
- Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337
- Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376,
- Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660,

a žádáme o podrobnější informace kolik přístrojové techniky (monitorů vitálních funkcí, multiparametrických modulů, centrálních monitorů a rozšiřujících modulů) v souladu podanými projekty jsou pořizovány z dotačních prostředků, a to na úrovni – jednotlivých projektů – nemocnic, včetně jednotlivých oddělení (ARO, UP a jiné), kde mají přístroje být instalovány. Uvedené informace jsou nezbytné pro přípravu validní nabídky a také z pohledu veřejné kontroly účelnosti nakládání přidělenými finančními prostředky.

Odpověď na dotaz č. 7:

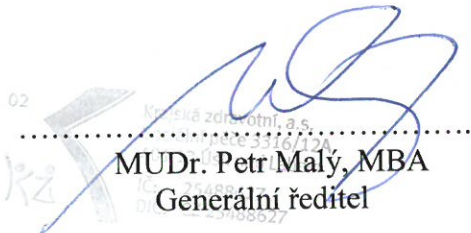
Zadavatel se domnívá, že informace ohledně alokací prostředků není relevantní s ohledem na smluvní závazek s délkou 36 měsíců a předpokládaným odběrem počtu kusů vycházejícího z položkového rozpočtu.

Zadavatel nepovažuje poskytnutí podrobnější informace, kde jaké přístroje mají být instalovány za relevantní k tvorbě nabídky.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

V Ústí nad Labem dne:

20-01-2023

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel

Přílohy:

Příloha č. 6 – Rozklad nabídkové ceny_platný od 20.1.2023