

Příloha č. 2 ZD (pro část VZ č. 26)

KUPNÍ SMLOUVA č. 22-5-11

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Název: Hoyer Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 130 24

IČ: 60491582

DIČ: CZ60491582

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 27696

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 5275142/0800

jednající / zastoupená: ing. Soňa Hamšíková, jednatelka

Kontaktní osoba : ing. Josef Zákravský

dále jen „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Vaclav Štyvar tel: 477 117 901, e-mail: vaclav.styvar@kzcr.eu

Kontakt ve věcech technických: Ing. Radek Brož, tel: 47 803 3431, e-mail: radek.broz@kzcr.eu

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku/část veřejné zakázky vyhlášenou dne **12.2.2015** na dodávku vybavení s názvem „**Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (lůžko, monitor do centrály, ventilátor)**“ zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.**“, který by měl být podpořen z Integrovaného operačního programu, 18. Výzvy, oblasti podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit nabytí vlastnické právo k němu a to k **6 ks resuscitačních lůžek s antidekubitní matrací, 2 ks monitorů vitálních funkcí s příslušenstvím kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí a 6 ks ventilátorů s příslušenstvím pro dospělé pacienty** (dále jen přístroj nebo zboží) pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. - oddělení intenzivní medicíny a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
Dále je předmětem smlouvy montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, vypracování projektové dokumentace, (pokud je kupujícím vyžadována), instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností (OOKC),
, dále záruční servis dle níže uvedených podmínek.
3. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží) a příloze č. 2 (Rozpis cenové nabídky) této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
5. Předmětem smlouvy je dále předání zboží ve znění dle článku III. odst. 2 této kupní smlouvy, likvidace obalového materiálu, zajištění stavební připravenosti (pokud je kupujícím vyžadována), zajištění ekologické likvidace stávajícího vybavení (pokud je kupujícím vyžadována) včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy a poskytnutí záručního servisu. Pro předání dodávaného plnění bude využita příloha č. 3 (předávací protokol)

II.

Kupní cena zboží

1. Celková kupní cena zboží je **3 623 600,- Kč bez DPH**
tj. v DPH sazbě 15 % 840 000,-Kč bez DPH a v DPH sazbě 21 % 2 783 600,- Kč bez DPH
cena celkem vč DPH 21 % je **3 368 156,- Kč včetně 21 % DPH**
cena celkem vč. DPH 15 % je **1 016 400,- Kč vč 15 % DPH .**

Součet cen vč DPH je 4 384 556,- Kč

2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
3. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odvolávku na smlouvu, název projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“, registrační číslo projektu, soupis příloh (viz. přílohy č.1 - 3 k této smlouvě, dodací listy a další relevantní doklady související se zbožím typu revize apod.)

4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
5. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
6. Proávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu a provedení veškerých úkonů uvedených v článku III. odst. 2. této kupní smlouvy.
7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
9. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího dodáním/odevzdáním zboží.

III.

Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 6 týdnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami včetně instruktáže obsluhy. O termínu dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je ing. Josef Zákravský – funkce obchodní zástupce, tel.: 602475470, email: Josef.zakravsky@hoyer.cz.

Pověřeným zástupcem kupujícího je pracovník OOKC:

1) Ing. Martin Peterka, tel.: +420 733 594 620, email: martin.peterka@kzcr.eu

2) Bc. Pavel Keller, tel.: +420 731 132 755, email: pavel.keller@kzcr.eu

2. Za předání zboží se považuje:
 - a. jeho dodání na adresu Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem - oddělení, intenzivní medicíny
 - b. montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy,
 - c. instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2001 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů - včetně vystavení protokolu o proškolení
 - d. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravot. personálu v používání zboží,

dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

- e. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
3. Zvláštní požadavky:
- a. Kupující požaduje instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrovizí, atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.
 - b. Kupující požaduje instruktáž zaměstnanců kupujícího pro plné uživatelské užívání zboží a pro provádění instruktáží dalších pracovníků kupujícího.
 - c. Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 Sb. v posledním znění.
4. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
5. Protokol o předání a převzetí zboží a o zprovoznění přístroje musí být podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.
6. Nepředá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

IV.

Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství a spotřební materiál, které jsou nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží a na spotřební materiál.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: Hoyer Praha s.r.o., servisní středisko Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, tel.: +420225001550 vedoucí servisního střediska ing. Jandus, fax: +420225001522, e-mail: servis@hoyer.cz
7. Lhůta pro odstranění závad nebude delší než 3 pracovní dny. Lhůta pro odstranění závad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) závad prodávajícímu.
8. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě kupujícího do 3 pracovních dnů od nahlášení závady kupujícím, poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do 24 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
9. V případě, že zboží nebylo opraveno na místě ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 a náhradní zboží nebylo poskytnuto do 24 hodin, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý kalendářní den až do doby předání náhradního zboží nebo opravy zboží.
10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit či nebude možné dodržet lhůtu pro poskytnutí náhradního zboží, může být kupujícím písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje kupující.
11. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.
12. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a ověření (je-li relevantní),
 - periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

13. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny výše uvedených kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. a dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.
14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik OOKC, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OOKC.
15. Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu.

VI.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy i v případě, že nebude moci čerpat dotaci přidělenou na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“
3. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VII.

Zvláštní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.
2. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinností kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
3. Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
4. Prodávající se zavazuje nepřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplyvá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.
5. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 (deset) let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 (tři) let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, přičemž se tato lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba týkajícího se projektu.

6. Prodávající se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem Integrovaného operačního programu a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky.
7. Prodávající je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
8. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu a poskytovateli dotace veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem uzavřené smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem uzavřené smlouvy, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem uzavřené smlouvy, účastnit se na výzvu zadavatele a poskytovatele dotace případných jednání a řízení.

VIII.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.
2. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro provozovatele poštovních služeb doporučena písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti provozovatelem poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

4. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
8. Příloha č. 1 až č. 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace. Aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží
- 2) Rozpis cenové nabídky
- 3) Předávací protokol zdravotnického prostředku

V Praze

V **Ústí nad Labem**

dne **14-09-2015**

dne **18-09-2015**


Hoyer Praha s.r.o.

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmova 225/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (9)
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/5A, 130 00 Praha 3

Ing. Soňa Hamšíková

Jednatelka společnosti

Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12.
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala

ředitel společnosti

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRODÁVAJÍCÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

Uchazeč Hoyer Praha s.r.o. se sídlem Jilmová 2685/10. 130 24 Praha 3, IČ: 60491582 zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27696, jednající v souladu se způsobem jednání a zastupování zapsaným v obchodním rejstříku jednatelem paní Janou Doubravovou a paní ing. Soňou Hamšíkovou, tímto čestně prohlašuje, že nabízený typ JIP lůžka s antidekubitní matrací výrobce Linet a patientských monitorů výrobce GE Healthcare a ventilátorů výrobce Dräger splňuje požadované parametry pro část 26 zadávací dokumentace vz „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologických center Krajské zdravotní a.s.“, uvedené v příloze č. 3 zd

Lůžko:

Nabízený typ: Eleganza 3XC výrobce Linet



Eleganza 3XC

- lůžko pro intenzivní péči se čtyřdílnou ložnou plochou přibližně 200 x 85 cm, velmi stabilní nejlépe sloupový a jednoduše čistitelný podvozek **Ano, nabízený typ splňuje, rozměr lůžka je: 208 x 86 cm**
- postranice dělené s integrovanými ovladači (minimálně ovládání zádové a nožní části dále pak výšky) na vnitřní i venkovní straně postranic v hlavové části, postranice se zajištěním bezpečnosti proti první chybě **Ano, nabízený typ splňuje**
- vysoké postranice minim. 40 cm pro bezpečnou ochranu pacienta (s minimální mezerou do 12cm) **Ano, nabízený typ splňuje, Postranice má výšku 45 cm a mezeru 12 cm**

- předprogramované důležité polohy (resuscitační poloha, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, opačná Trendelenburgova poloha) nejlépe jednotlivá ovládání **Ano, nabízený typ splňuje**
- nožní ovladače lůžka (ovládání výšky event. +1 předprogramovaná libovolná poloha)
Ano, nabízený typ splňuje
 - zdvih lůžka elektromotorem nejnižší poloha musí být pod 55 cm (nižší je lepší) a nejvyšší poloha musí být vyšší než 70 cm (vyšší je lepší) **Ano, nabízený typ splňuje, nastavení výšky v rozsahu od 41 cm do 79,0 cm**
- polohování ložné plochy pomocí elektromotoru **Ano, nabízený typ splňuje**
- zálohová baterie nejlépe s vlastní autodiagnostikou kapacity životnosti **Ano, nabízený typ splňuje**
- možnost náklonu do Trendelenburgovy minimálně 12° a Antitrendelenburgovy minimálně 12° polohy pomocí elektromotoru **Ano, nabízený typ splňuje, Náklon TR/ATR ± 12°**
- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) **Ano, nabízený typ splňuje**
- odnímatelná čela **Ano, nabízený typ splňuje**
- hlavové čelo pevné tzn., při náklonu lůžka do TR polohy zůstává hlavové čelo ve stabilní poloze bez náklonu **Ano, nabízený typ splňuje**
- možnost současného polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy **Ano, nabízený typ splňuje**
- integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm **Ano, nabízený typ splňuje, max. 17 cm**
- kolečka o průměru minimálně 150mm s centrálním ovládáním brzd **Ano, nabízený typ splňuje, Průměr koleček je 150 mm**
- držáky na drobné příslušenství **Ano, nabízený typ splňuje**
- držáky na infuzní stojan, hrazdu **Ano, nabízený typ splňuje**
- ochranné prvky v rozích lůžka **Ano, nabízený typ splňuje**
- ložná plocha nejlépe z odnímatelných dílů **Ano, nabízený typ splňuje**
- konstrukce lůžka umožňující volný pohyb Rtg přístroje po celé délce lůžka **Ano, nabízený typ splňuje**
- nosnost lůžka nejméně 230 kg **Ano, nabízený typ splňuje, maximální nosnost lůžka je 250 kg**
- integrovaný nezávislý váhící systém - vážení pacienta **Ano, nabízený typ splňuje**
- signalizace opuštění lůžka pacientem **Ano, nabízený typ splňuje**
- polička (stolek) na dokumentaci nebo nástroje a obvazový materiál umístěný u nohou pacienta **Ano, nabízený typ splňuje**

Pasivní antidekubitní matrace:

Nabízený typ: ERGOMATT

- matrace pro střední až těžší stupně dekubitu (II – IV) **Ano, nabízený typ splňuje**
- rozměry matrace dle lůžka **Ano, nabízený typ splňuje**
- potah vyrobený z materiálu paropropustného, nepropustného pro vodu a tekutiny, oboustranně elastický, pratelný **Ano, nabízený typ splňuje**
- potah musí být opatřen zipem ze všech čtyř stran matrace - a tento musí být krytý proti vniknutí tekutin do jádra matrace **Ano, nabízený typ splňuje**

ERGOMATT



- Prevence vzniku dekubitů a komfort pro pacienta jsou hlavní vlastnosti matrace Ergomatt
- Matrace je speciálně navržena pro použití v kombinaci se systémem Ergoframe®. Výsledkem společného působení tohoto unikátního systému a matrace Ergomatt je potlačení negativního účinku polohování ložné plochy na pacienta a dosažení jeho maximálního pohodlí. Měření tlakových map ukázalo, že kombinace Ergoframe® – Ergomatt snižuje tlak v bederní oblasti o 25 % v porovnání se standardním lůžkem.
- Elastický potah a vrstva termoelastické pěry se adekvátně přizpůsobí poloze pacienta.
- Potah je voděodolný, paropropustný, jeho švy jsou vysokofrekvenčně svařovány tak, aby efektivně zabránily proniknutí jakékoliv tekutiny.
- Riziko II, Norton 20-16, výška matrace 14 cm, hmotnost matrace 12,5 kg, maximální nosnost matrace 120 kg.

Kompletní výbava pro intenzivní péči



[1] ČELO LŮŽKA S KONSTANTNÍ VÝŠKOU
Odnímatelné čelo s pevně danou výškou umožňuje rychlý a snadný přístup k hlavě, krku a hrudníku pacienta.

[2] POSTRANICE
Dělené postranice lůžka poskytují pacientovi ochranu před pádem a zároveň slouží jako opora při jeho mobilizaci.

[3] INTEGROVANÁ VÁHA
Ovládací panel integrované váhy umístěný pod nožním čelem je chráněn proti narázu.

[4] VSTÁVACÍ MADLA MOBI-LIFT®
Se vstávacími madly Mobi-Lift® je mobilizace pacienta účinnější a bezpečnější. Madla lze zasunout pod lůžko.

[5] LŮŽNÁ PLOCHA ERGOFRAME®
Lůžná plocha ErgoFrame® je základem ergonomicky řešeného polohování.

[6] OVLÁDACÍ PANEL SUPERVISOR
Pomocí ovládacího panelu Supervisor lze nastavit všechny polohy lůžka. Panel obsahuje paměť pro většinu často používaných poloh, tlačítko GO, tlačítko STOP, indikátor stavu a životnosti baterií.

[7] SLOUPY
Elektrické zdvižné jednotky umístěné ve dvou sloupech umožňují výškové nastavení ložné plochy a dalších poloh. Sloupová konstrukce zajišťuje dokonalou stabilitu lůžka.

[8] OVLADAČE V POSTRANICÍCH
Ovladače v postranicích zvyšují soběstačnost pacienta.

[9] PATE KOLEČKO
Páte kolečko usnadňuje manipulaci s lůžkem v rozích, zejména v místech s nedostatkem volného prostoru.

[10] PRODLOUŽENÍ LŮŽKA
Integrované prodloužení lůžka umožňuje přizpůsobit délku ložné plochy individuální výšce pacienta.

[11] POLÍČKA NA LŮŽKOVINY
Políčka na lůžkoviny slouží také na odložení panelu Supervisor.


[12] ZAMKY ČEL
Zámky čel lůžka zabráňují neumyšlenému vytažení čel během jízdy nebo při jiné manipulaci s lůžkem.

[13] NOŽNÍ OVLADAČ
Ovladače jsou chráněny proti nechtěnému spuštění mechanickou zábranou.

[14] DRŽÁK RTG KAZETY
Speciální výsuvná konstrukce držáku umožňuje pohodlné vložení kazety pod ložnou plochu z boční strany lůžka.

Parametry lůžka Eleganza 3XC

Rozměry



Technické parametry – rozměry

Bočnice v horní poloze	223×104,5 cm
Bočnice v dolní poloze	223×102,5 cm
Prodloužení lůžka	+7/+17 cm
Rozměry matrace	208×96×14 cm
Max. výška matrace	23 cm
Nastavení výšky	41,0 – 79,0 cm
Náklon TR/ATR	±13°
Výška dvoudílných sklopných postranic nad ložnou plochou (bez matrace)	45 cm
Hmotnost (základní zařízení)	138 kg
Bezpečná pracovní zátěž	250 kg
Držák RTG kazety pro kazetu	35×43 cm

Elektrické parametry

Napájení	230V, ±10%, 50–60 Hz
Maximální příkon	max. 1,6 A, 370 VA
Ochrana proti vniknutí vody a prachu	IPX4
Klasifikace zařízení dle IEC 60601-1	Class I
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem	Applied part type B
Režim provozu elektromotorů (zátěžový faktor)	10%, max. 2 min/18 min

Certifikáty

Společnost LINET je certifikována podle evropských norem a systémů kvality: EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.

Produkty jsou vyrobeny podle evropských norem pro zdravotnickou techniku a nemocniční lůžka: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-38, EN ISO 14971, 93/42/EEC, 90/384/EEC a EN 60601-2-52.

matrace antidekubitní ERGOMATT, pasivní

matrace pasivní

model: Ergomatt

specifikace:

- matrace s vaničkovým dnem
- kombinace nosné a visko pěny
- DUF 5020, Dumergo 85
- zkosené rohy
- potah svařovaný BI-Elastic
- potisk Ěrgomatt

rozměry:

- 208x96x14 cm

	MAXIMÁLNÍ NOSNOST	HMOTNOST	STANDARDNÍ ROZMĚRY (CM)	DRUH PĚNY	POTAH MATRACE
Ergomatt	120 kg	12,5 kg	200×90×14; 208×96×14	PU, visco	voděodolný, 270° zip


Ventilátory (6ks):

Nabízený typ: Savina 300 výrobce Dräger

- ventilační parametry: ventilace dospělých pacientů a dětí, široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV ventilační režimy s garantovaným objemem, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory či alternativní systém regulace **Ano, nabízený typ splňuje, navíc objemově řízená ventilace**
- I: E dle měření plicní mechaniky pacienta, apnoe zálohová **Ano, nabízený typ splňuje**
- kompenzace odporu endotracheální rourky **Ano, nabízený typ splňuje, automatická kompenzace**
- monitorování parametrů na kanyle nebo z ventilátoru (možnost volby) **Ano, nabízený typ splňuje, monitorování parametrů z ventilátoru**
- sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách **Ano, nabízený typ splňuje**
- objem: jednotlivý a minutový objem **Ano, nabízený typ splňuje, objem, průtok, tlak – číslem, křivkou i smyčkou**
- tlak: PEEP/CPAP, peak, mean **Ano, nabízený typ splňuje, navíc min, plat**
- čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechové frekvence **Ano, nabízený typ splňuje, T_{insp}, T_{exp}, f, f_{spont}**
- průtok: inspirační a expirační špička **Ano, nabízený typ splňuje graficky i číselně**
- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu **Ano, nabízený typ splňuje**
- monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence, expirační časová konstanta, automatické měření **Ano, nabízený typ splňuje, C_{dyn}, T, T**
- kapnometrie **Ano, nabízený typ splňuje mainstream**
- autopeep **Ano, nabízený typ splňuje, plně automatický**
- akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval, koncentrace O₂, vadná čidla **Ano, nabízený typ splňuje, M_{vmax}/min, f_{max}/min (spojená s apnea), P_{max}, tapnoe, O₂, technické alarmy vč. hlášení vadných čidel**
- přehledná, barevná obrazovka **Ano, nabízený typ splňuje, barevná dotyková 12"**
- jednoduché intuitivní ovládání **Ano, nabízený typ splňuje, systém vyber-nastav-potvrd'**
- 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné, digit. pole, dělené zobrazení **Ano, nabízený typ splňuje, 3 křivky a číselné parametry nebo 2 křivky, 2 smyčky a číselné parametry**
- automatická detekce pacienta ADP **Ano, nabízený typ splňuje**
- připojení na rozvod medicínálních plynů **Ano, nabízený typ splňuje**
- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 30min) **Ano, nabízený typ splňuje, běžně 60 min**
- pojízdný podvozek pro přístroj, odnímatelná část ventilátoru **Ano, nabízený typ splňuje**
- vestavěná nebulizace min.8ml pro podávání léků **Ano, nabízený typ splňuje**
- tepelný zvlhčovač **Ano, je součástí nabídky**
- procedury: podání 100 % O₂, odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, Intrinsic PEEP, pozastavení inspirace a expirace, odvykací režim STB, index mělkého dýchání RSBI, **Ano, nabízený typ**

splňuje, O₂ odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, automatické měření intrastického PEEP, insp a exp HOLD, odvykací režim MMV/PS – autoflow, RSBI

U-1257-2010

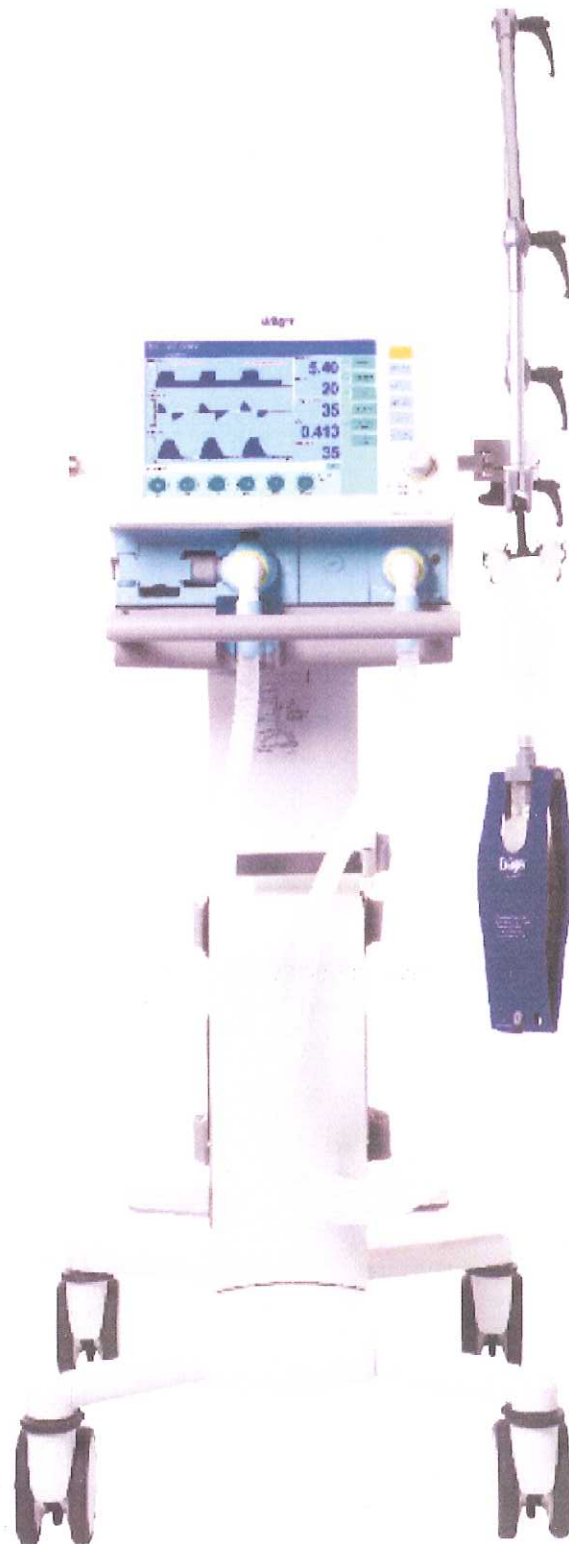

Dräger Savina® 300

Monitory vitálních funkcí (2ks):

Nabízený typ: Carescape B 450 výrobce GE Healthcare

- modulární monitor vitálních funkcí, barevný displej min. 10" **Ano, nabízený typ splňuje, integrovaný displej dotykový 12"**
- 3 – 5-ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie, atd. **Ano, nabízený typ splňuje, kromě základního sw je součástí nabídky i kompletní analýza arytmií vč A-fib**
- možnost rozšíření na 12 svodové EKG s interpretací, plnými arytmiemi a zobrazením ST úseku **Ano, nabízený typ splňuje, možnost rozšíření vložení sw kodu**
- respirace **Ano, nabízený typ splňuje**
- minimálně 2 teploty **Ano, nabízený typ splňuje, snímání a zobrazování 2 teplot současně**
- pulzní oxymetrie **Ano, nabízený typ splňuje, saturace typ Masimo**
- měření NIBP **Ano, nabízený typ splňuje, měření dvouhadicovým připojením**
- měření 2 IBP na každém monitoru, možnost rozšíření až na 4 x IBP **Ano, nabízený typ splňuje**
- měření kapnometrie EtCO2 s možností volby mainstream vč. snímače, sidestream **Ano, nabízený typ splňuje**
- modul 4 kanál EEG vč. Příslušenství **Ano, nabízený typ splňuje, součástí nabídky jsou 2 ks přenositelných modulů 4-kanálového EEG včetně kompletního příslušenství**
- možnost připojení externích zařízení **Ano, nabízený typ splňuje**
- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně **Ano, nabízený typ splňuje, zobrazuje 6 křivek a současně číselné parametry**
- možnost připojení externího displeje **Ano, nabízený typ splňuje, lze připojit externí nezávisle ovládaný displej**
- paměť minimálně 24 hodin s 1 minutovým rozlišením s grafickými a tabelárními trendy **Ano, nabízený typ splňuje, trendy 24 hod jsou součástí základního sw, lze rozšířit na 72 hod**
- výstup pro bezdrátové připojení do monitorovací sítě **Ano, nabízený typ splňuje**
- možnost transportního provozu až 8 hodin na 2 bat. **Ano, nabízený typ splňuje**
- možnost upevnění monitoru na horizontální i vertikální tyč **Ano, nabízený typ splňuje**
- pracovní prostředí v českém jazyce **Ano, nabízený typ splňuje, součástí základního sw je ovládání v češtině**
- minimálně 3 předdefinovatelné režimy monitoru po zapnutí **Ano, nabízený typ splňuje, monitor má v základních sw k dispozici 8 profilů a 6 variant zobrazení**
- jednotný SW a jednotné uživatelské rozhraní **Ano, nabízený typ splňuje**
- moduly (funkce) lze odblokovat heslem **Ano, nabízený typ splňuje**
- jednoduché intuitivní ovládání **Ano, nabízený typ splňuje**
- kompatibilita se současnou centrální monitorovací stanicí - musí být kompatibilní s centrálou Marquette Hellige (GE Healthcare) **Ano, nabízený typ splňuje, výrobce GE Healthcare zaručuje kompatibilitu návazných systémů**



Příloha č. 2 – ROZPIS CENOVÉ NABÍDKY


Typ ceny	Počet kusů	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks	Nabídková cena v Kč celkem bez DPH	Výše DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena celkem s DPH
Část VZ č. 26 - Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (lůžko)	6	140 000,-	840 000,-	15 %	176 400,-	1 016 400,-

Typ ceny	Počet kusů	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks	Nabídková cena v Kč celkem bez DPH	Výše DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena celkem s DPH
Část VZ č. 26 - Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (monitory vitálních funkcí)	2	281 800,-	563 600,-	21 %	118 356,-	681 956,-

Typ ceny	Počet kusů	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks	Nabídková cena v Kč celkem bez DPH	Výše DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena celkem s DPH
Část VZ č. 26 - Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (ventilátory)	6	370 000,-	2 220 000,-	21 %	466 200,-	2 686 200,-

Typ ceny	Počet kusů	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks	Nabídková cena v Kč celkem bez DPH	Výše DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena celkem s DPH
Část VZ č. 26 - Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená (lůžko, monitor do centrály, ventilátor)	14	258 828,57	3 623 600,-	15 % 21 %	760 956,-	4 384 556,-

V Praze dne


Hoyer Praha s.r.o.
 Kilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
 DIČ: CZ60491582 (9)
 tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
 Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Příloha č. 3 návrhu smlouvy:
Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet

Klasifikační třída ZP (třída rizika):

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu měsíců

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění je garantován po dobu měsíců, firmou

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

Zboží převzal:

datum:

datum:

podpis:

podpis: