



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 Překládové zařízení pro Oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2983/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických parametrech požaduje nosnost překládového zařízení min.180kg. Vzhledem k tomu, že zadavatel ve výběrových řízení požaduje operační stoly s nosností min.250kg, tak u překládového zařízení, které je vstupní branou na operační sály a je určeno pro překlád těžkých pacientů, by nedávalo smysl, aby překládové zařízení mělo nosnost nižší než používané stoly a na vstupu omezovalo běh všech operačních sálů a zvyšovalo tím nároky na personál při zvedání těžkých břemen. Bude tedy zadavatel požadovat vyšší nosnost min.220kg?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku technického parametru. Z průzkumu trhu vyplývá, že stanovením nosnosti na minimálně 220 kg (jak navrhuje tazatel) by došlo k omezení hospodářské soutěže, resp. k jejímu vyloučení, protože daný požadavek by splňoval pouze jeden dodavatel a to samotný tazatel. Ten si vlastně i sám odporuje, když uvádí, že požadovat překládové zařízení s nižší nosností, než je nosnost operačních stolů, by nedávalo smysl, sám však ve svém dotazu navrhuje nosnost sice vyšší, než zadavatel požaduje, ale stále nižší, než je nosnost operačních stolů, tedy dle jeho slov - nesmyslnou. Vyšší nosnost operačních stolů než překládového zařízení vyplývá z vyšší míry zatížení operačních stolů v průběhu operace dalšími předměty, tlakem operátora apod. Zadavatel nebude požadovat vyšší nosnost překládového zařízení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel dále v technických parametrech požaduje ovládání překládového zařízení pomocí bezdrátového dálkového ovládání. Bude zadavatel akceptovat vyšší stupeň vybavení a to ovládání pomocí barevného dotykového displeje zobrazujícího veškeré stavy zařízení a zvyšující tak komfort a bezpečnost provozu?

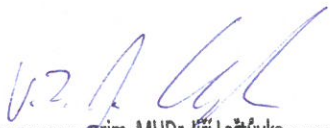
Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, Zadavatel připouští i toto navržené technické řešení.



V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

V Ústí nad Labem dne: **08-02-2023**


.....prim. MUDr. Jitka Laštůvka.....
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel