



Název veřejné zakázky: **Úpravna vody pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3306/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### **1) Specifikace - Zadávací dokumentace – Příloha č. 2 „Technická specifikace“**

**V Příloze č. 2 Technická specifikace uvádí zadavatel požadavek:**

- *Kapacita minimálně 1200 l/hod garantovaná při teplotě vstupní vody 15 °C*

Zároveň také v této příloze uvádí požadavek:

- *Výkon pro zajištění provozu 12 dialyzačních přístrojů*

Uchazeč přesně rozumí, že zadavatel požaduje výkon na všechny dialyzační přístroje. Výrobci dialyzačních přístrojů zpravidla uvádí spotřebu vody 50l/hod, což je dle praxe a výpočtů spotřeba s velkou rezervou.

Dále z klinické praxe je všeobecně známo, že na oddělení akutní péče s nejvyšší pravděpodobností nebude připojeno 12 dialyzačních monitorů najednou. Standardně se na takovém oddělení přemísťuje dle potřeby jen pár dialyzačních monitorů a přípojné místo na každém boxu je z důvodu, aby nemusel pacient cestovat za monitorem, ale monitor za pacientem. Tudiž, i kdyby nastala krajně nepravděpodobná situace, že by na oddělení KAPIM byl souběh, byť i 10 pacientů, tak v případě uváděné spotřeby vody 50l/hod by bylo možné nabídnout i úpravnu vody s menší kapacitou např. 500 l/hod, která plně zajistí potřeby oddělení a výrazně sníží pořizovací a provozní náklady zadavatele na technologii úpravy vody.

#### **Dotaz č. 1:**

Zváží zadavatel možnost snížit požadavek na minimální kapacitu například 500 l/hod garantovanou při teplotě vstupní vody 15 °C?

#### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel přistoupil ke snížení kapacity úpravy vody na minimální hodnotu 500 l/hod. garantovanou při teplotě vstupní vody 15 °C.

**2) Specifikace - Zadávací dokumentace – Příloha č. 1 „Krycí list nabídky“****V Příloze č. 1 Krycí list nabídky uvádí zadavatel požadavek:**

- *Nabídková cena za vázaný spotřební materiál*

*Uchazeč se domnívá, že došlo k administrativní chybě, jelikož obecně k úpravnám vody není vázaný spotřební materiál. Jediný spotřební materiál, který se dodává k úpravě vody je sůl, která je možná dodat různými dodavateli, kteří mají ve svém portfoliu tabletovou sůl vhodnou pro úpravu vody pro dialýzu.*

**Dotaz č. 2:**

Vypustí zadavatel z krycího listu požadavek na uvedení ceny vázaného spotřebního materiálu?


**Odpověď č. 2:**

Nejedná se o administrativní pochybení. Krycí list nabídky je „univerzální dokument“, ve kterém dodavatel vyplní pouze položky, které jsou součástí jeho nabídky. Jestliže součástí nabídky není vázaný spotřební materiál, dodavatel tuto kolonku nevyplňuje.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 29-03-2023

06  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

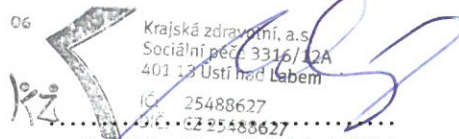

**MUDr. Petr Malý, MBA**  
generální ředitel společnosti