



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Dodávka kolposkopů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnici Litoměřice, o.z. - Část 2 - Dodávka kolposkopu - Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3571/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2b - Technická specifikace REACT-EU 98 - Dodávka kolposkopů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnici Litoměřice, o.z. - Část 2 - Dodávka kolposkopu - Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje „Šířka pracovní plochy sedáku alespoň 60 cm“.

Účastník nabízí gynekologické vyšetřovací křeslo s šířkou pracovní plochy sedáku 55 cm, což je parametr, který splňuje Zadavatelem požadovanou toleranci a ze zkušenosti víme, že tento parametr splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel.

Bude Zadavatel akceptovat gynekologické vyšetřovací křeslo s šířkou pracovní plochy sedáku min. 55 cm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na parametru, který je uveden v technické specifikaci.

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2b - Technická specifikace REACT-EU 98 - Dodávka kolposkopů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnici Litoměřice, o.z. - Část 2 - Dodávka kolposkopu - Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje „Zatížitelnost minimálně 180 kg“

Účastník nabízí gynekologické vyšetřovací křeslo maximální zatížitelností 150 kg.

Bude Zadavatel akceptovat gynekologické vyšetřovací křeslo s maximální zatížitelností 150 kg?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na parametru, který je uveden v technické specifikaci.

Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 2b - Technická specifikace REACT-EU 98 - Dodávka kolposkopů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnici Litoměřice, o.z. - Část 2 - Dodávka kolposkopu - Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje „Měnitelné zvětšení minimálně v 5 krocích v rozsahu zvětšení minimálně 5x až 22x“.

Účastník nabízí kolposkop s měnitelným zvětšením v 5 krocích 3,4× až 21,2×, což splňuje požadovaný medicínský účel zadavatele a je v rozmezí obvyklé tolerance.

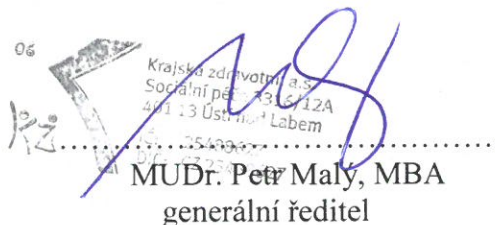
Bude Zadavatel akceptovat kolposkop s měnitelným zvětšením v 5 krocích 3,4× až 21,2×?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel připouští účastníkem nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 20-07-2023


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel