



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Most, o.z. - Část 1 - REACT-EU 100 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3532/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

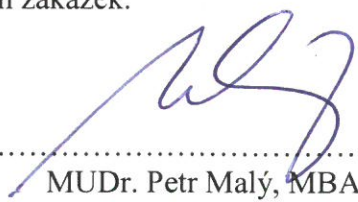
V Technických specifikacích 2a Zadavatel požaduje teplotní rozmezí inkubátoru 4°C - 40° C. Je zadavatel ochoten akceptovat analyzátor, který má 4 inkubační jednotky s teplotním rozmezím + 5°C - 50° C? Na správný průběh analýzy nemá vliv, zda inkubátor pracuje od 4 ° C nebo od 5 ° C. Inkubátor během testování metodou ELISA běžně pracuje s teplotami 20-37 °C a takto nízké teploty se používají minimálně.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští i nabízené technické řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **14 -08- 2023**


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

