

Název veřejné zakázky: **Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - Část 1 - Ohřívač infuzí a krevních produktů**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Podlimitní veřejná zakázka**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3746/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V původním zadání identické veřejné zakázky na dodávku 30 kusů ohřívačů infuzí a krevních produktů, která byla po několika měsících zrušena, byl uveden požadavek „Možnost použití při průtoku až 100 ml/min“. V současné veřejné zakázce byly kvalitativní požadavky na přístroj výrazně sníženy. Původně požadovaný průtok byl 6 litrů / hod a nyní současně požadovaný průtok je pouhý 1 litr / hod. Současně požadované parametry odpovídají konkrétnímu typu přístroje, jehož výkon a možnosti jsou podstatně nižší než běžně používané ohřívače infuzí a krevních produktů v nemocnicích v ČR. Takovýto přístroj je určen k ohřevu při průtocích pouze 10–20 ml / minutu se zásadním předpokladem vstupní kapaliny o pokojové teplotě.

Dotaz č. 1:

Je si zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům vědom podstatného snížení požadavků a rizika, že v případě potřeby podání vstupní kapaliny o nízké teplotě 8-10°Celsia není takovýto systém s omezeným výkonem schopen kapalinu ohřát na požadovanou teplotu?

Odpověď č. 1:

Zadavatel si je vědom snížení požadavku, zároveň si je plně vědom využití požadovaného zdravotnického prostředku. Účely, pro které bude zdravotnický prostředek využíván, nenesou v žádném případě možnost rizika nedostatečného zahřátí vstupní kapaliny. Zadavatel si trvá na znění technické specifikace.

Dotaz č. 2:


Vzhledem k výše uvedeným faktům změní zadavatel požadavek na možnost použití při průtoku až 100 ml / minutu?

Odpověď č. 2:

Zadavatel si trvá na znění technické specifikace v plné výši. Může se ovšem nabídnout i výrobek, který umožňuje použití při průtoku až 100ml za minutu. Nebude to v rozporu s technickou specifikací.

V Ústí nad Labem dne:

21-12-2023

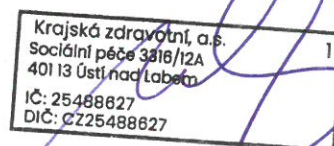

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti