

Název veřejné zakázky: **Systém pro ohřev pacienta pro kliniku KAPIM - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.**  
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky  
Režim veřejné zakázky: VZMR  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **4014/2024**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1:

V rámci této žádosti o vysvětlení žádá Dodavatel Zadavatele o transparentní vysvětlení změněné přílohy č. 2 (technické specifikace), ve které došlo k diskriminační úpravě a odstranění podmínky „minimálně“ u požadavků na podložky u rozměrů „Velká: 50 x 125 - 150 cm, Malá: 50 x 80 - 85 cm“ oproti původnímu znění - „Velká *minimálně*: 50 x 120 cm, Malá *minimálně*: 50 x 80 cm“ zrušené veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Systém pro ohřev pacienta pro kliniku KAPIM - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

V návaznosti na výše uvedený dotaz žádá Dodavatel o odstranění diskriminačního nastavení přílohy č. 2 (technické specifikace) VZMR a opětovného uvedení „minimálně“ u požadavku na podložku u rozměru „Malá: 50 x 80 - 85 cm“.

### Odpověď na dotaz č. 1:

Důvodem pro úpravu technické specifikace byl jediný důvod, a to nesprávně zadané požadavky na požadovanou délku vyhřívacích podložek.

U požadovaných krátkých podložek bylo bohužel nesprávně zadáno "minimálně" místo "maximálně", event. rozsah maximálního požadovaného rozmezí. V důsledku této administrativní chyby bylo možné v rámci požadovaných krátkých podložek potenciálně dodat jakoukoliv délku podložky, která překročila uvedenou hodnotu, což je samozřejmě logicky nesmysl a vůbec neodpovídá našim klinickým požadavkům na délku krátkých podložek.

Z tohoto důvodu bylo nutné technické specifikace upravit tak, aby požadavky na délku krátkých podložek skutečně odpovídali našim klinickým potřebám, a to ve formě definovaného rozmezí délky obou typů podložek.

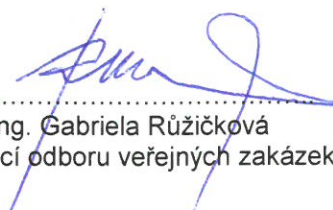
V předchozích výběrových řízeních toto bylo uvedeno správně, včetně vysvětlení důvodu, proč požadujeme právě tento (krátký) rozměr vyhřívaných podložek a žádné připomínky ze strany potenciálních dodavatelů kvůli tomuto požadavku vzneseny nebyly.

Hlavním důvodem pro potřeby těchto krátkých podložek je možnost a zároveň nutnost ohřevu pouze horní poloviny těla u pacientů podstupujících cévní výkony v dolní polovině těla, včetně výkonu v oblasti břišní aorty. U těchto výkonů je ohřev spodní části vysoce rizikový a dle odborných doporučení i kontraindikovaný. Ze stejného důvodu je zvýšené riziko ischemického poškození dolních končetin při používání ohřevu dolní poloviny těla i u pacientů s pokročilou ischemickou nemocí dolních končetin. Toto riziko se ještě více zvyšuje u dlouhých operačních výkonů. Na našem pracovišti jsou tyto výkony běžně prováděny a požadavek na krátkou podložku

nezasahující svou délkou do dolní poloviny těla tedy považujeme za naprosto relevantní. U pacientů nižšího vzrůstu již podložky s délkou nad 90-100cm tento požadavek nenaplnují.

Z čistě praktických důvodů používáme tyto krátké podložky i u výkonů u dětských pacientů, včetně novorozenců a kojenců, které nám nahrazují absenci klasického babythermu (přístroje zajišťujícího spodní i horní ohřev).

V Ústí nad Labem dne: - 8 -07- 2024

  
.....  
Ing. Gabriela Růžičková  
Vedoucí odboru veřejných zakázek