

Název veřejné zakázky: **Přístroj pro mechanickou srdeční podporu pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: režim nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3882/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Naše společnost je distributorem krátkodobých mechanických srdečních podpor.

Můžeme nabídnout přístroj krátkodobé mechanické srdeční podpory, která se dle Návodu k použití musí používat se záložním přístrojem, a jejich servis je prováděn následovně: BTK 1x ročně, kalibrace interní baterie 2x ročně, výměna interní baterie 1x za 2 roky.

Z návodu k použití vypracovaného a předepsaného výrobcem, plyne, že životnost přístroje je 5 let. Použití konzole po době životnosti je pak závislá na technickém stavu konkrétní konzole a nelze ji předem předjímat.

S ohledem na shora uvedené tedy vznášíme následující dotazy k VZ:

Dotaz č.1:

Chápeme správně, že předpokládaná cena za pozáruční servis na dobu 96 měsíců ve výši 143.840, - Kč se týká pouze jednoho z dodávaných přístrojů a pro druhý bude ve stejné výši?

Odpověď na dotaz č. 1:

Předpokládaná cena servisu vycházela z cenové nabídky zaslané během průzkumu trhu. Zadavatel očekává, že budou zajištěny všechny úkony dle pokynů výrobce (BTK 1x ročně, kalibrace interní baterie 2x ročně, výměna interní baterie 1x za 2 roky) po dobu provozu přístroje. A tyto úkony budou adekvátně naceněny. Cena za pozáruční servis zahrnuje obě konzole, tzn. přístroj jako jeden celek.

Dotaz č.2:

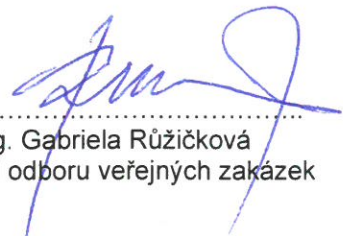
Vzhledem k životnosti námi dodávaného přístroje, která je předepsaná výrobcem v návodu k použití, chápeme správně, že zadavatel si je této předepsané životnosti vědom a chápe, že použití konzole nad rámec uvedených 5 let od data předání nelze garantovat a bude záviset na technickém stavu konkrétní konzole v období po době životnosti, tj. chápeme správně, že případné nedodržení požadovaných 96 měsíců nebude zadavatel jakkoli penalizovat?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel na základě konkrétních zkušeností ze své činnosti ví, že doba životnosti poptávaného zdravotnického prostředku přesahuje výrobcem garantovanou životnost 5 let. Požadavek na pozáruční servis v rozsahu vymezeném v obligatorním návrhu smlouvy na dobu 96 měsíců vychází tedy z těchto konkrétních zkušeností. Zadavatel souhlasí s názorem tazatele, že při poskytování požadovaného pozáručního servisu bude záviset na technickém stavu konkrétní konzole. Pokud technický stav konkrétní konzole bude takový, že další poskytování pozáručního servisu bude objektivně nemožné, neúčelné nebo neefektivní, nebude zadavatel penalizovat jeho další neposkytování.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **17.07.2024**


.....
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí odboru veřejných zakázek