

Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – oddělení Urgentního příjmu**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh výběrového řízení: otevřená výzva
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4522/2025**

Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 2

Zadavateli byla dne 5. 6. 2025 doručena žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:


Položka č. 3, T-6515

Prosím budete akceptovat náš standardní výrobek, který je obdobný Vámi poptávaného?

NEREZ2820NZ – nerez plato

š76 cm x h84 cm x v84 cm - zkl. rozměry bez příslušenství

- konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- 1x zásuvka vel. M (v12 cm); nosnost: 20 kg
- centrální zamykání
- 4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 120 kg

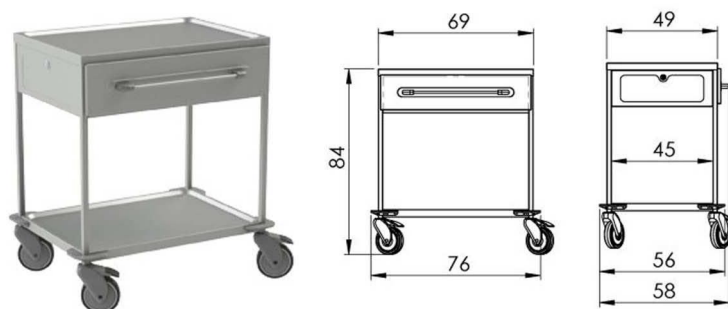


Odpověď č. 1:

Zadavatel neakceptuje výše uvedený výrobek. Zadavatel důkladně zvážil své potřeby s ohledem na provoz

Urgentního oddělení a sděluje, že trvá na parametru výšky plata 65 cm, a to z důvodu možnosti práce v sedě. Zadavatel též trvá na požadavku ohrádky, a to z důvodu zamezení pádů předmětu na zem.

Dotaz č. 2:

Položka č. 5, T-5414

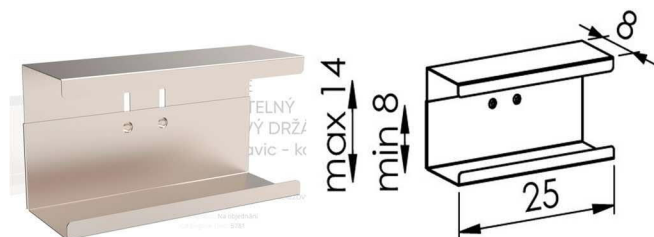

Prosím budete akceptovat naše konstrukční řešení držáku rukavic, když bude zachováno magnetické uchycení.

Odpověď č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že v technické specifikaci se jedná o položku č. 6. Zadavatel bude akceptovat takové řešení, které bude vybaveno magnetickým uchycením a bude použitelné jak pro zásuvkové vozíky, tak pro kovový nábytek v ambulancích. Zadavatel požaduje bezpečný a funkční držák, který umožní uložení různých velikostí balení rukavic běžně používaných v jeho provozu.

Zadavatel záměrně nestanovil konkrétní technické provedení držáku, aby umožnil účast co nejširšímu okruhu účastníků a uvedl pouze rozměry balení, která se v jeho provozu běžně vyskytují.

Zadavatel analogicky v souladu s § 36 odst. 3 ZZVZ stanovil zadávací podmínky a poskytl je dodavatelům v rozsahu a podrobnostech nezbytných pro řádnou přípravu nabídky a účast v zadávacím řízení.


Vzhledem k tomu, že se zadávací řízení nachází ve fázi, kdy běží lhůta pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, není úkolem zadavatele posuzovat konkrétní výrobky nebo technická řešení, která mu jsou v této fázi ze strany účastníků neformálně předkládána. Posuzování technických řešení bude probíhat až na základě řádně podaných nabídek v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Zadavatel trvá na dodržení všech stanovených podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

Položka č. 8, T-6529

Budete prosím akceptovat naše konstrukční řešení – zdravotnický vozík ZV2263N

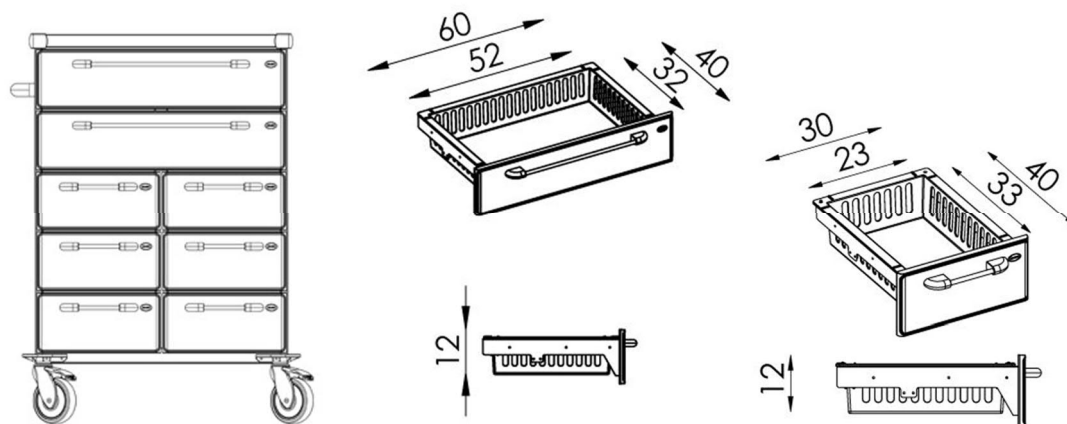

- prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS); MS koše - 2 velikosti: STANDARD (nosnost 20 kg) a (1/2) MINI (nosnost 10 kg); lze rozdělit příčkami
- š83 cm x h57 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
- prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
- 2x vel. M, 6x 1/2 vel. M
- čelo zásuvky dle vzorníku barev
- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- centrální zamykání
- plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku
- tlačné madlo: plast
- 4x kvalitní plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg

Odpověď č. 3:

Zadavatel pečlivě zvážil své provozní potřeby a v zadávací dokumentaci stanovil požadavek na vozík, jehož horní deska má šířku 90 cm a hloubku 58 cm, s tolerancí $\pm 5\%$.

Na základě provedené kontroly informací zveřejněných na webových stránkách dodavatele bylo zjištěno, že rozměry uváděné dodavatelem ve vztahu k vozíku nezahrnují rozměry samotné horní pracovní desky, ale celkový půdorysný rozměr včetně madel a ochranných nárazníků. Rozměry samotné desky přitom činí pouze cca 69 cm na šířku a 49 cm na hloubku.

Zadavatel považuje za zcela nepřijatelné, že dodavatel ve svém dotazu operuje s údaji, které neodpovídají požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci a zjevně zkreslují skutečný stav. Rozměry horní desky nabízeného vozíku jsou ve skutečnosti o více než jednu třetinu menší, než je zadavatelem výslovně požadováno, což zásadně nevyhovuje funkčním potřebám zadavatele.


Zadavatel proto znovu zdůrazňuje, že požadavky stanovené v zadávací dokumentaci jsou závazné a musí být dodrženy ve všech relevantních ohledech. Nabídky, které těmto požadavkům neodpovídají, budou posuzovány jako nesplňující zadávací podmínky.

Zadavatel proto trvá na požadavcích stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4:

Položka č.10, T-6551

Budete prosím akceptovat toto konstrukční řešení, které je na obrázku a technickém nákresu v počtu 3 ks

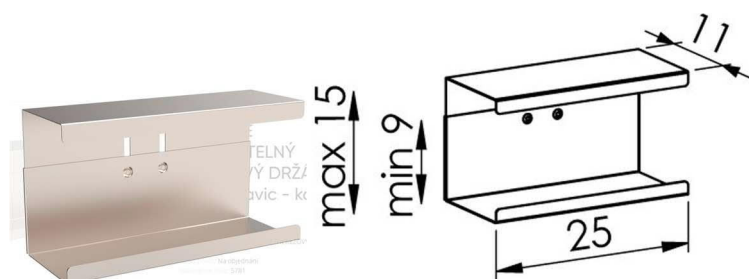

Odpověď č. 4:

Viz. Odpověď č. 2. Zadavatel trvá na požadavcích stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 5:

Položka č. 12, T-6553

Budete akceptovat jiné konstrukční řešení provedení držáku na ubrousky, např. drátěný koš?

Odpověď č. 5:

Zadavatel požaduje, jak je zřejmé z ilustračního obrázku uvedeného v technické specifikaci, uzavřený systém, který při vytáhnutí jednoho ubrousku zamezí kontaminaci ostatních uložených ubrousků.

Vzhledem k tomu, že se zadávací řízení nachází ve fázi, kdy běží lhůta pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, není úkolem zadavatele posuzovat konkrétní výrobky nebo technická řešení, která mu jsou v této fázi ze strany účastníků neformálně předkládána. Posuzování technických řešení bude probíhat až na základě řádně podaných nabídek v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Zadavatel trvá na dodržení všech stanovených podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 6:


Položka 13, T-6554

Pro tuto položku bychom mohli nabídnout 2 varianty a to plastový: • objem: 10l



nebo nerezový:

- nádoba z nerezové oceli AISI304 - komplet
- pro ošetření nerezové oceli AISI304 nepoužívejte žádné čisticí prostředky, obsahující agresivní chemii (například chlór)!
- objem: 15l

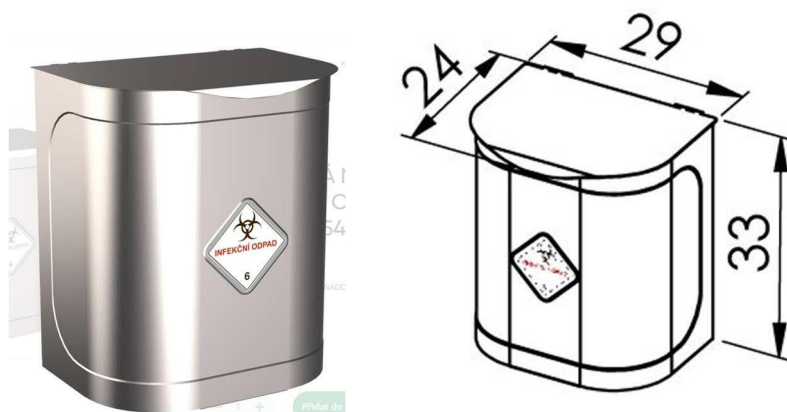

Odpověď č. 6:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace připustil různá technická provedení, avšak vždy za podmínky, že nabízené řešení bude disponovat minimálním objemem 30 litrů. Zadavatel trvá na dodržení této specifikace v souladu se zadávací dokumentací.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu

.....
Marek Sedlák
Vedoucí oddělení administrace veřejných zakázek