

Objednávka 2600175718

Datum objednávky 02.09.2025

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická těch.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231

284 01 Kutná Hora - Karlov

Vaše číslo dodavatele u nás

1001701

Termín dodávky: 25.09.2025

Dodávka pro COS NCH

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota	
00010		Servis příslušenství		
1	Kus	73.338,10	73.338,10	

Objednáváme u Vás servis přístroje "LAPARO PUMPA ENDOMAT SELECT SCB UP210", který byl zapůjčen na Neurochirurgickém sále /budova A, sál č.5/, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Výrobní číslo: PR545 Inventární číslo: -----

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Závada: Přístroj byl po zapůjčení vrácen poškozen viz servisní report.

Po diagnostice závady byl zaslán součet oprav č.: P2025020978

Celk.hodn. s DPH CZK

,

73.338,10

Vys

Z d [REDACTED] 7 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Servisní report

Datum: 28.8.2025




Číslo opravy: P2025020978

Přijatý přístroj: UP210 v.č: PR545

Hlášená závada:
nefunkční tlakový senzor

Diagnóza a provedené práce:


- Výměna šasi (nový díl)
- Výměna krytu přístroje
- Výměna těsnění krytu přístroje
- Výměna štítků
- Výměna transportní ochrany
- Oprava aretace kazety
- Výměna páky aretace
- Výměna desky se senzory
- Výměna základní desky pumpy
- Výměna světelného vodiče
- Výměna krytu pumpové hlavy

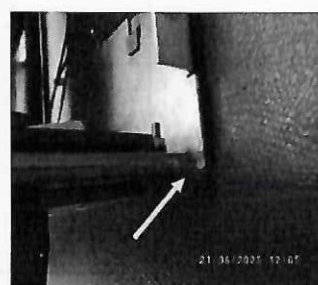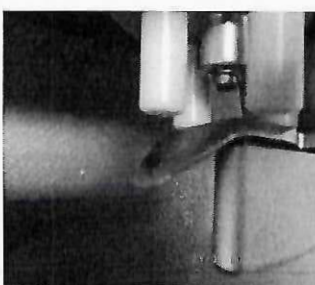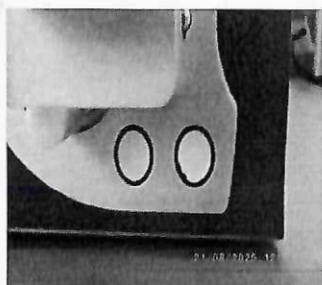

Výsledek:

Přístroj byl kompletně repasován dle výše uvedených kroků, otestován a je připraven k dalšímu bezpečnému používání.

Cenový návrh na opravu: 60.610kč bez DPH

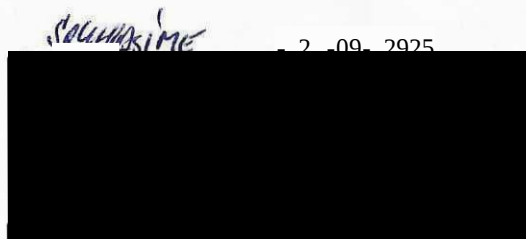

RADIX CZ s.r.o.. Čáslavská 231. 284 01 Kutná Hora, Karlov, Česká republika
www.radixcz.cz, radixaradixcz.cz, t