
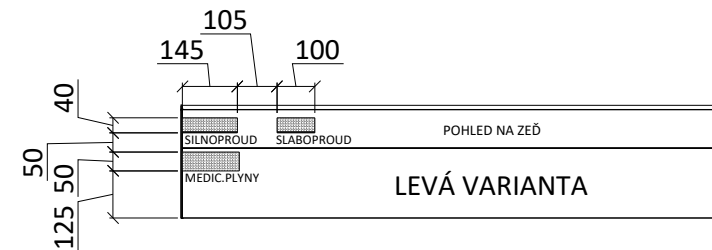
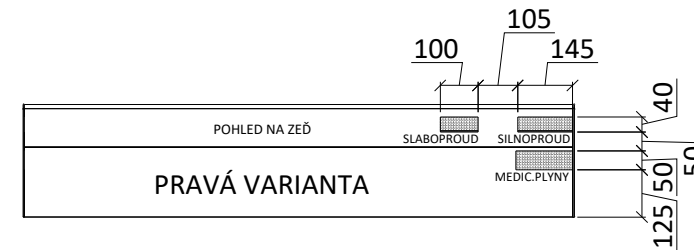


Detail1

1:20

DETAIL OTVORŮ ZE ZADNÍ STRANY RAMPY

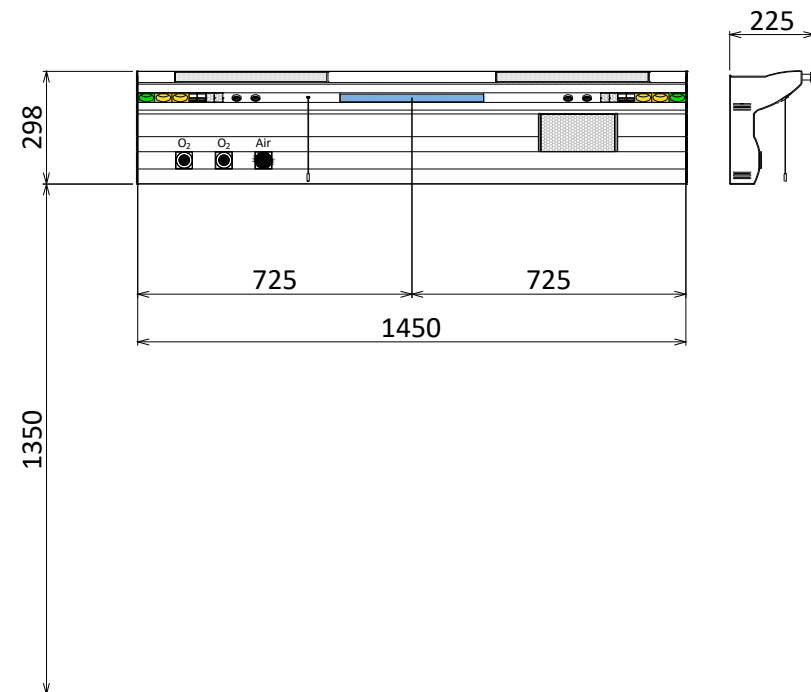

VYPLNIL:	Libor Kopáňko	DNE:	04/2025	ZAKÁZKA č.	-	OBJEDNACÍ LIST č.:	-	DATUM VÝROBY:	-
SCHVÁLIL:	-	DNE:	-	EXPEDIČNÍ LIST č.:	-	VERZE č.:	-		
ZÁKAZNÍK:	Nemocnice Ústí nad Labem			MÍSTO STAVBY:	Nemocniční blok SO D2 - OBJEKT D2				

TYP VÝROBKU:	LŮŽKOVÁ RAMPY PRO 1 LŮŽKO	JAZYKOVÁ MUTÁCIE VÝROBKU:	ČESKY	POZNÁMKA:	
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VPRAVO (MP + ELEKTRO):	3.04, 3.10, 3.11, 3.12, 3.40, 3.44				
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VLEVO (MP + ELEKTRO):	3.04, 3.10, 3.12, 3.44				

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ RAMPY MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVKY/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍRKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celou rampu)				
		KYSLÍK (O ₂)	OXID DUSNÝ (N ₂ O)	OXID UHLIČITÝ (CO ₂)	STLAČENÝ VZDUCH (Air _{bar})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	UPS (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	UPS
10	1	2 (12x1)	-	-	1 (8x1)	-	-	ČSN	-	2	4	-	-	ANO U OBVODU VDO A ZIS	4	-	1	1	-	-
		OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI				OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY OSVĚTLENÍM			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ + SPÍNÁNÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽKA RAMPY		BAREVNOST RAMPY						
RI45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDIUŠTA NOSNOST 20 kg			BOČNICE	VÍČKO "V" MEZI RSP A 230V	VÍČKO "K1,2,3" PŘEDNÍ VÍČKA	PROFIL "P,E" HLAVNÍ PROFILY			
4x	-	1x	4x	-	ANO spínané na rampě - tahový vypínač	-	ANO spínané ode dveří	Spínané táhlem na rampě	-	Spínané ode dveří	2x (á délka 400 mm)			RAL 7035	RAL 9010	ELOX	ELOX			