

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi:

LaparoTech Instruments s. r. o.

se sídlem: Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 256 22 846

DIČ: CZ25622846

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 55647

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní údaje: tel: [REDAKCE]

Kontakt ve věcech soutěže: [REDAKCE]

Kontakt ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II. - část č. 1

I.

Předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002831, který je podpořen z 5. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabytí vlastnické právo k němu a to k:
 - **Instrumentariu pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů**
 (dále jen přístroj nebo zboží) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
2. Předmětem smlouvy je i:
 - montáž zboží,
 - instalace zboží,
 - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
 - instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži,
 - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy a dále záruční servis dle níže uvedených podmínek,
 - likvidace obalového materiálu.
3. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. I (technická specifikace zboží) této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je **2 226 000,-** Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a je cenou konečnou a je v ní obsaženo veškeré plnění dle této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a musí splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak:
 - IČO,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - soupis příloh,
 - název projektu: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,**
 - registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002831,
 - přílohou faktury musí být protokol o předání zboží.
5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
7. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno níže v čl. III odst. 2 smlouvy.

8. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílejší části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení faktury prodávajícímu k přepracování. Lhůta splatnosti nové faktury začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury kupujícím.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do (56) kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]
Pověřeným zástupcem kupujícího jsou: [REDACTED]
1. [REDACTED]
[REDACTED] nebo pověřený pracovník OOKC kupujícího.
2. Za předání zboží se považuje:
 - a. jeho dodání na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – klinika gynekologicko-porodnická
 - b. montáž zboží,
 - c. instalace zboží,
 - d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - e. provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - f. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži,
 - g. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícím záření (atomový zákon), zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění, a současně
 - h. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“),
 - i. likvidace obalového materiálu
3. Zvláštní požadavky:
 - a. Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k

- veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
- b. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
 - c. Protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem odboru obslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží. V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1,2 této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v kupní ceně dle článku II. této smlouvy.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDACTED]
s. [REDACTED]
7. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením dle výše uvedených kontaktních údajů.
8. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do lhůty uvedené v článku V. odst. 7 smlouvy, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
9. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být kupujícím opakovaně písemně poskytnuta přiměřená lhůta pro odstranění vady. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další přiměřené lhůty, stejně tak o délce další přiměřené lhůty, rozhoduje kupující. Poskytnutí další přiměřené lhůty nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 8 tohoto článku.

10. Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba zboží se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady dle tohoto článku V. smlouvy.
11. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle §65 zákona č. 268/2014 Sb.
 - revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.
 - v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně
12. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny odborné údržby (periodických bezpečnostně technických kontrol) dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.
13. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je technik zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde v termínu dle čl. III. odst. 1 smlouvy k předání zboží, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 8 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) zboží.
4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII.

Zvláštní ustanovení

1. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

- zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 3. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

IX.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že smlouva s výši hodnoty jejího předmětu přesahující 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, pokud se na ní nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv, se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu, tj. včetně všech osobních údajů.
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv Krajská zdravotní, a. s. bez zbytečného odkladu.

X.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Prodávající na sebe přebírá dle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména veškeré změny kurzu cizích měn.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženu prodávajícímu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
8. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.


Příloha:

- 1) Technická specifikace zboží

Ve Staré Boleslavi

dne 28.1.2019


LaparoTech Instruments s. r. o.

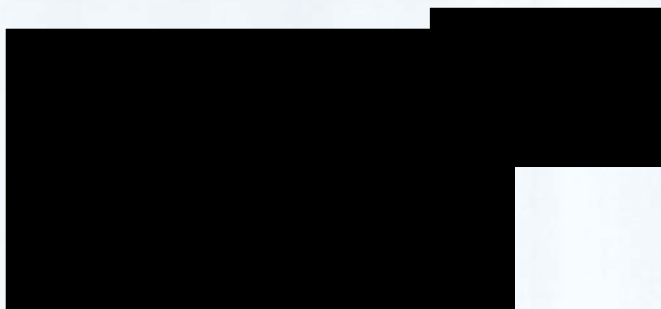

V Ústí nad Labem

dne 06-02-2019

Krajská zdravotní, a.s.

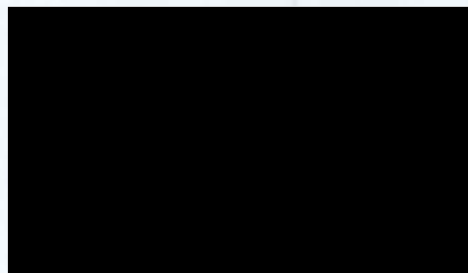

1) Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží

VERESS jehla 2,7mm, 120mm, „high flow“ 704-150



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

VERESS jehla 2,0mm, 230mm 704-159



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-4026, 704-476


Trokar, ø 10 mm, délka 105mm, složení: kanyla se závitem s rovným distálním zakončením, hlava trokaru s kohoutkem



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-026

Obturátor ve tvaru ostré špice, 10mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-4010-15

Bariatrický trokar ø 11mm, délka 150mm, složení: kanyla hladká se zdrsňným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na konci hylzny, hlava trokaru s kohoutem, s kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky v kompletním kovovém provedení bez plastových součástek



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-077


K uvedenému 11mm trokaru: bezpečnostní obturátor typu pyramidy



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-4012-15


Bariatrický trokar \varnothing 13mm, délka 150mm, složení: kanyla hladká se zdrsňeným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na konci hylzny, hlava trokaru s kohoutem, s kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky v kompletním kovovém provedení bez plastových součástí

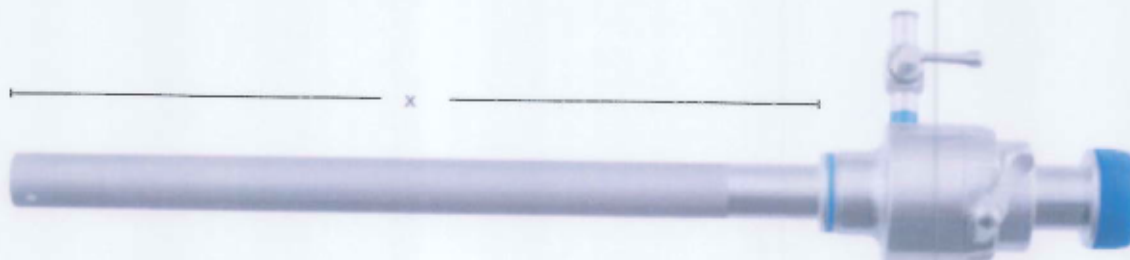

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-078


K uvedenému 13mm trokaru: bezpečnostní obturátor typu pyramidy



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

73-005-15 A

Trokar, \varnothing 15 mm, délka 105mm, složení: kanyla se závitem s rovným distálním zakončením, hlava trokaru s kohoutem

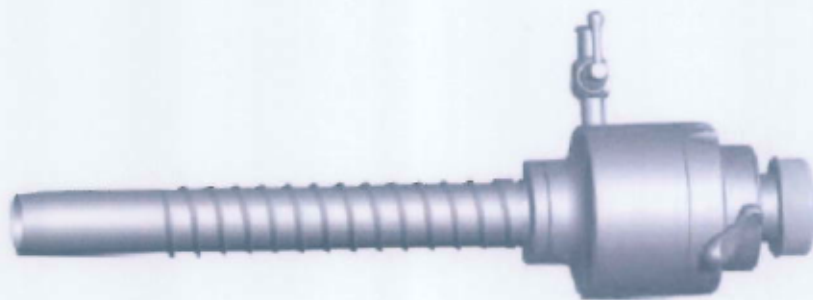

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

73-040-15

K uvedenému 15mm trokaru obturátor ve tvaru ostré špičky



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-4021, 704-472

Trokar, \varnothing 5,5 mm, délka 105mm, složení: kanyla se závitem s rovným distálním zakončením, hlava trokaru s kohoutkem



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-031

Tupý obturátor , průměr 5,5mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-016

Pyramidální ostrý obturátor, průměr 5,5mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-240

Přechodka trokaru plastová \varnothing 10mm- \varnothing 5,5mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-397 K

Hassonův kužel



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4068, 775-4010, 775-3995

Okénkový grasper vroubkovaný atraumatický, celotoččný \varnothing 5mm, délka 330 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací, délka branží 15 mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

73-383-33, 73-201-02RS, 73-205-33

Duvalovy kleště, \varnothing 5 mm, 330 mm, délka branží 20mm, zoubkované čelisti, rukojeť s vypínatelnou aretací



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4074, 775-4010, 775-3995

FUNDUS grasper, délka branží 20 mm, \varnothing 5mm, 330mm, rukojeť s vypínatelnou aretací



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4027TSC

Nůžky METZENBAUM, \varnothing 5mm, 330mm, rukojeť bez aretace s opěrkou pro prst, monopolární, celootočné,



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4027

Insert nůžek METZENBAUM pro \varnothing 5mm, 330mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4087, 775-4010, 775-3995

KOCHER klieště, \varnothing 5mm, 330mm, 2x1 zub, jedna pohyblivá branže, rukojeť s vypínatelnou



aretačí

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4100C

DEBAKEY atraumatický, \varnothing 5mm, 330mm, typ branží - rovné, rukojeť bez aretace



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4244, 775-4010, 775-3995

SCHROEDER jednozubý \varnothing 5mm, 330mm,délka branží 30 mm rukojeť s vypínatelnou



aretací

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-4098, 775-4010, 775-3995

Babcock \varnothing 5mm, 330mm, rukojeť s vypínatelnou aretací



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-5044, 775-4012, 775-3995

Babcock \varnothing 10mm, 330mm, rukojeť s vypínatelnou aretací



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

775-5089, 775-4012, 775-3995

Okénkový grasper atraumatický, hrubě vroubkovaný, \varnothing 10mm, 330mm, rukojeť s vypínatelnou aretací



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

707-520

Monopolární kabel 300cm, sterilizovatelný 134°C



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

706-159

Elektroda jehlová, monopolární \varnothing 5mm, 330mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

795-4900, 704-763

Elektroda typu háček „L“, v kombinaci s odsávacím a proplachovým kanálem, včetně rukojetě s dvoucestným ventilem pro ovládání sání a proplachu, \varnothing 5mm, 330mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

707-151

Elektroda typu háček „L“90°, bipolární, \varnothing 5mm, 340mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-120

Punkční kanula \varnothing 5mm, 330mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-122

Punkční kanula \varnothing 5mm, 450mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

544995, 544240


Klipovač \varnothing 10mm, 330mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lok large, včetně klipů velikosti L 200 ks



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

544990L, 544250

Klipovač ø 10mm, 450mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge, včetně klipů XL 80 ks

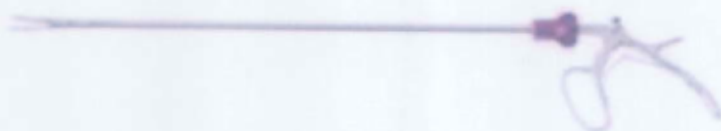

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

544965T, 544230


Klipovač ø 5mm, 330mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large, včetně klipů 25 ks.



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

544130

Odstranovač klipů Hem-o-Lok velikosti L/XL

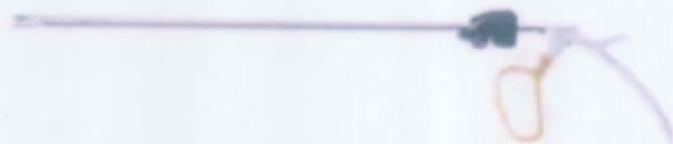

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

PL530R

Kleště pro aplikaci cévních klipů 12,5 mm, délka 34 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-110

Retraktor vějířový, \varnothing 5mm, 330mm, tříprstý



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-112


Retraktor vějířový, \varnothing 10mm, 360mm, pětiprstý



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-124

Retraktor rovný, \varnothing 5mm, 310mm, flexe s vytvořením triangulového tvaru na distálním konci

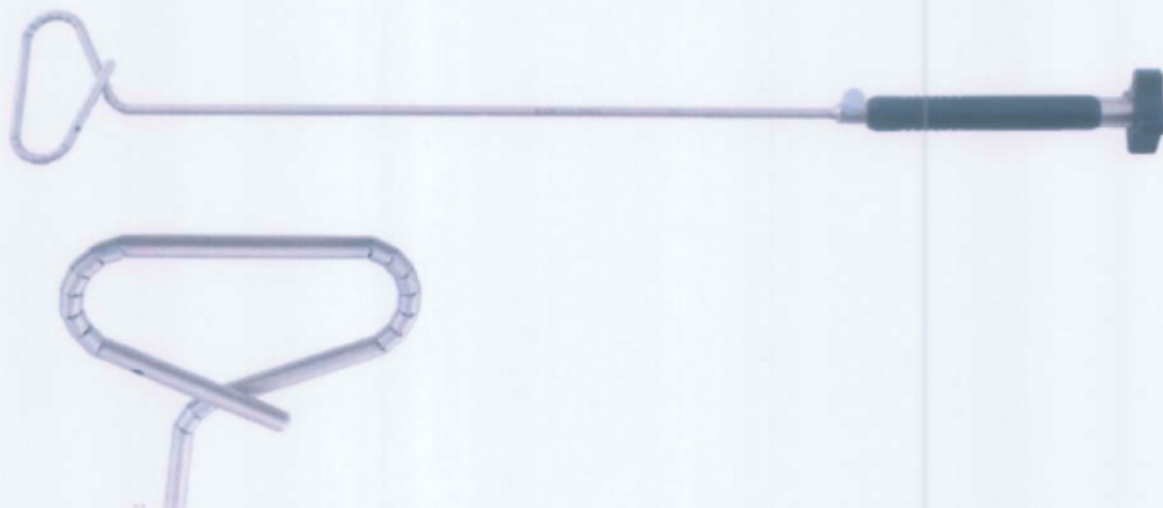

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

614-110-53


Laparoskopický jehlec, \varnothing 5mm, 330mm, zahnutý vlevo, axiální rukojeť s malým úhlem otevření, i pro menší ruku, integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu, teflonový povrch pro snadnou údržbu



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

614-510-53

Laparoskopický jehlec, \varnothing 5mm, 330mm, zahnutý vlevo, zahnutá rukojeť (jako u lsk. nástrojů), integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu

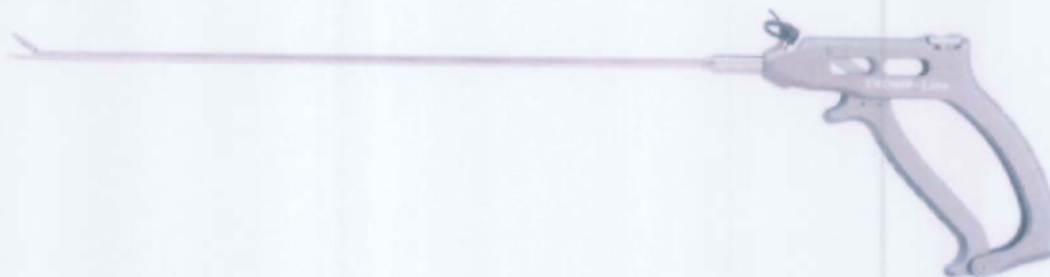

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

707-122

Bipolární úchopové kleště \varnothing 5mm, 340mm, celotočné



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

707-120

Bipolární kleště Maryland \varnothing 5mm, 340 mm, jemně křížově vroubkované branže



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

707-303, 90302-30

Bipolární kabel kompatibilní se vstupem pálení typu Olympus, autoklávovatelný 134°



3m

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-106

Utahovač uzlů CLERMONT-FERRAND Model, \varnothing 5 mm, 330 mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

Děložní manipulátor

UMH650

- Ručka manipulátoru k sacrocolpopexi



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

UMB678

- Děložní sonda k manipulátoru



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

KC-RUMI-25

- Děložní manipulátor elektrochirurgicky kompatibilní, průměr klobouků 2,5



cm

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

KCP-30-2

- Děložní manipulátor je elektrochirurgicky kompatibilní, průměr klobouků 3 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

KCP-35-2

- Děložní manipulátor je elektrochirurgicky kompatibilní, průměr klobouků 3,5 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

CPO-6

- Colpopneumoocluder



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-605

Sací a irigační rukojeť s ovládacím kohoutem (M8x1mm)



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-607

Sací a irigační kanula, 10mm, 330mm, s 8x4 otvory



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

704-608

Sací a irigační kanula, 5mm, 330mm, 4x4 otvory



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

707-600, 707-605, 707-610

Čistící pistole s min 9 adaptéry, kartáčky 5mm a 10mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

013-200-145

Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby 14,5 cm

013-130-210



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

013-130-210

Anatomická pinzeta Model USA, 21 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

030-281-320

Děložní sonda SIMS, tvarovatelná, délka 32 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

010-200-003

Násadka na skalpel č. 11, rukojeť 13 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

085-300-045


Nerezová miska, průměr 12 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

015-260-140

ROCHESTER- PEAN, rovný, délka 14cm

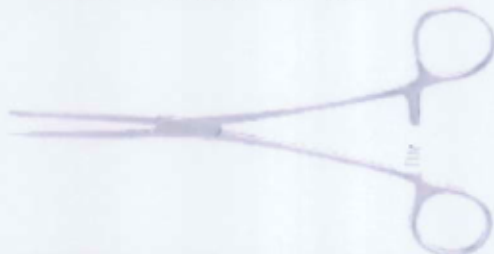

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.


015-280-140

KOCHER- OCHSNER kleště, rovné, délka 14cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

030-200-001, 030-200-400, 030-200-030, 030-200-035, 030-200-040, 030-200-060, 030-200-070
SCHERBAK zrcadlo- rukojeť + závaží + 5ks zrcadel

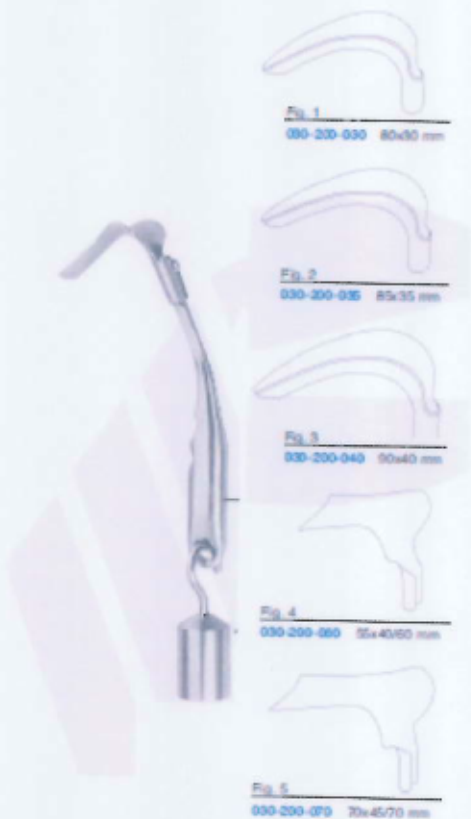

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

030-241-045
HEGAR dilatátor 4,5 mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

030-241-055
HEGAR dilatátor 5,5 mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

030-241-065

HEGAR dilatátor 6,5 mm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

019-640-200

TC-BOZEMANN jehelec 20 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

030-310-250

Schroeder tenaculum kleště, délka 25 cm



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

091-113-260

Ventilový kontejner velikost 580 x 280 x 260mm, ventilový filtrační systém nevyžadující údržbu, nastavení tří pracovních poloh ventilu v průběhu a po sterilizaci



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

095-220-100


Nerezové síto do kontejneru 540 x 255 x 100



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

87295-00

Univerzální držák na nástroje, vnější rozměry: 460 x 233 x 145 mm

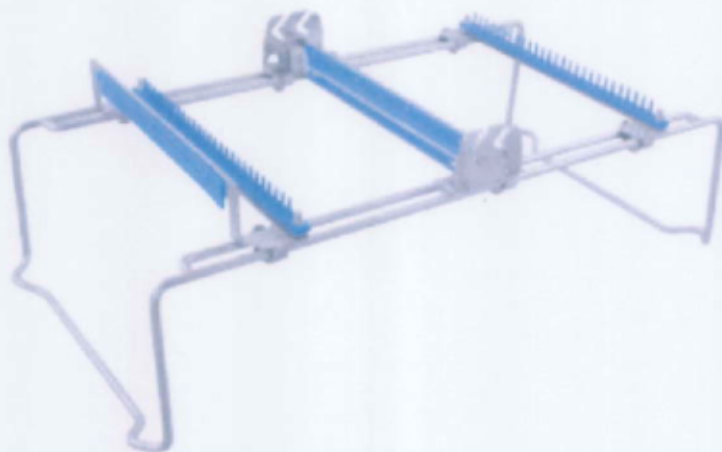

Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

Tkáňový morcelátor :
71500-00



- Kontrolní řídicí jednotka, transmisní jednotka včetně těsnění
- LED display na řídicí jednotce zobrazující aktuální nastavení
- Plynulá regulace otáček řízených mikroprocesorem v rozsahu od 100 do 1000 ot/min
- Možnost volby ze tří přednastavených rychlostních stupňů (low, medium, high)
- Možnost plynulé regulace otáček nožním ovládáním
- Krouticí moment 80 Ncm
- Možnost změny směru otáček vpravo/vlevo
- Motor pevně spojený s přívodním kabelem, odpojitelný od převodů, umístěný v rukojeti přístroje, autoklávovatelný, kabel 3m



- Ergonomická rukojeť



- Vysouvací nůž pro větší bezpečnost pacienta (před samotnou morcelací je zasunutý uvnitř nástroje)
Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

71504-12, 71504-15, 71504-20

- řezací trubice průměru 12, 15 a 20 cm včetně obturátorů



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

71-503-12, 71-503-15, 71-503-20

- Ochranná vnější pochva s tkáňovým polohovačem, zabraňující nechtěné rotaci tkáně



Dodavatel splňuje kompletně všechny parametry požadované zadavatelem.

kód výrobku	popis	ks
704-150	VERESS jehla, 2,7mm, 120mm, „high flow“	10
704-159	VERESS jehla 2,0mm, 230mm	2
704-4026, 704-476	Trokar, \varnothing 10 mm, délka 105mm, složení: kanyla se závitem, s rovným distálním zakončením, hlava trokaru s kohoutkem	12
704-026	K uvedenému 10mm trokaru obturátor, ve tvaru ostré špice	6
704-4010-15	Bariatrický trokar \varnothing 11mm, délka 150mm, složení: kanyla hladká se zdrsňeným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky., v kompletním kovovém provedení bez plastových součástí.	2
704-077	Bezpečnostní obturátor typu pyramidy k bariatrickému trokaru \varnothing 11mm	2
704-4012-15	Bariatrický trokar \varnothing 13mm, délka 150mm, složení: kanyla hladká se zdrsňeným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky, v kompletním kovovém provedení bez plastových součástí	2
704-078	Bezpečnostní obturátor typu pyramidy k bariatrickému trokaru \varnothing 13mm	2
73-005-15 A	Trokar, \varnothing 15 mm, délka 105 mm, složení: kanyla se závitem, s rovným distálním zakončením; hlava trokaru s kohoutkem	8
73-040-15	Obturátor \varnothing 15 mm ve tvaru ostré špice	4
704-4021, 704-472	Trokar, \varnothing 5,5 mm, délka 105mm, složení: kanyla se závitem, s rovným distálním zakončením; hlava trokaru s kohoutkem	15
704-031	Tupý obturátor \varnothing 5,5 mm	5
704-016	Pyramidální ostrý obturátor \varnothing 5,5 mm	5
704-240	Přechodka trokaru plastová \varnothing 10mm- \varnothing 5,5mm	5
704-397K	Hassonův kužel	1
775-4068, 775-4010, 775-3995	Okénkový grasper vroubkovaný atraumatický, celotočný \varnothing 5mm, délka 330 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací, délka branží 15 mm	12
73-383-33, 73-201-02RS, 73-205-33	Duvalovy kleště, \varnothing 5 mm, 330 mm, délka branží 20mm, zoubkované čelisti, rukojeť s vypínatelnou aretací	3
775-4074, 775-4010, 775-3995	FUNDUS grasper, délka branží 20 mm, \varnothing 5mm, 330mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	10

775-4027TSC	Nůžky METZENBAUM, ø 5mm, 330mm, rukojeť bez aretace s opěrkou pro prst, monopolární, celootočné	12
775-4027	Insert nůžek METZENBAUM pro ø 5mm, 330mm	12
775-4087, 775-4010, 775-3995	KOCHER kleště, ø 5mm, 330mm, 2x1 zub, jedna pohyblivá branže, rukojeť s vypínatelnou aretací	1
775-4100C	DEBAKEY atraumatický, ø 5mm, 330mm, typ branží- rovné, rukojeť bez aretace	2
775-4244, 775-4010, 775-3995	SCHROEDER jednozubý ø 5mm, 330mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	5
775-4098, 775-4010, 775-3995	Babcock ø 5mm, 330 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	1
775-5044, 775-4012, 775-3995	Babcock ø 10 mm, 330 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	2
775-5089, 775-4012, 775-3995	Okénkový grasper atraumatický, hrubě vroubkovaný, ø 10mm, 330mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	2
707-520	Monopolární kabel 300cm, sterilizovatelný 134°C,	8
706-159	Elektroda jehlová, monopolární ø 5mm, 330mm,	8
795-4900, 704-763	Elektroda typu háček „L“, v kombinaci s odsávacím a proplachovým kanálem, včetně rukojetě s dvoucestným ventilem pro ovládání sání a proplachu, ø 5mm, 330mm,	5
707-151	Elektroda typu háček „L“90°, bipolární, ø 5mm, 340mm	1
704-120	Punkční kanula ø 5mm, 330mm	5
704-122	Punkční kanula ø 5mm, 450mm	8
544995	Klipovač ø 10mm, 330mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lok large	5
544240	klipy Weck Hem-o-Lok velikosti L 200 ks	3
544990L	Klipovač ø 10mm, 450mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge	1
544250	klipy Weck Hem-o-Lok velikosti XL 80 ks	1
544965T	Klipovač ø 5,5mm, 330mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large	1
544230	klipy Weck Hem-o-Lok velikosti ML 25 ks	1
544130	Odstranovač klipů Hem-o-Lok velikosti L/XL	1
PL530R	Kleště pro aplikaci cévních klipů 12,5 mm, délka 34 cm	1
704-110	Retraktor vějířový, ø 5mm, 330mm, tříprstý	1
704-112	Retraktor vějířový, ø 10mm, 360mm, pětiprstý	1
704-124	Retraktor rovný, ø 5mm, 310mm, flexe s vytvořením triangulového tvaru na distálním konci	2

614-110-53	Laparoskopický jehelec, \varnothing 5mm, 330mm, zahnutý vlevo, axiální rukojeť s malým úhlem otevření, i pro menší ruku, integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu, teflonový povrch pro snadnou údržbu	1
614-510-53	Laparoskopický jehelec, \varnothing 5mm, 330mm, zahnutý vlevo, zahnutá rukojeť (jako u lsk. nástrojů), integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu	4
707-122	Bipolární úchopové kleště \varnothing 5mm, 340mm, celootočné	2
707-120	Bipolární kleště Maryland \varnothing 5mm, 340 mm, jemně křížově vroubkované branže	10
707-303, 90302-30	Bipolární kabel kompatibilní se vstupem pálení typu Olympus, autoklávovatelný 134°, 3m	1
704-106	Utahovač uzlů CLERMONT-FERRAND Model, \varnothing 5 mm, 330 mm	5
UMH650	Ručka k manipulátoru k sacrocolpopexi	2
UMB678	Děložní sonda k manipulátoru	2
KC-RUMI-25	Děložní manipulátor je elektrochirurgicky kompatibilní, průměr klobouků 2,5cm	2
KCP-30-2	Děložní manipulátor je elektrochirurgicky kompatibilní, průměr klobouků 3 cm	1
KCP-35-2	Děložní manipulátor je elektrochirurgicky kompatibilní, průměr klobouků 3,5 cm	1
CPO-6	Colpopneumoocluder	2
704-605	Sací a irigační rukojeť s ovládacím kohoutem (M8 x 1mm)	1
704-607	Sací a irigační kanula, 10mm,330mm, s 8x4 otvory	6
704-608	Sací a irigační kanula, 5mm, 330mm, 4x4 otvory	6
707-600	Čistící pistole s 9 adaptéry	5
707-605	Kartáčky 5mm (5ks)	1
707-610	Kartáčky 10mm (5ks)	1
013-200-145	Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby 14,5 cm	1
013-130-210	Anatomická pinzeta Model USA, 21 cm	10
030-281-320	Děložní sonda SIMS, tvarovatelná, délka 32 cm	6
010-200-003	Násadka na skalpel č. 11, rukojeť 13 cm	6
085-300-045	Nerezová miska, průměr 12 cm	5
015-260-140	ROCHESTER- PEAN, rovný, délka 14cm	10
015-280-140	KOCHER- OCHSNER kleště, rovné, délka 14cm	6
030-200-001, 030-200-400, 030-200- 030,030-200- 035, 030-200- 040,030-200- 060, 030-200- 070	SCHERBAK zrcadlo- rukojeť + závaží + 5ks zrcadel	10

030-241-045	HEGAR dilatátor 4,5 mm	5
030-241-055	HEGAR dilatátor 5,5 mm	5
030-241-065	HEGAR dilatátor 6,5 mm	5
019-640-200	TC-BOZEMANN jehelec 20 cm	5
030-310-250	Schroeder tenaculum kleště, délka 25 cm	5
091-113-260	Ventilový kontejner velikost 580 x 280 x 260mm, ventilový filtrační systém nevyžadující údržbu, nastavení tří pracovních poloh ventilu v průběhu a po sterilizaci	6
095-220-100	Nerezové síto do kontejneru 540 x 255 x 100	5
87295-00	Univerzální držák na nástroje, vnější rozměry: 460 x 233 x 145 mm	10
71500-00	Kontrolní ovládací jednotka, transmisní jednotka včetně těsnění, rukojeť, řezací trubice, pedál, extrakční kleště, úchopové kleště, možnost změny směru otáčení, kroutící moment 80 Ncm, autoklávovatelný elektronický motor včetně 3m kabelu k ovládací jednotce	1
71504-12,71504-15,71504-20	Řezací trubice průměru 12, 15 a 20 cm včetně obturátorů	1
71-503-12, 71-503-15, 71-503-20	Ochranná vnější pochva s tkáňovým polohovačem, zabraňující nechtěné rotaci tkáně	1
04-00547	Schroeder jednozubé extrakční kleště, vel. 10mm, délka 420mm	2
04-00544	úchopové kleště 2x3 zuby, vel. 10mm, délka 420mm	1

Celkem bez DPH**2 226 000 Kč****DPH 21%****467 460 Kč****Celkem včetně DPH****2 693 460 Kč**